

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sra. RONILDA DIAS**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **30 outubro 1971** Idade: **54**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **08/05/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas


08/04/2026 - 07/05/2026		Dispositivo: Elite II AMER (S/N: 20110299376)	
Parâmetros do dispositivo			
Modo de terapia: CPAP	Pressão programada: 9,6 cmH20	APE: OFF	
Nível APE: 3,0 cmH20			
Pressão - cmH20			
Mediana: 9,6	Máximo/a: 9,6		
Fuga - l/min			
Mediana: 4,2	Percentil 95: 15,0	Máximo/a: 50,4	
Índices respiratórios - eventos/hora			
Índice de apneia: 0,2	Índice de hipopneia: 3,9	AHI: 4,0	
% de tempo em apneia: 0,0			
Utilização Total			
Dias de Uso >= 4 horas : 13	Dias de Uso < 4 horas : 3	% Dias de Uso >= 4 horas : 43	
Dias de não utilização: 14	Totalidade de dias: 30	Horas de utilização: 90:49	
Mediana do uso diário: 6:49	Média de uso diário: 3:01		

Gráficos em sumário


08/04/2026 - 07/05/2026

Dispositivo: Elite II AMER (S/N: 20110299376)


Pressão

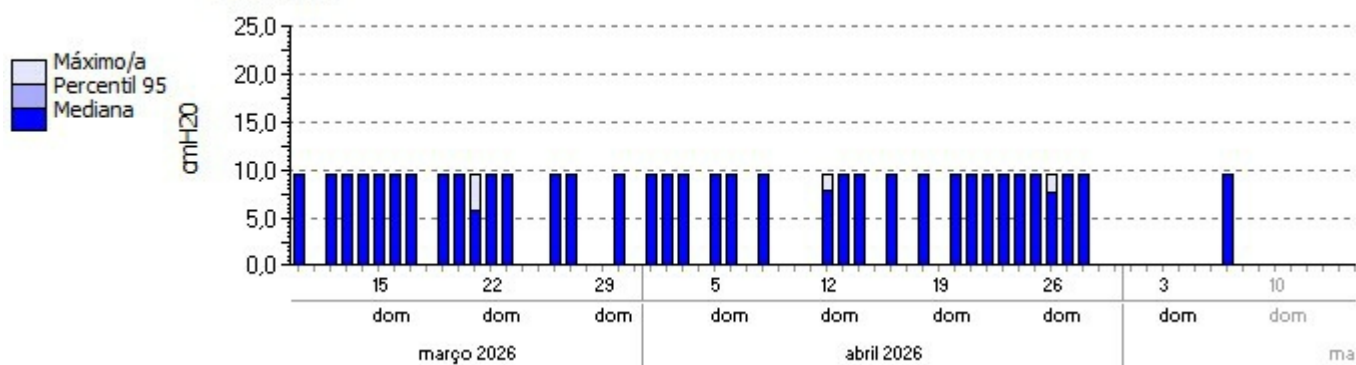


Fuga

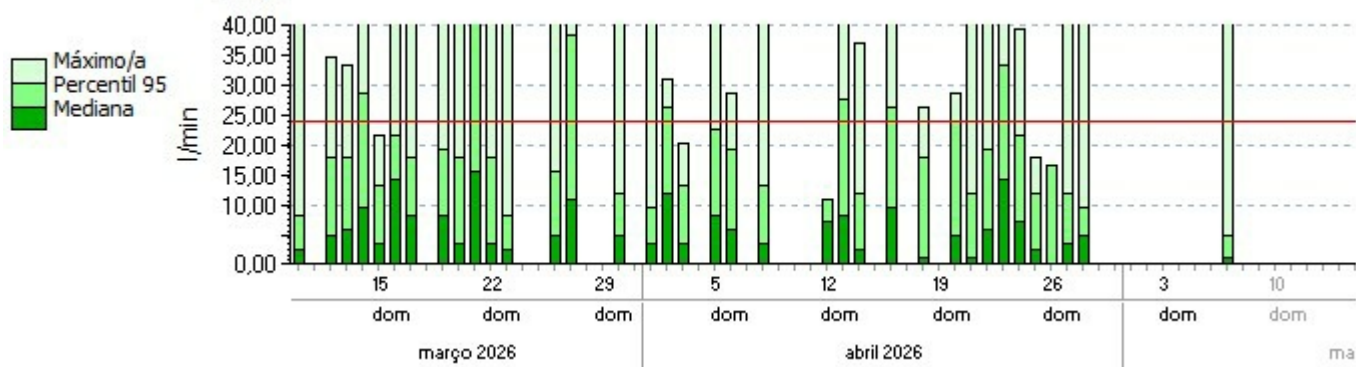

IAH & IA

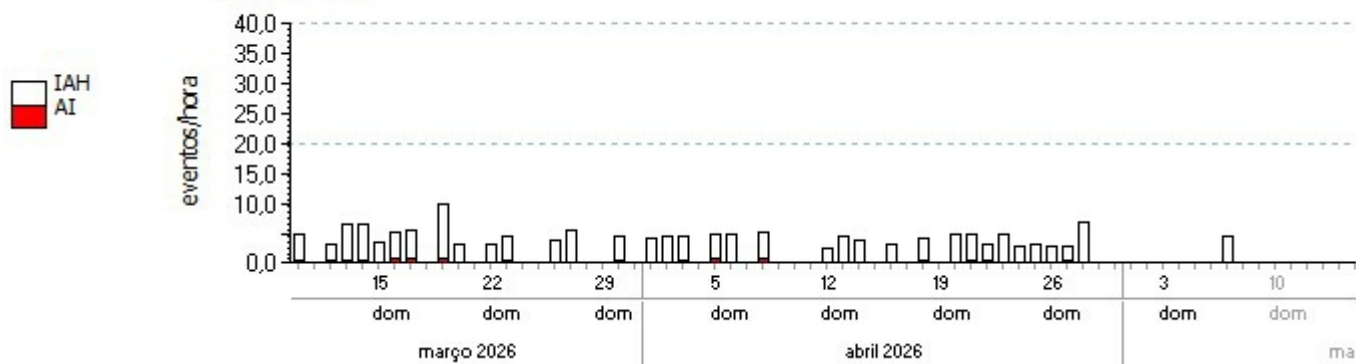

Uso

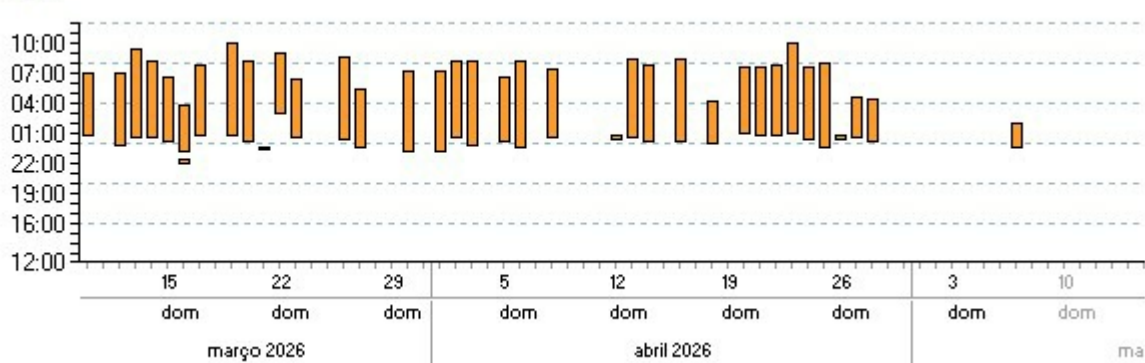

Utilização Total

