


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/01/2026 - 26/01/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	44 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 24 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/01/2026)	2,976 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609710
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.3	Percentil 95.º: 10.8	Máximo: 10.8	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 2.6	Máximo: 10.5	
Eventos por hora	IA: 4.6	IH: 1.7	IAH: 6.3	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 3.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

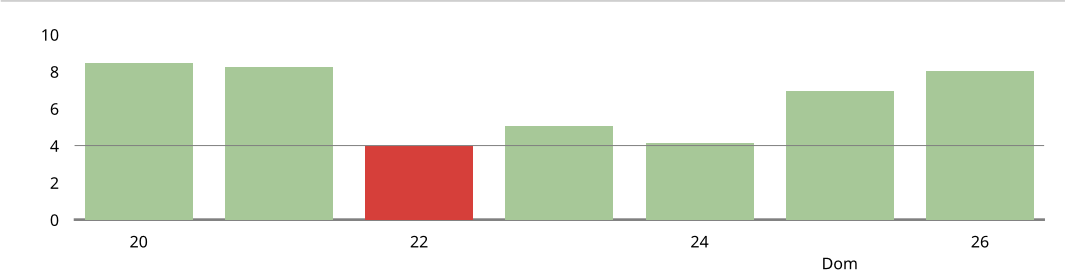


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609710


Utilização (horas)

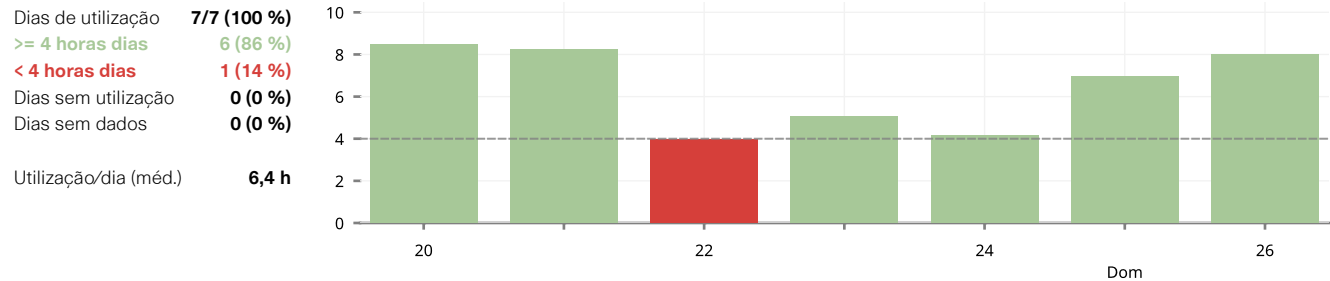

Fuga (l/min)

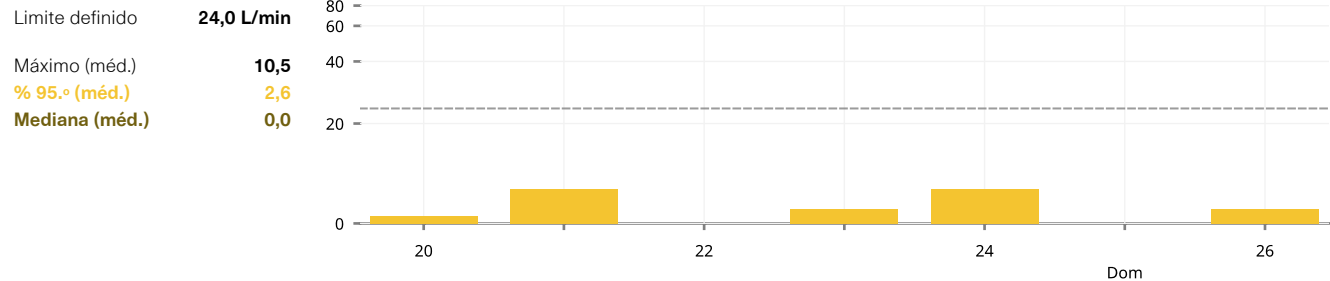

Pressão (cmH2O)

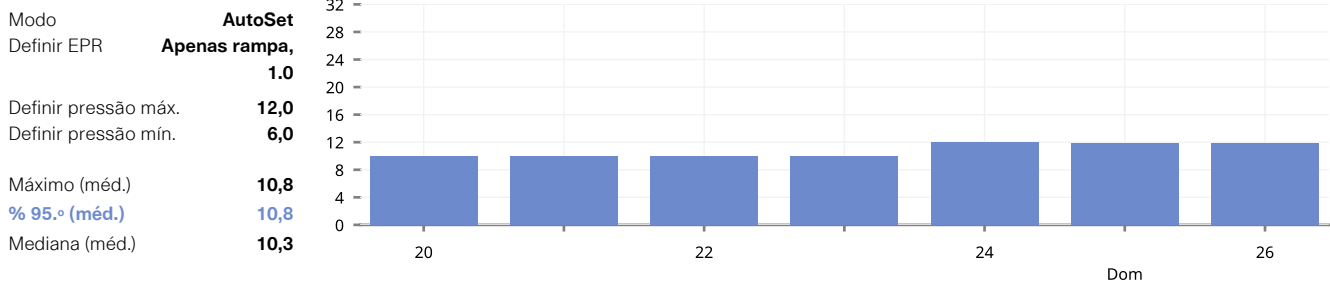

IAH (eventos/hora)

