


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 20/01/2026 - 27/01/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 8/8 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 8 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 50 horas 58 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 22 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 22 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 42 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 27/01/2026) | 4,795 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22211840650  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 9 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 5.9   | Percentil 95.º: 27.8 | Máximo: 36.6 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.8        | IH: 0.6              | IAH: 1.4     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.6   | Obstrutiva: 0.2      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 1.1            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

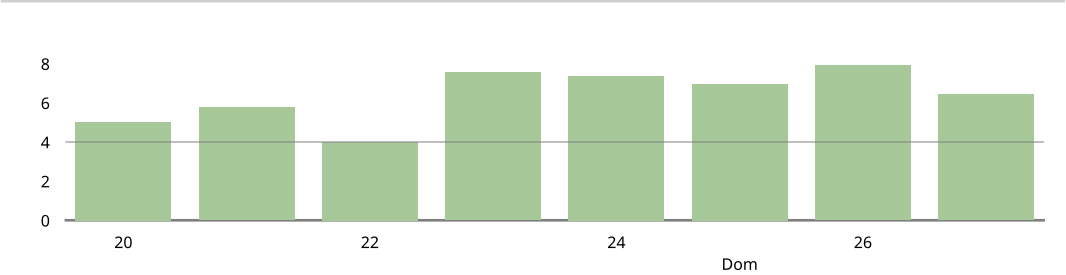


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


## Utilização (horas)

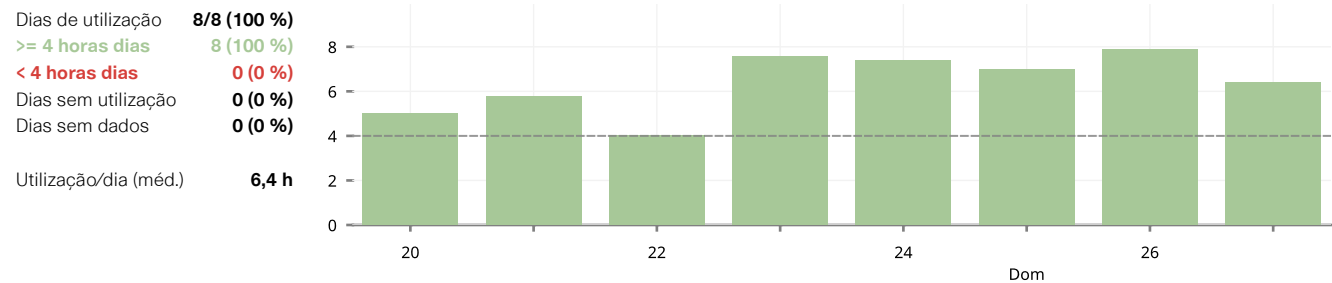

## Fuga (l/min)

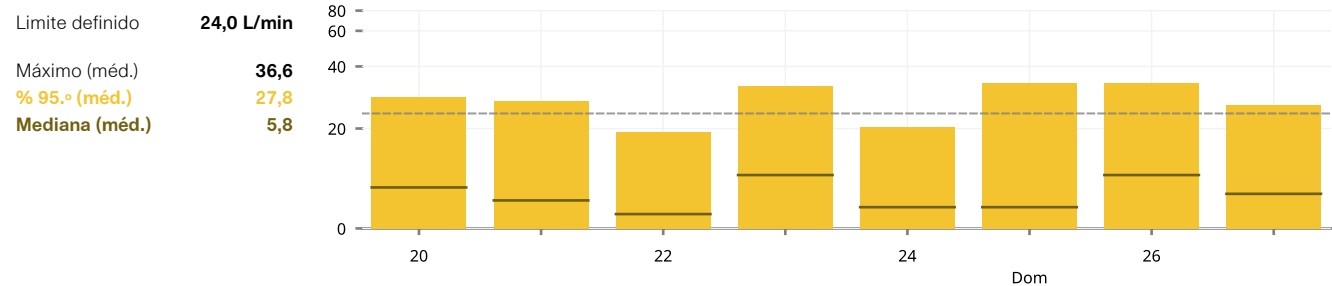

## Pressão (cmH2O)

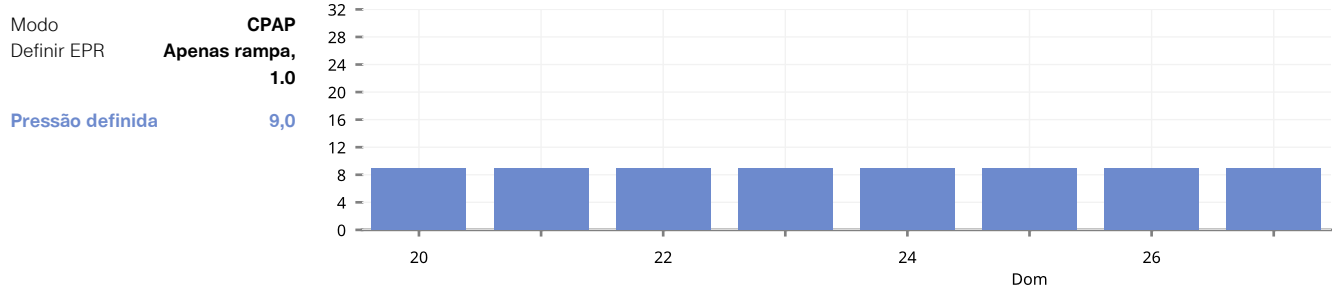

## IAH (eventos/hora)

