

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

14/01/2026 - 20/01/2026

Dias de utilização		7/7 dias (100%)	
>= 4 horas		2 dias (29%)	
< 4 horas		5 dias (71%)	
Horas de utilização		21 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 22 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/01/2026)		43 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22222291908	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		5 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 4.9	Percentil 95.º: 6.8	Máximo: 7.7
Fugas — l/min	Mediana: 6.3	Percentil 95.º: 38.7	Máximo: 83.8
Eventos por hora	IA: 14.0	IH: 1.2	IAH: 15.2
Índice de apneia	Central: 3.3	Obstrutiva: 2.4	Desconhecid 8.2
Índice RERA	0.2		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

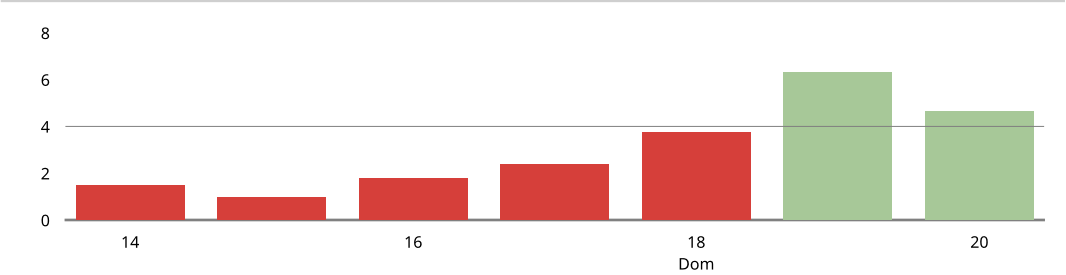


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


Utilização (horas)

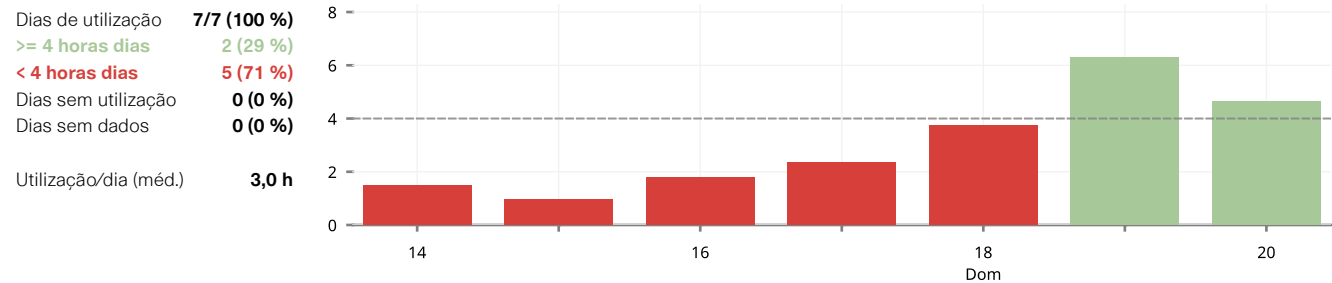

Fuga (l/min)

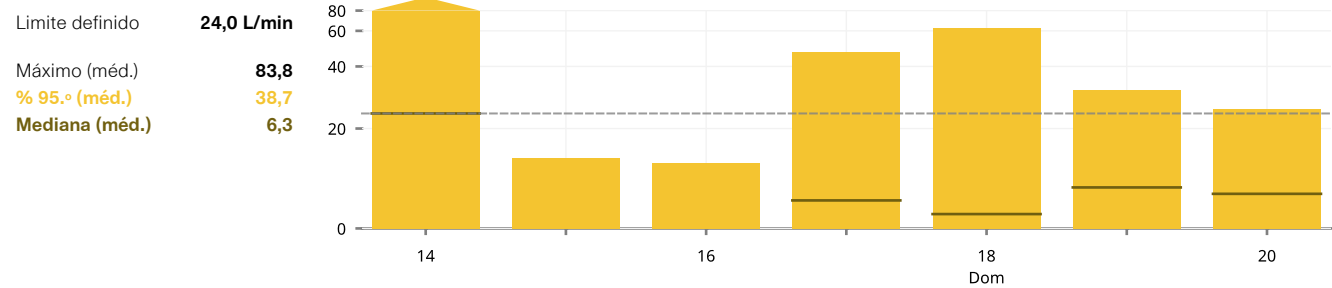

Pressão (cmH2O)

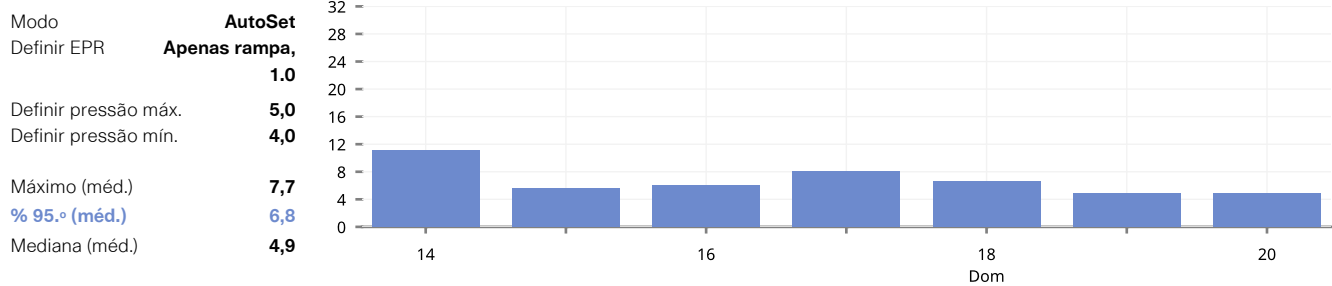

IAH (eventos/hora)

