


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		20/01/2026 - 26/01/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	4 dias (57%)	
< 4 horas	3 dias (43%)	
Horas de utilização	38 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 28 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 28 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/01/2026)	3,928 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291912
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 1.0	Máximo: 28.5	
Eventos por hora	IA: 3.9	IH: 2.4	IAH: 6.3	
Índice de apneia	Central: 3.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.5
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (0%)			

Horas de utilização

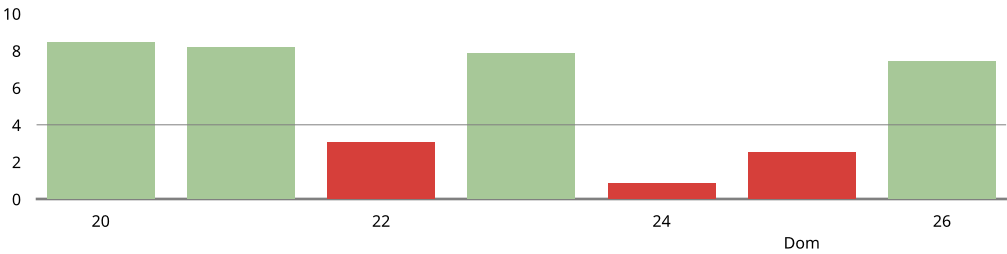


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291912


Utilização (horas)

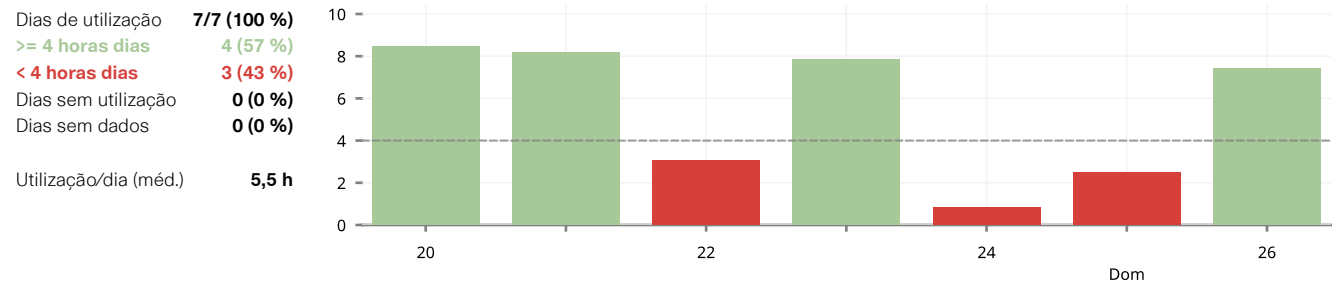

Fuga (l/min)

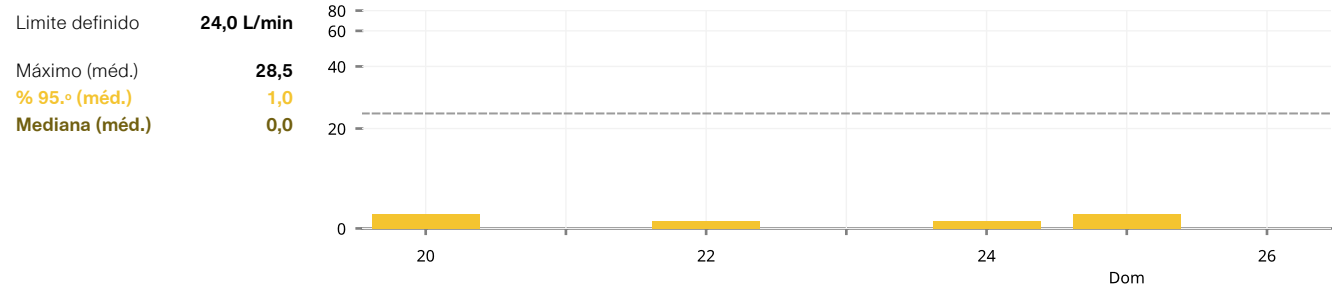

Pressão (cmH2O)

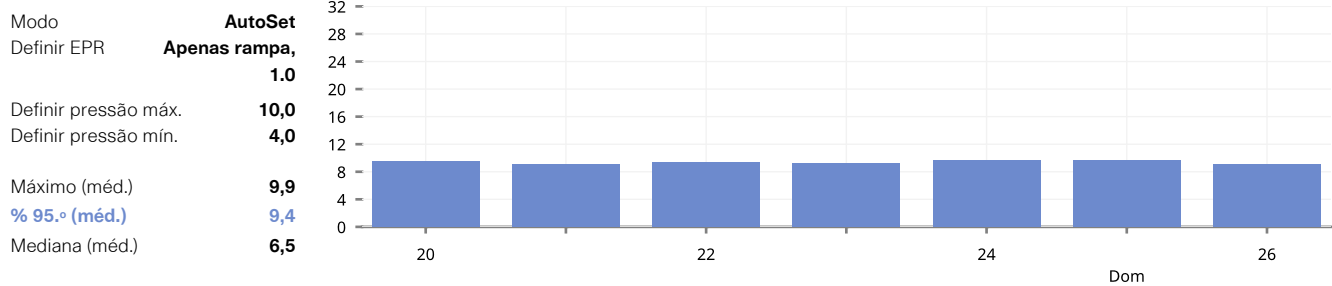

IAH (eventos/hora)

