


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/01/2026 - 24/02/2026
Dias de utilização	28/33 dias (85%)	
>= 4 horas	24 dias (73%)	
< 4 horas	4 dias (12%)	
Horas de utilização	150 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 34 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 23 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 41 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/02/2026)	1,995 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232881622
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.6	
Fugas — l/min	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 18.0	Máximo: 25.4	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.4	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

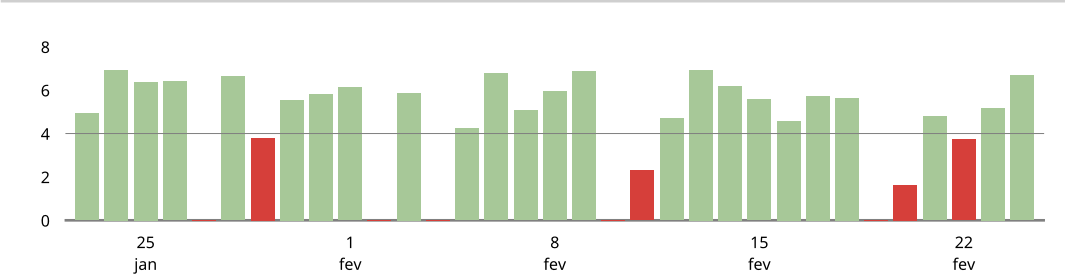

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232881622

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/33 (85 %)**


>= 4 horas dias 24 (73 %)

< 4 horas dias 4 (12 %)

Dias sem utilização 5 (15 %)

Dias sem dados 0 (0 %)

Utilização/dia (méd.) **5,4 h**

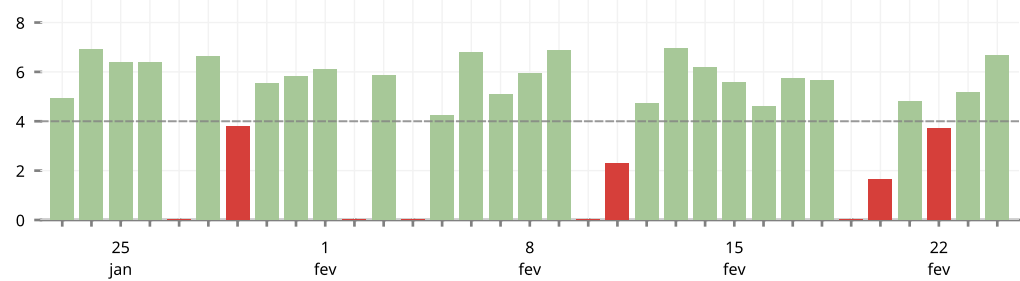


Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **25,4**

% 95.º (méd.) 18,0

Mediana (méd.) 7,5

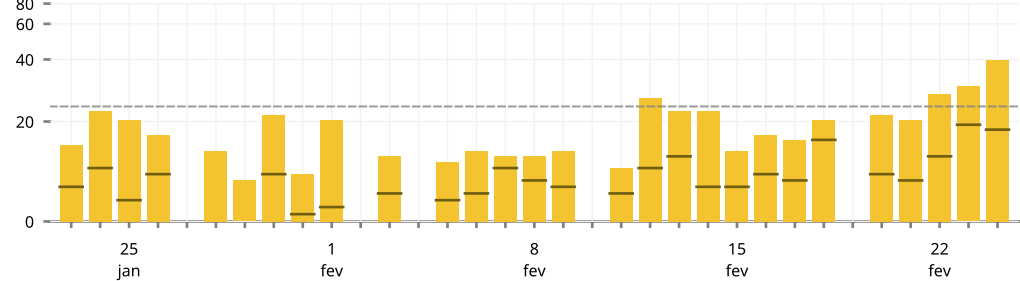

Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Desl.**


Definir pressão máx. **10,0**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **9,6**

% 95.º (méd.) 8,9

Mediana (méd.) **6,7**

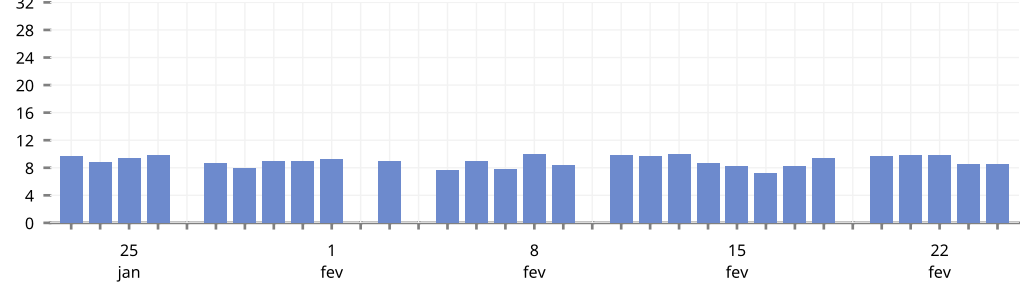

IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC **0,0**

IAO **0,1**

IAD **0,0**

RERA **0,2**

%RCS (méd.) **0,0**

