


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/01/2026 - 28/01/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	45 horas 14 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 32 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 32 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/01/2026)	6,254 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291907
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.6	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 77.6	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.1	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

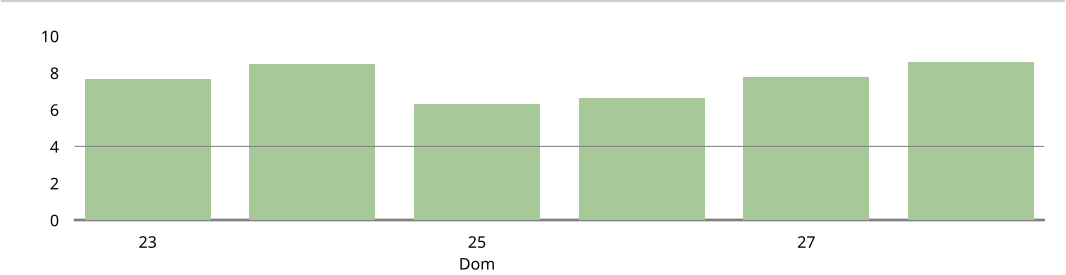


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291907


Utilização (horas)

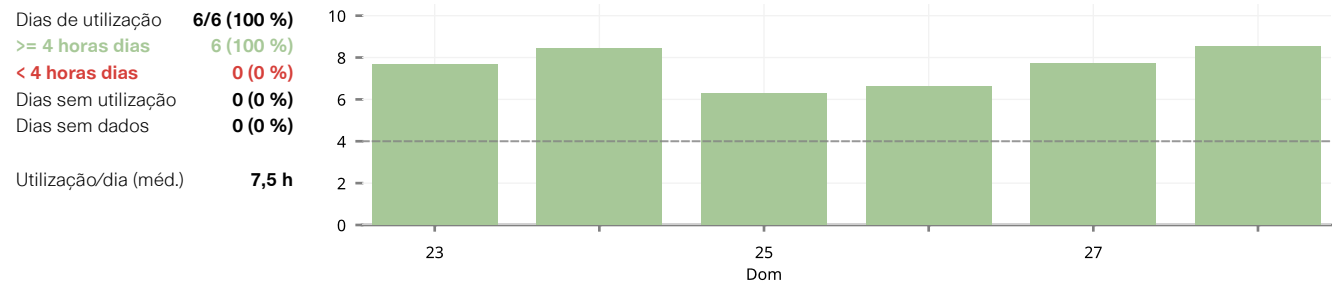

Fuga (l/min)

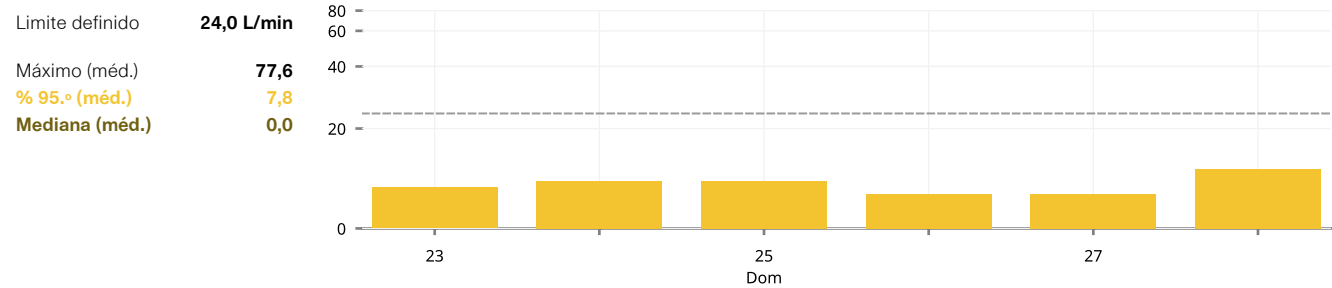

Pressão (cmH2O)

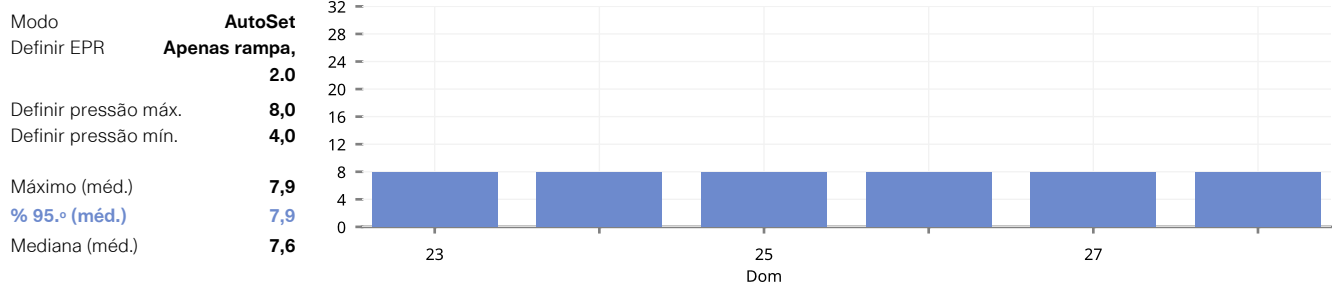

IAH (eventos/hora)

