


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/12/2025 - 24/01/2026
Dias de utilização	26/30 dias (87%)	
>= 4 horas	18 dias (60%)	
< 4 horas	8 dias (27%)	
Horas de utilização	119 horas 23 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 59 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 36 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/01/2026)	1,756 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882278
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 9.1	Máximo: 25.4	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 1.1	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

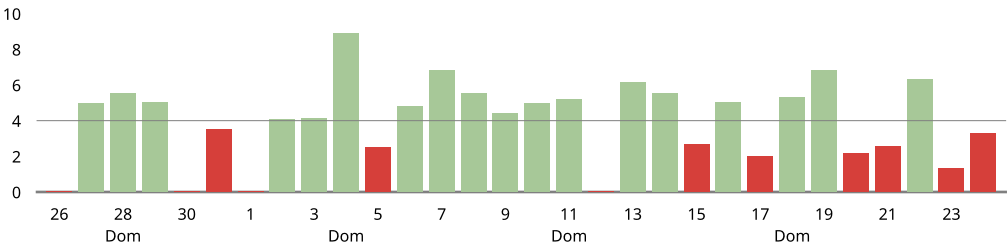

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882278

Utilização (horas)

Dias de utilização **26/30 (87 %)**

>= 4 horas dias

18 (60 %)


< 4 horas dias

8 (27 %)

Dias sem utilização **4 (13 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,6 h**

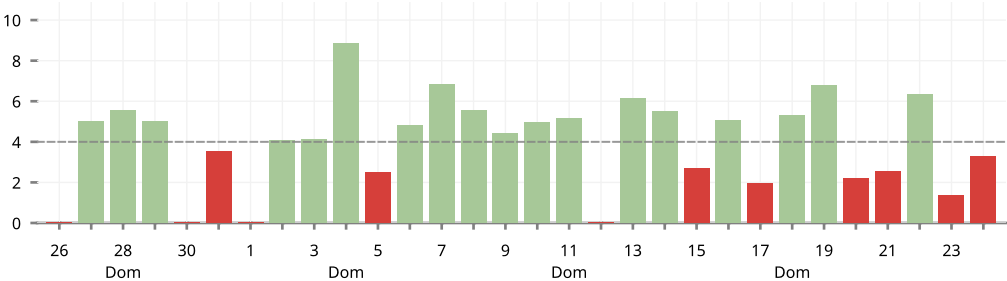


Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **25,4**

% 95.º (méd.) **9,1**

Mediana (méd.) **0,0**

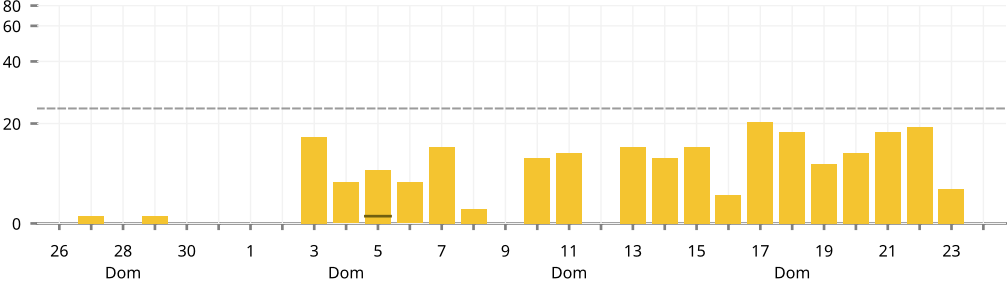

Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**


Definir pressão máx. **10,0**

Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **10,0**

% 95.º (méd.) **10,0**

Mediana (méd.) **8,0**

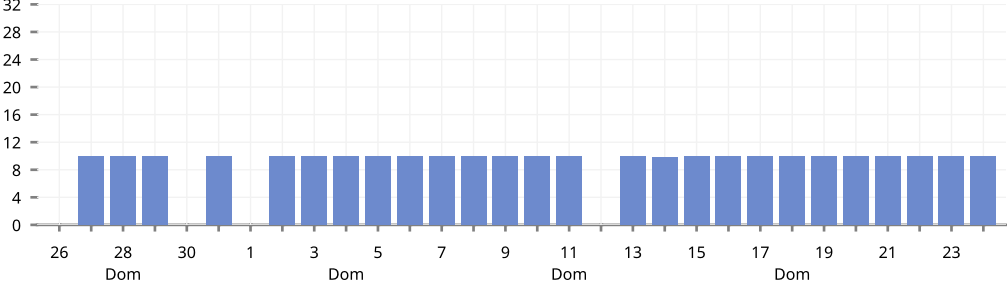

IAH (eventos/hora)

IAH **2.2**

IH **1.1**

IA **1.1**

IAC **0.2**

IAO **0.7**

IAD **0.1**

RERA **0.2**

%RCS (méd.) **0.0**

