


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/01/2026 - 01/02/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	50 horas 27 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 25 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 25 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/02/2026)	3,178 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 9.9	
Fugas — l/min	Mediana: 12.0	Percentil 95.º: 31.0	Máximo: 48.0	
Eventos por hora	IA: 4.8	IH: 0.3	IAH: 5.1	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 3.2	Desconhecid	1.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

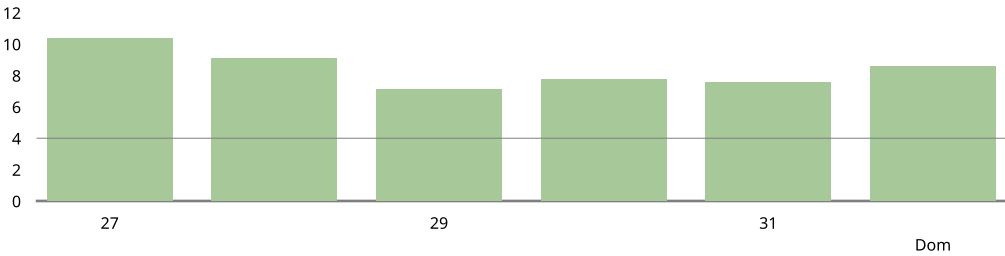


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992


Utilização (horas)

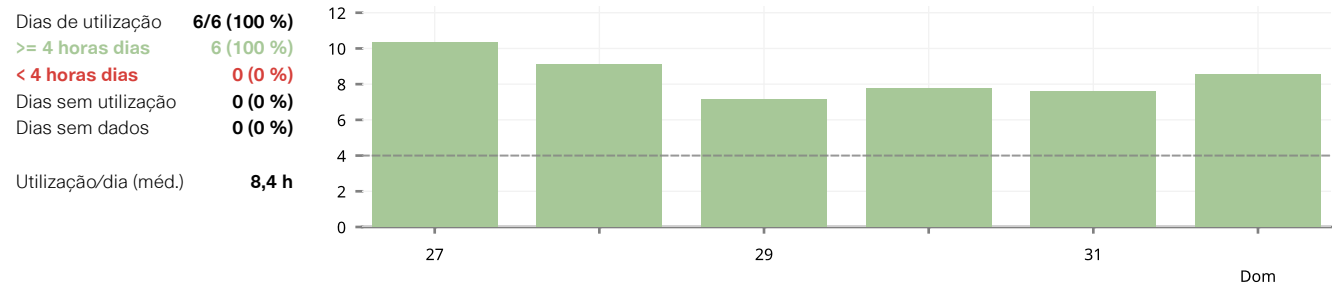

Fuga (l/min)

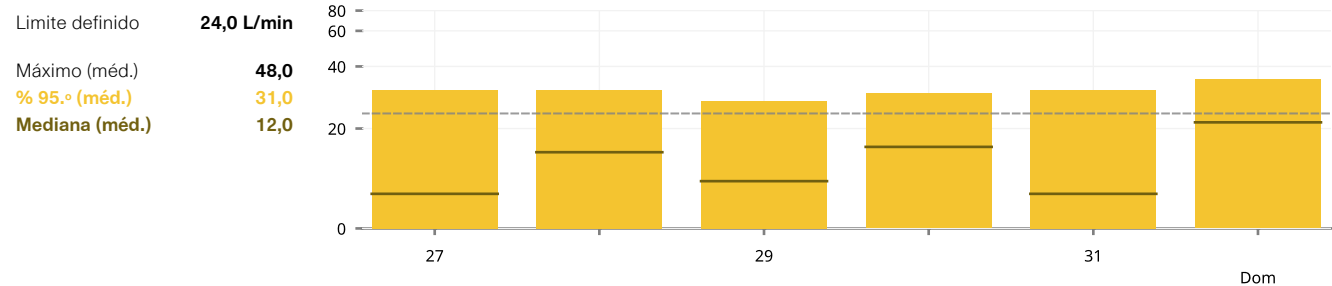

Pressão (cmH2O)

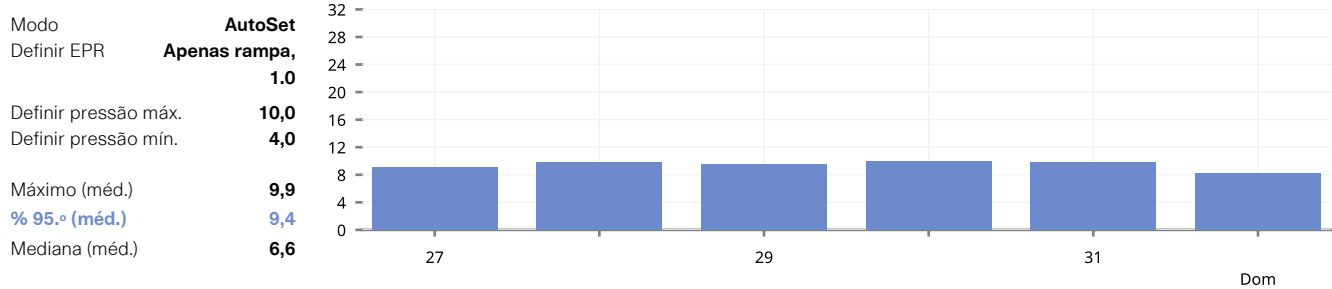

IAH (eventos/hora)

