


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		01/02/2026 - 07/02/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		51 horas 48 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 24 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 24 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 45 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/02/2026)		3,221 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191678992
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6.6 cmH2O
Pressão máx.	9.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.6	Percentil 95.º: 9.2	Máximo: 9.5	
Fugas — l/min	Mediana: 21.4	Percentil 95.º: 37.5	Máximo: 55.9	
Eventos por hora	IA: 3.2	IH: 0.4	IAH: 3.6	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	1.6
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

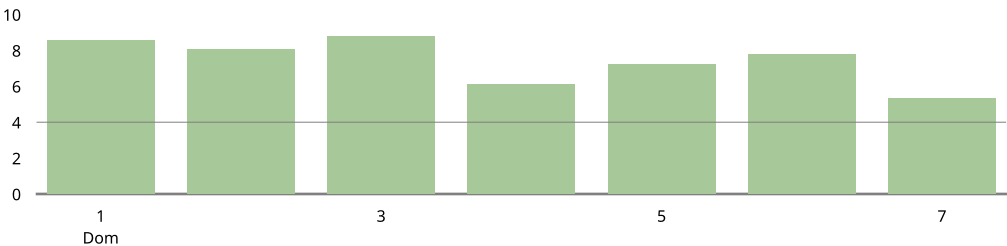


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191678992


Utilização (horas)

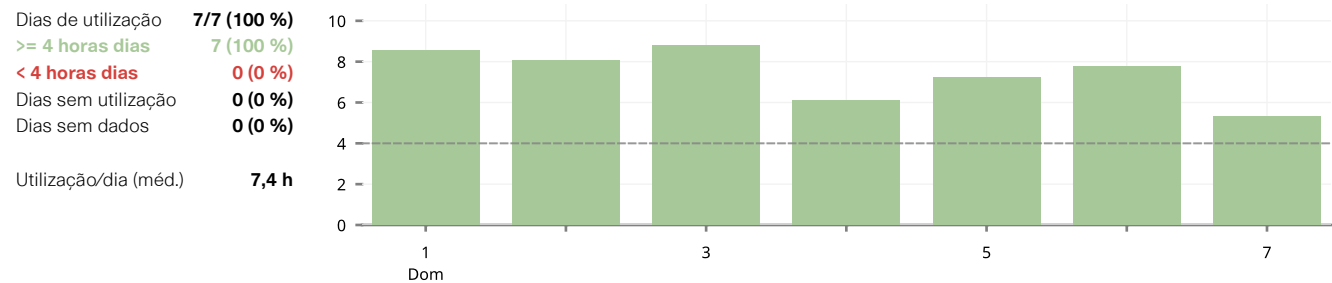

Fuga (l/min)

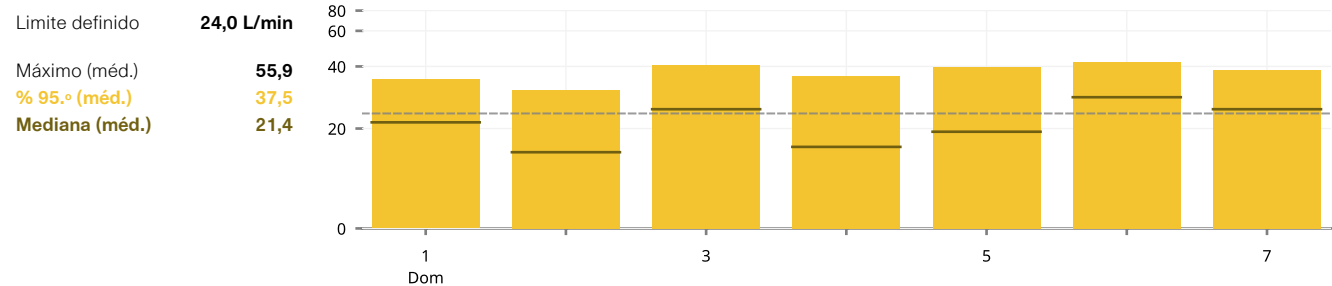

Pressão (cmH2O)

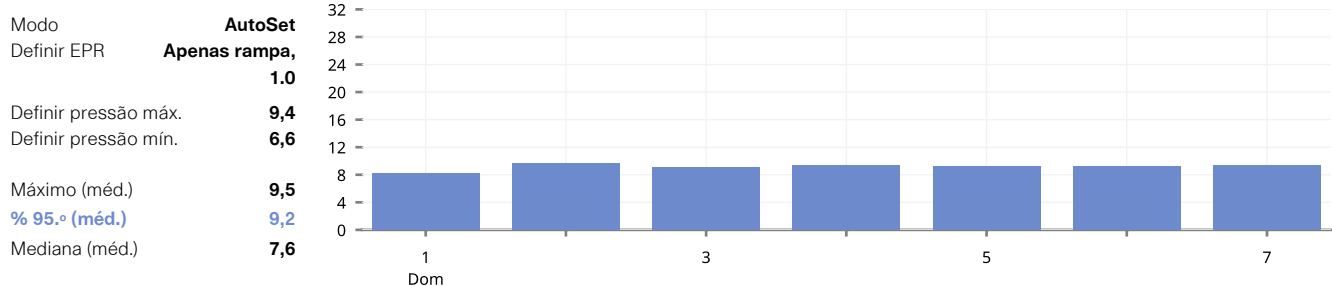

IAH (eventos/hora)

