


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 25/02/2026 - 29/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 20/33 dias (61%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 19 dias (58%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 1 dias (3%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 119 horas 57 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 3 horas 38 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 0 minutos    |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 10 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 29/03/2026) | 5,089 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22211840642  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 6 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 9 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 8.9   | Percentil 95.º: 9.0  | Máximo: 9.0  |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 10.3  | Percentil 95.º: 25.0 | Máximo: 38.4 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.4        | IH: 1.6              | IAH: 2.0     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.2   | Obstrutiva: 0.1      | Desconhecid  | 0.1 |
| Índice RERA                                        | 1.1            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

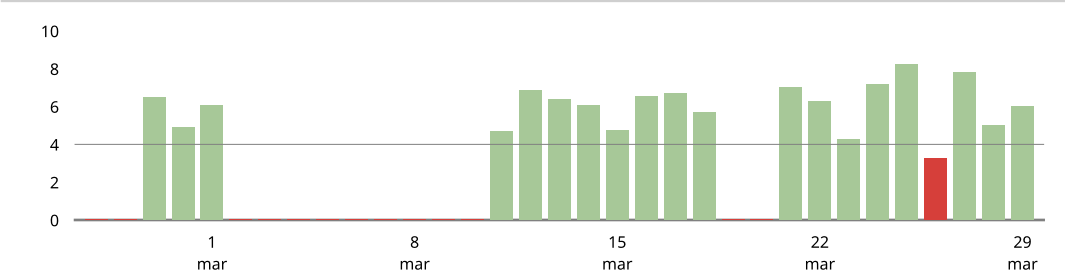


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840642


## Utilização (horas)

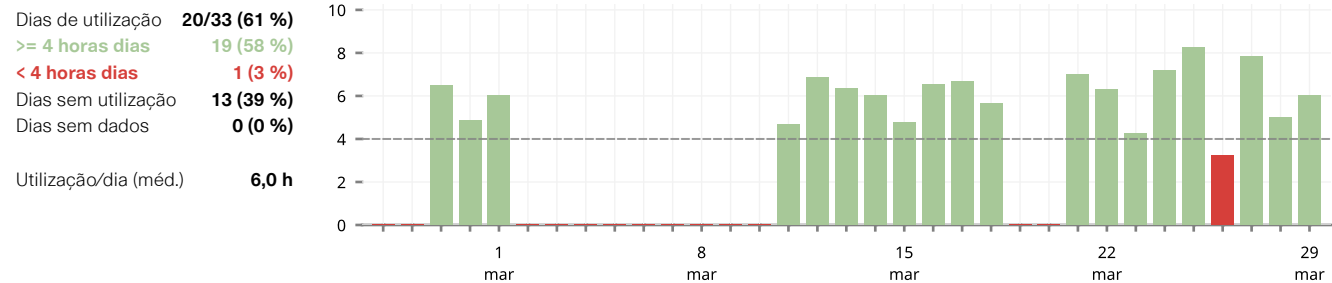

## Fuga (l/min)

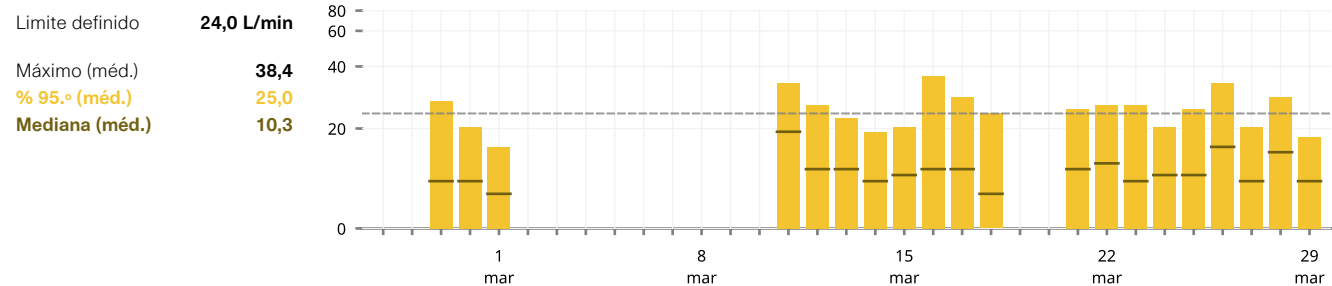

## Pressão (cmH2O)

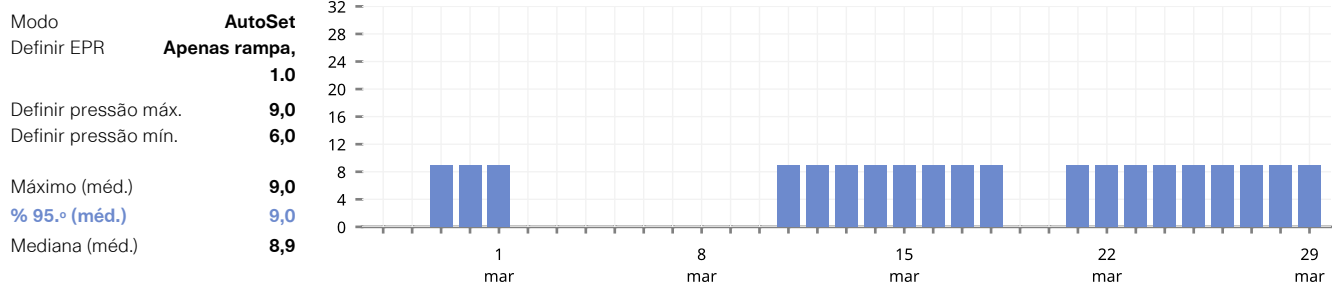

## IAH (eventos/hora)

