


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		29/01/2026 - 24/02/2026
Dias de utilização	17/27 dias (63%)	
>= 4 horas	15 dias (56%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	98 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 58 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/02/2026)	4,969 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840642
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	8.6	Percentil 95.º:	8.9	Máximo:	9.0
Fugas — l/min	Mediana:	16.9	Percentil 95.º:	33.4	Máximo:	53.5
Eventos por hora	IA:	0.5	IH:	1.2	IAH:	1.7
Índice de apneia	Central:	0.2	Obstrutiva:	0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA						1.4
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização

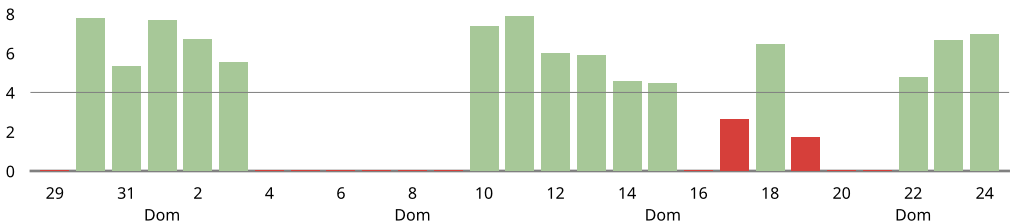


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840642


Utilização (horas)

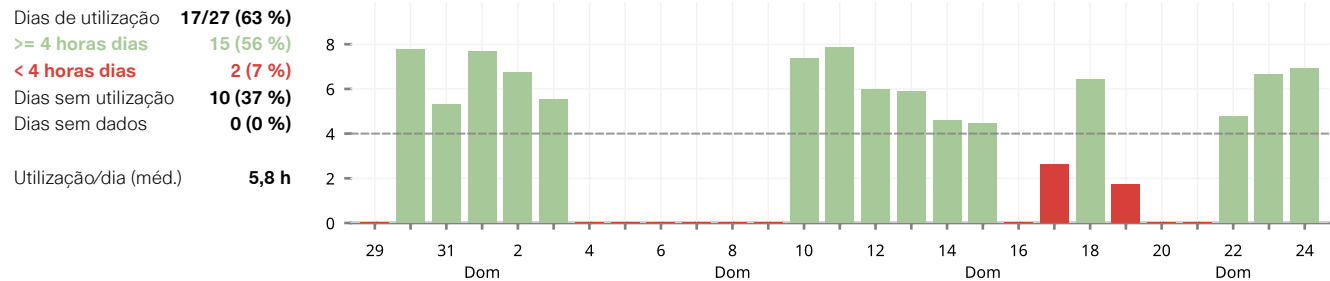

Fuga (l/min)

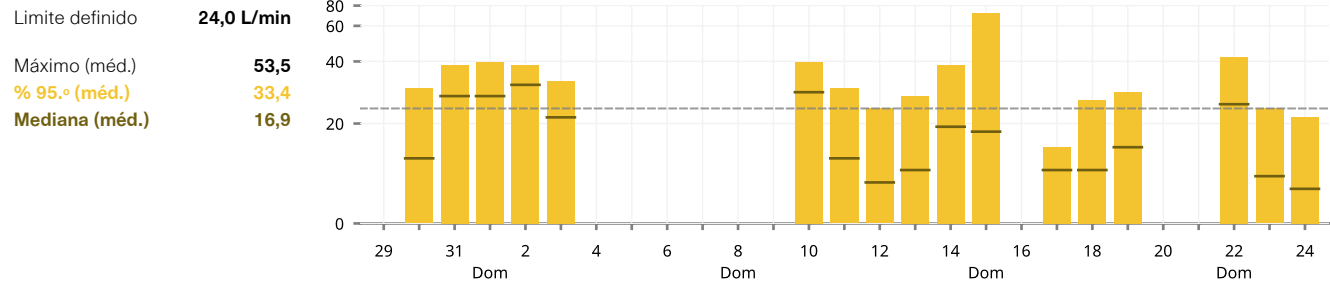

Pressão (cmH2O)

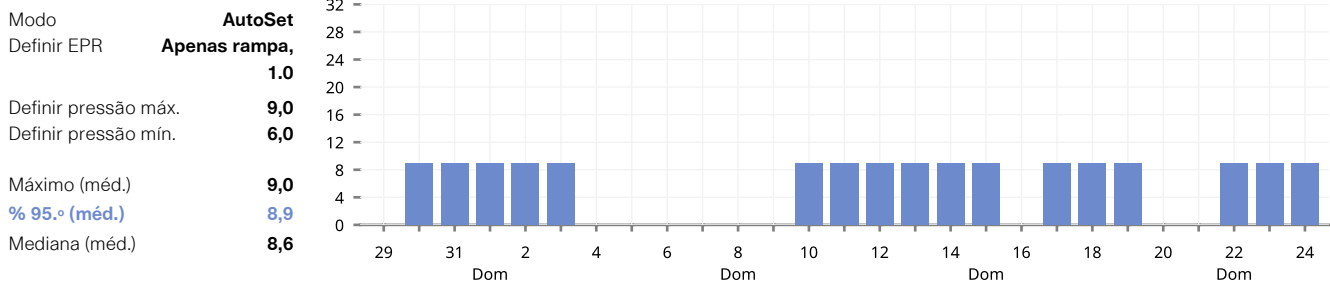

IAH (eventos/hora)

