


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 04/02/2026 - 11/02/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 8/8 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 8 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 62 horas 48 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 7 horas 51 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 7 horas 51 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 8 horas 4 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 11/02/2026) | 4,901 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22211840650  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 4 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 7.2 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |
| Resposta            | Suave        |

| Terapia                                            |                |                      |                 |  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 6.9   | Percentil 95.º: 7.0  | Máximo: 7.1     |  |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 12.9  | Percentil 95.º: 37.5 | Máximo: 81.0    |  |
| Eventos por hora                                   | IA: 4.2        | IH: 2.6              | IAH: 6.8        |  |
| Índice de apneia                                   | Central: 1.9   | Obstrutiva: 0.8      | Desconhecid 1.4 |  |
| Índice RERA                                        | 1.2            |                      |                 |  |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |                 |  |

## Horas de utilização

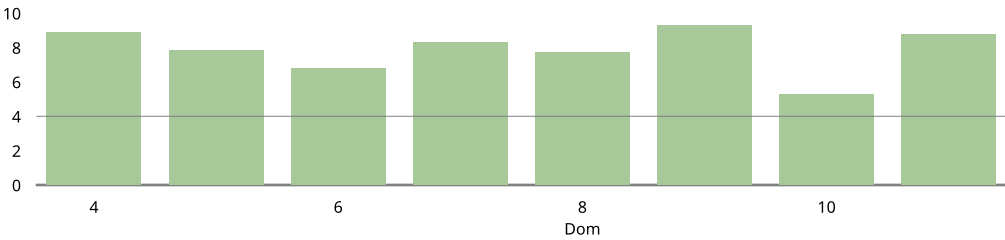


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


## Utilização (horas)

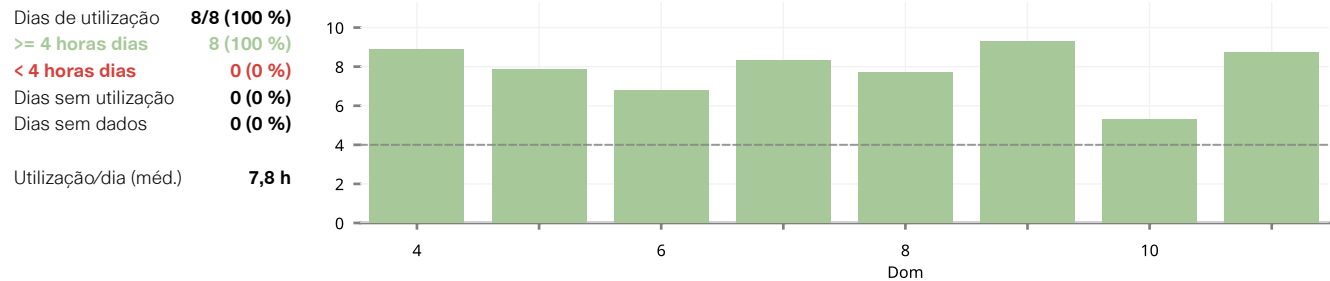

## Fuga (l/min)

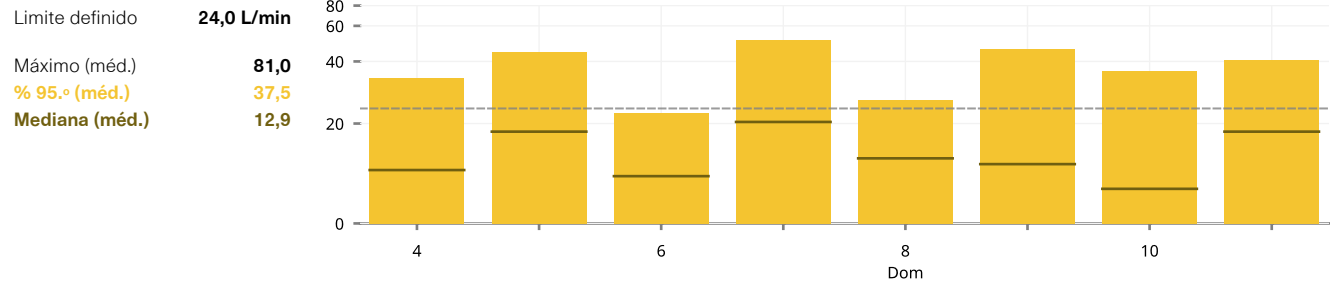

## Pressão (cmH2O)

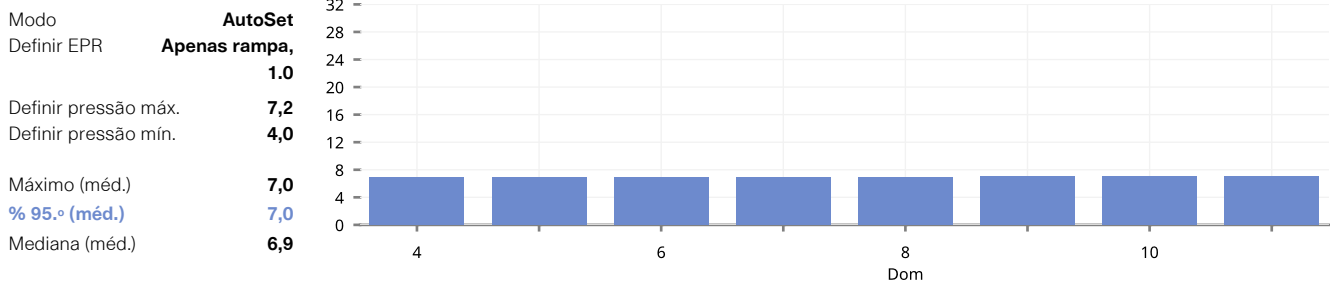

## IAH (eventos/hora)

