


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 30/03/2026 - 21/04/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 16/23 dias (70%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 10 dias (43%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 6 dias (26%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 83 horas 26 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 3 horas 38 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 5 horas 13 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 3 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 21/04/2026) | 1,995 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22232882278  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 7 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 3            |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 1.7   | Percentil 95.º: 10.3 | Máximo: 26.3 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.5        | IH: 0.2              | IAH: 0.7     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.2   | Obstrutiva: 0.3      | Desconhecid  | 0.1 |
| Índice RERA                                        | 0.2            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

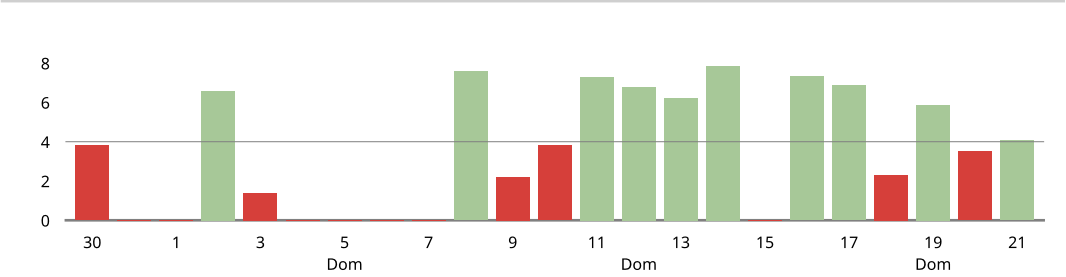


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882278


## Utilização (horas)

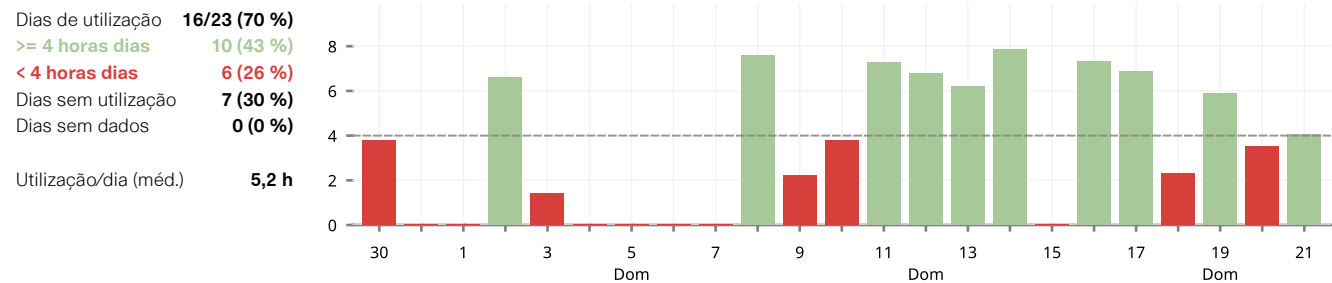

## Fuga (l/min)

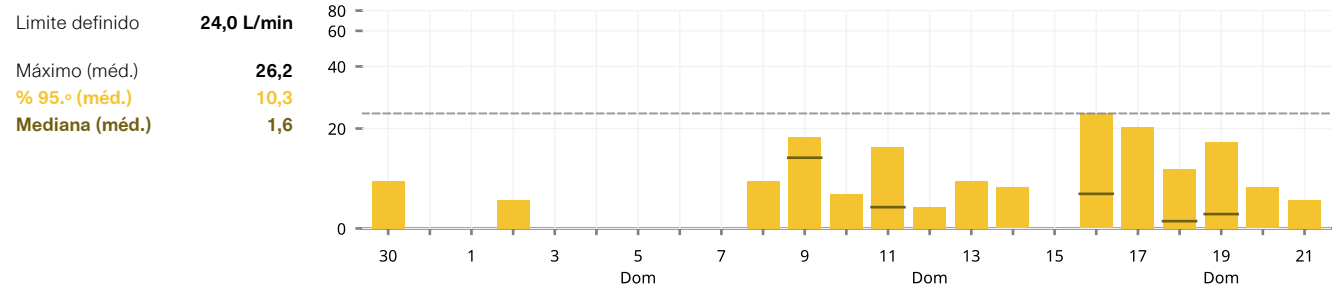

## Pressão (cmH2O)

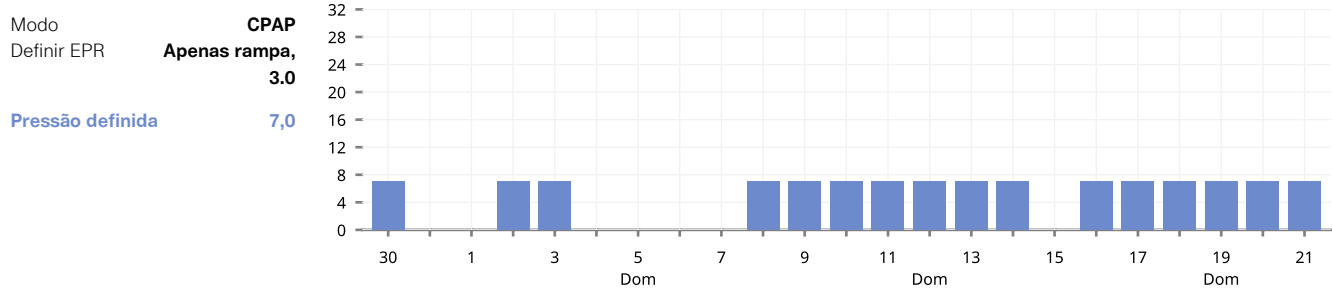

## IAH (eventos/hora)

