


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/03/2026 - 28/03/2026
Dias de utilização	12/13 dias (92%)	
>= 4 horas	10 dias (77%)	
< 4 horas	2 dias (15%)	
Horas de utilização	69 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/03/2026)	1,912 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882278
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 8.5	Máximo: 8.5	
Fugas — l/min	Mediana: 1.7	Percentil 95.º: 13.5	Máximo: 46.3	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.3	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

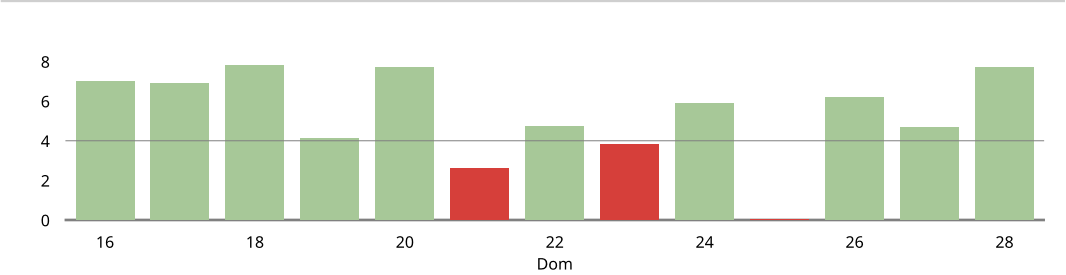


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882278


Utilização (horas)

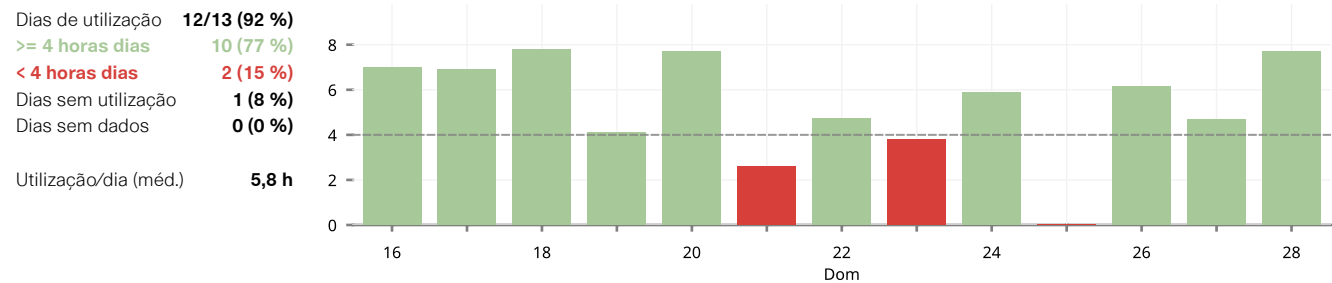

Fuga (l/min)

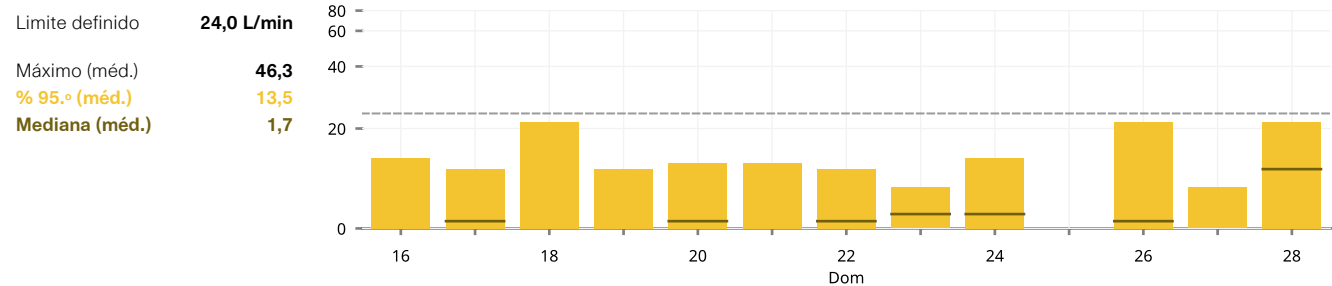

Pressão (cmH2O)

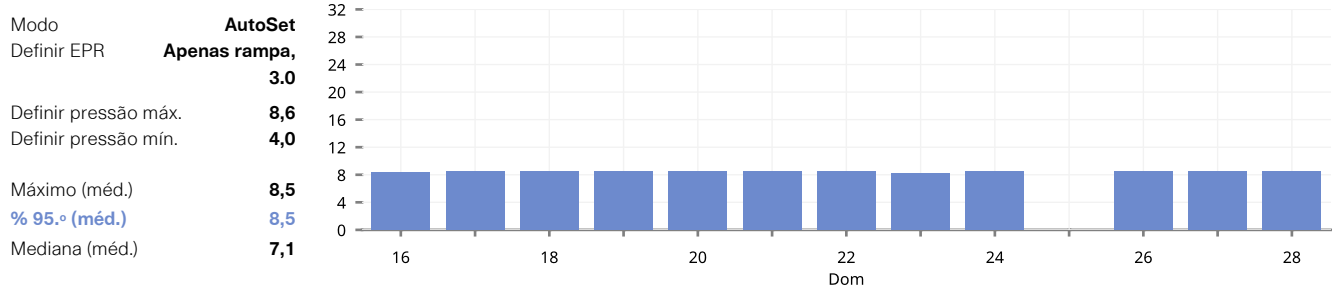

IAH (eventos/hora)

