


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/01/2026 - 10/02/2026
Dias de utilização		5/11 dias (45%)
>= 4 horas		5 dias (45%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		26 horas 58 minutos
Utilização média (total de dias)		2 horas 27 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 24 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 18 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/02/2026)		2,983 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221596628
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 9.1	Percentil 95.º: 29.5	Máximo: 35.5	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.3	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.8
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

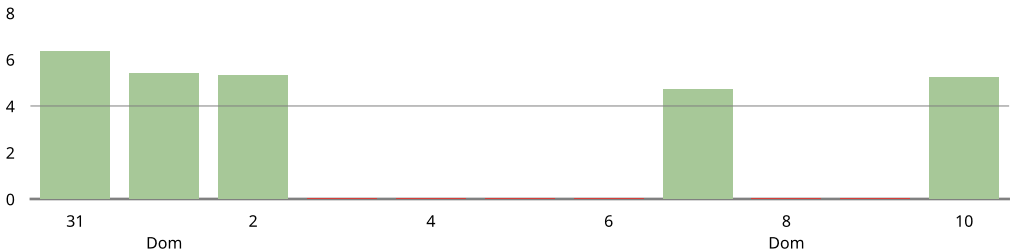


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


Utilização (horas)

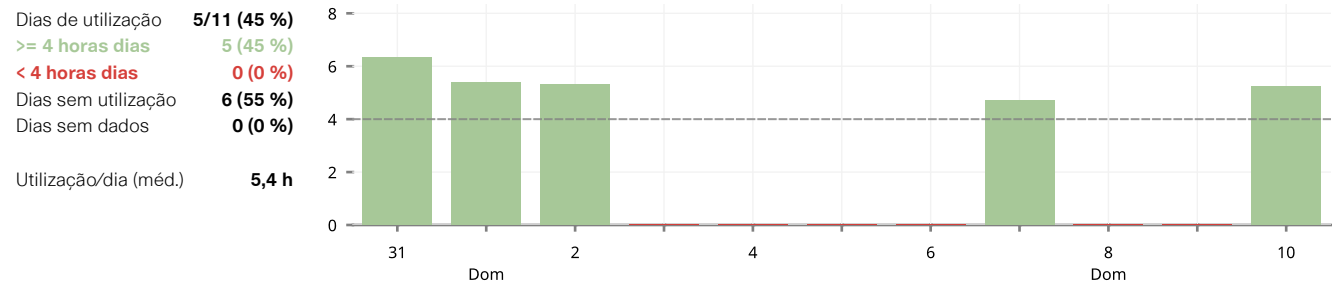

Fuga (l/min)

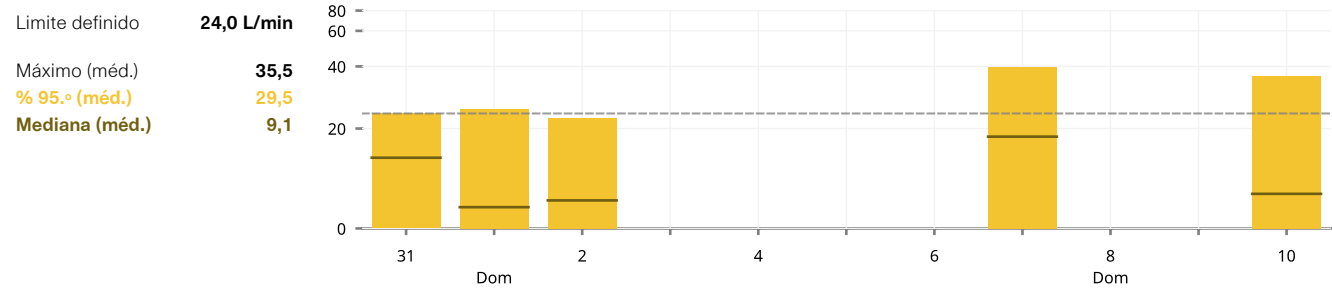

Pressão (cmH2O)

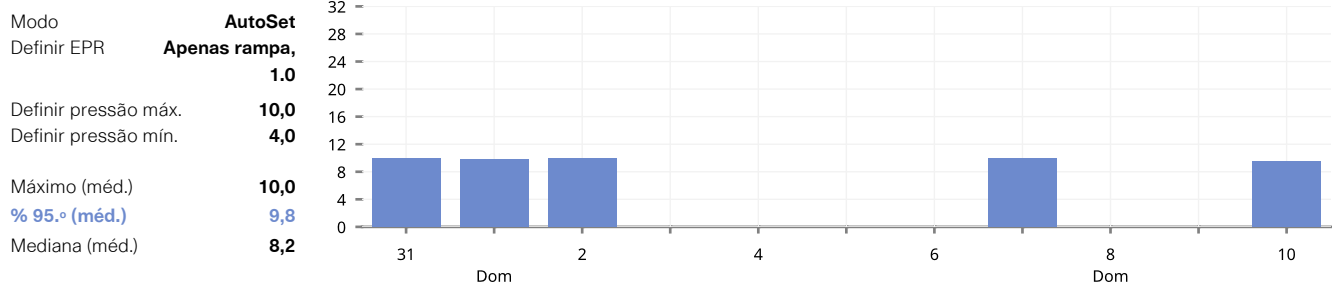

IAH (eventos/hora)

