


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		31/01/2026 - 06/02/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		39 horas 3 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 35 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 35 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 32 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/02/2026)		6,301 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291907
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 9.7	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 5.8	Máximo: 21.3	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.2	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

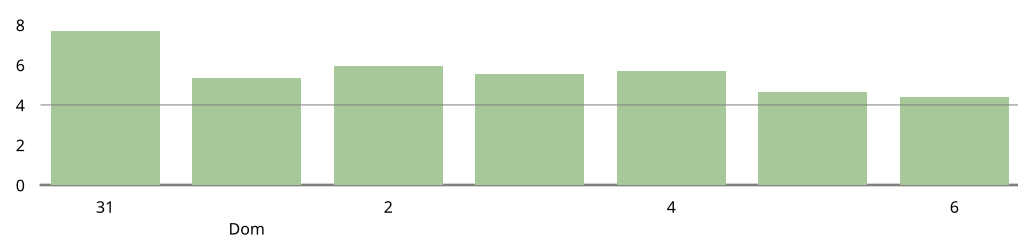


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291907


Utilização (horas)

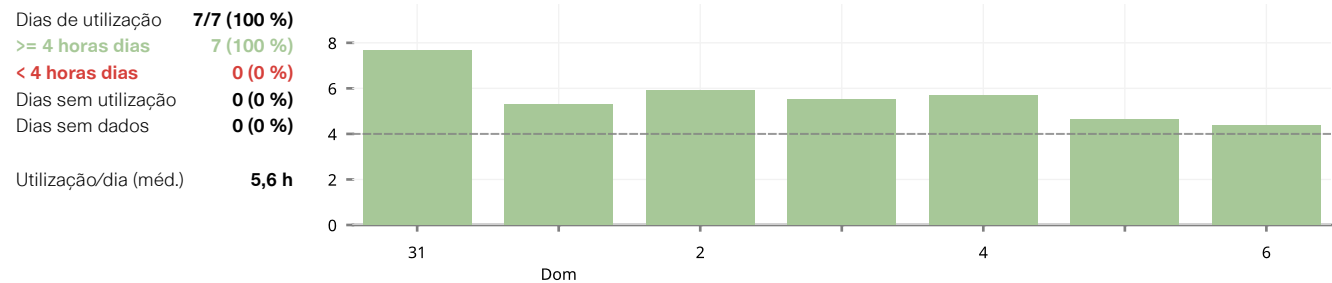

Fuga (l/min)

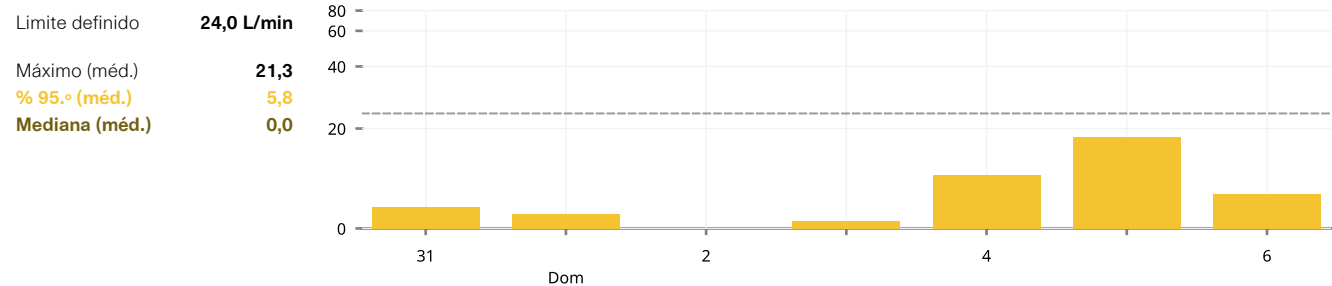

Pressão (cmH2O)

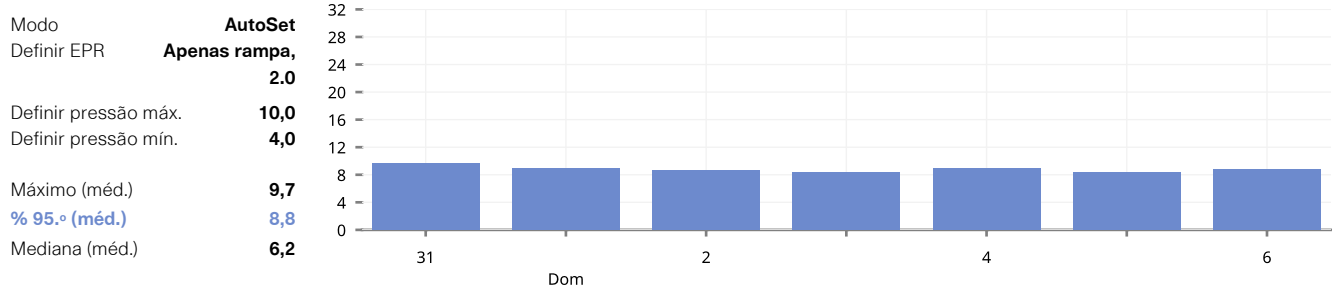

IAH (eventos/hora)

