


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/02/2026 - 28/02/2026
Dias de utilização	11/22 dias (50%)	
>= 4 horas	4 dias (18%)	
< 4 horas	7 dias (32%)	
Horas de utilização	35 horas 55 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 39 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/02/2026)	2,928 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221597120
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 4.7	Percentil 95.º: 5.1	Máximo: 5.5	
Fugas — l/min	Mediana: 11.5	Percentil 95.º: 18.4	Máximo: 26.8	
Eventos por hora	IA: 2.6	IH: 0.1	IAH: 2.7	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	2.3
Índice RERA	1.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

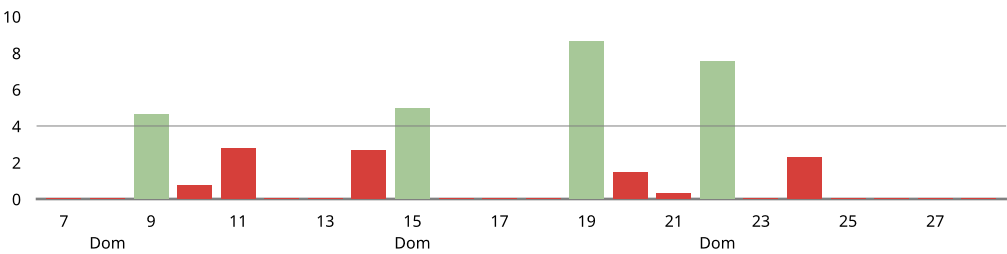


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221597120


Utilização (horas)

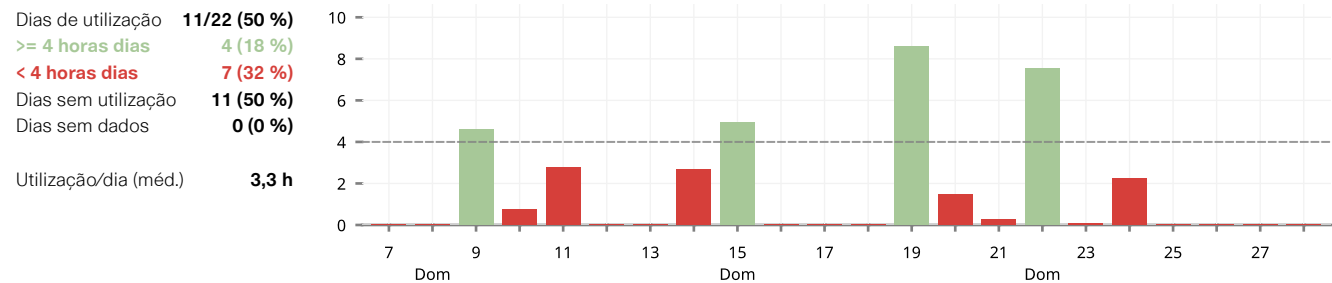

Fuga (l/min)

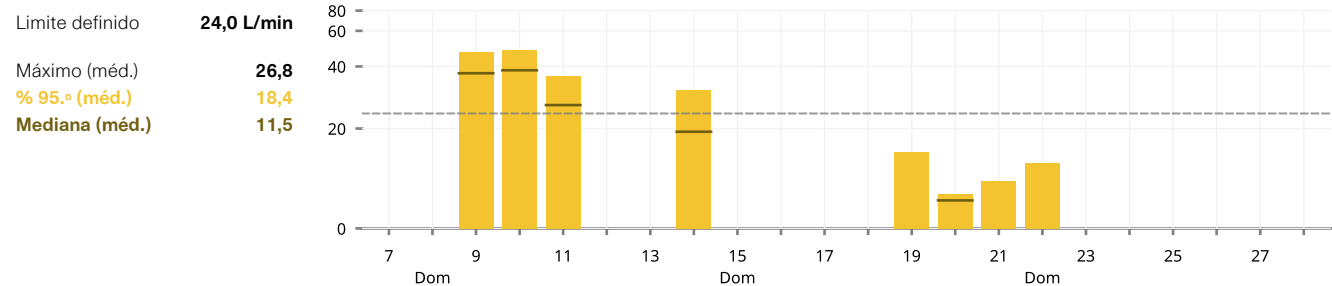

Pressão (cmH2O)

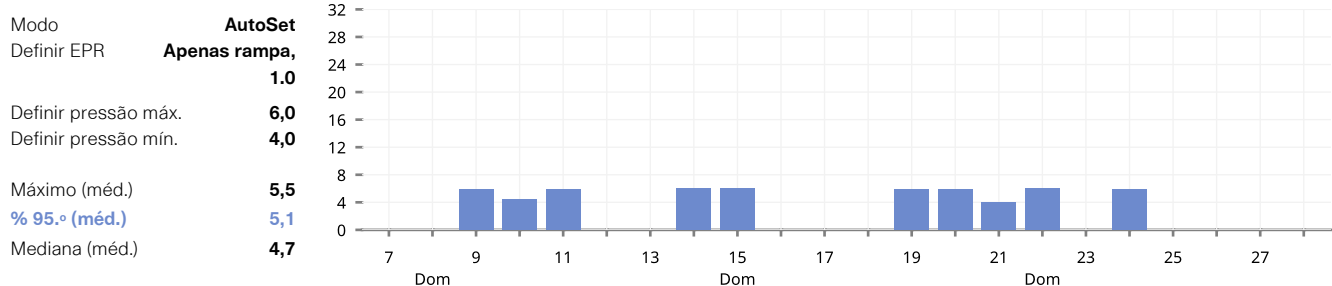

IAH (eventos/hora)

