


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 26/02/2026 - 03/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 6/6 dias (100%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 6 dias (100%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 49 horas 32 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 8 horas 15 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 8 horas 15 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 8 horas 51 minutos  |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 03/03/2026) | 2,898 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22231024638 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 5 cmH2O     |
| Pressão máx.        | 9 cmH2O     |
| EPR                 | Desl.       |
| Resposta            | Suave       |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 7.5   | Percentil 95.º: 8.9  | Máximo: 8.9  |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 1.2   | Percentil 95.º: 14.4 | Máximo: 24.6 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.5        | IH: 0.7              | IAH: 1.2     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.2   | Obstrutiva: 0.3      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.2            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

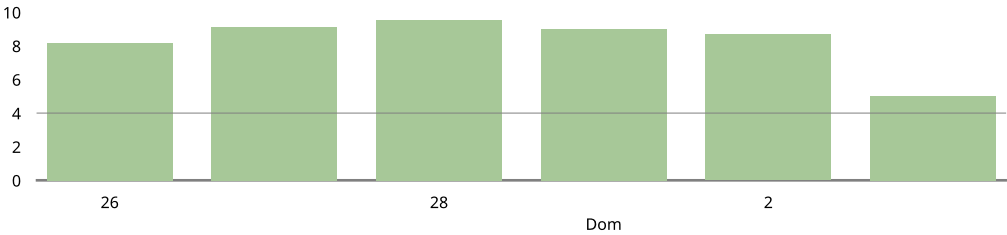


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


## Utilização (horas)

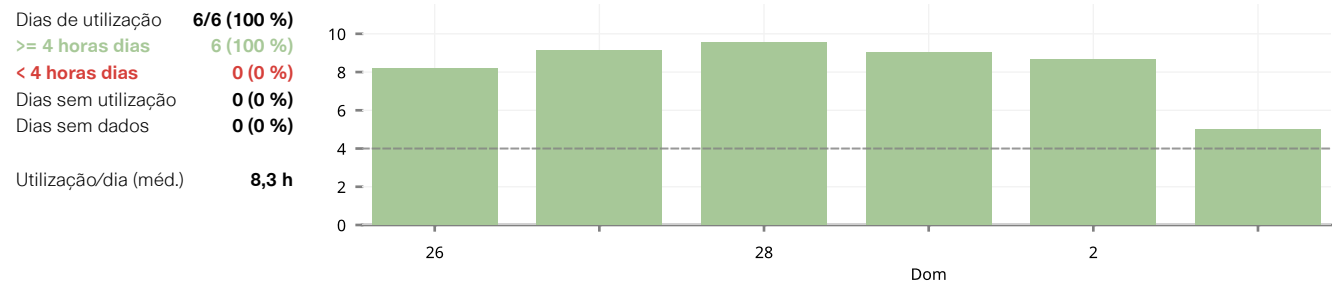

## Fuga (l/min)

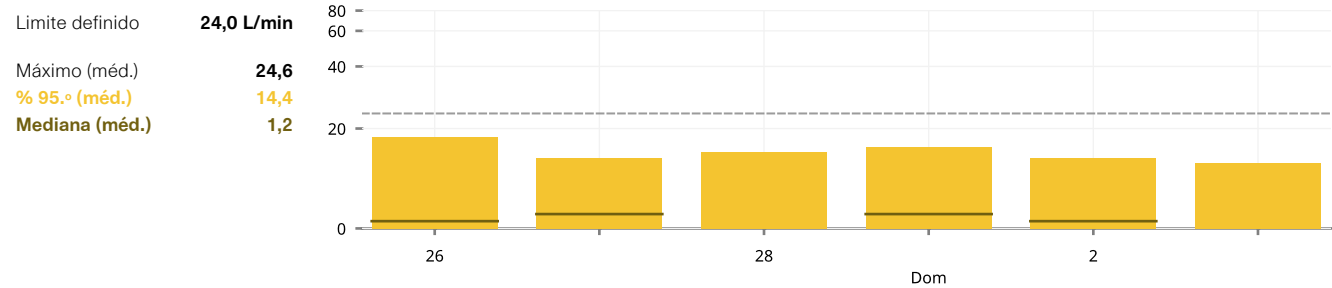

## Pressão (cmH2O)

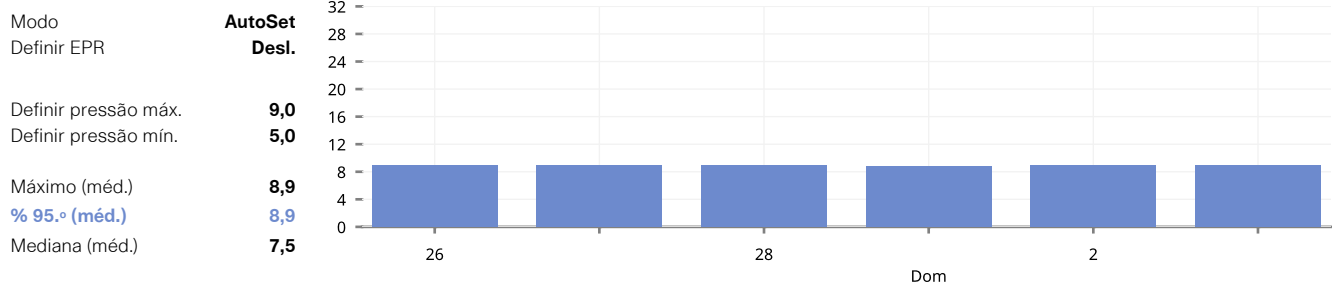

## IAH (eventos/hora)

