


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/03/2026 - 22/03/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		54 horas 43 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 49 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 49 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 27 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)		3,021 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	CPAP
Pressão definida	7.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 2.1	Percentil 95.º: 14.7	Máximo: 23.8	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

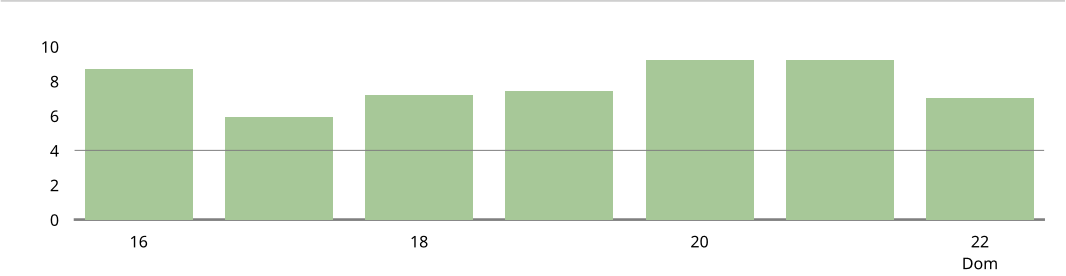

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

Utilização (horas)

Dias de utilização**7/7 (100 %)**
>= 4 horas dias**7 (100 %)**
< 4 horas dias**0 (0 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.)**7,8 h**

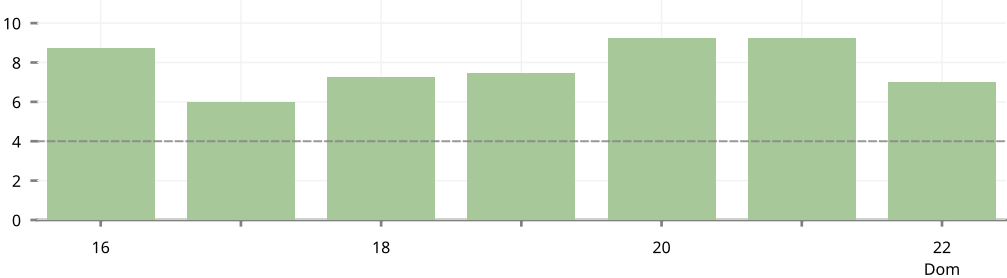

Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**


Máximo (méd.)**23,8**
% 95.º (méd.)**14,7**
Mediana (méd.)**2,1**

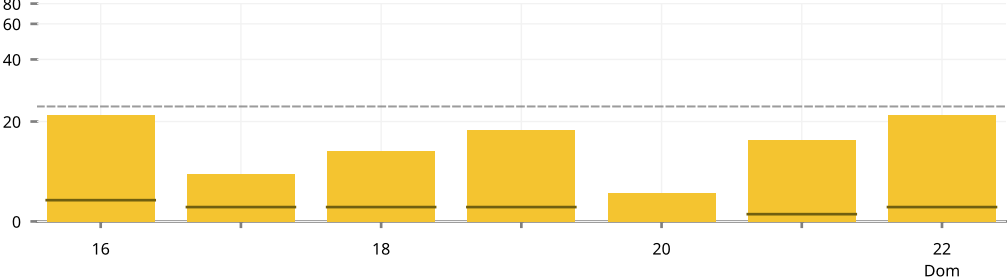

Pressão (cmH2O)

Modo**CPAP**
Definir EPR**Desl.**

Pressão definida**7,6**

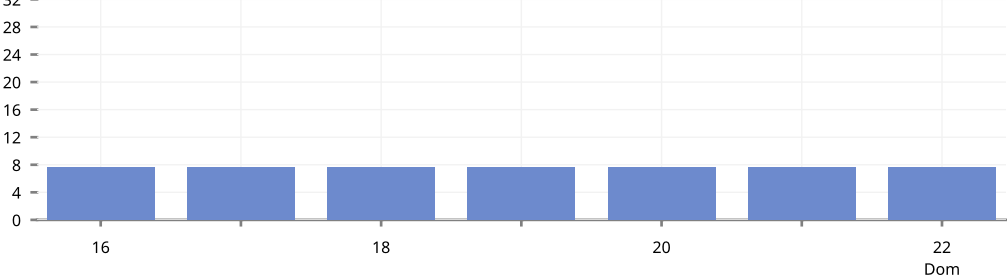

IAH (eventos/hora)

IAH ☐
IH ☐
IA ☐

IAC
IAO
IAD
RERA
%RCS (méd.)

0.4
0.1
0.3

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

