


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/02/2026 - 12/02/2026
Dias de utilização		1/1 dias (100%)
>= 4 horas		1 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		8 horas 20 minutos
Utilização média (total de dias)		8 horas 20 minutos
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 20 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 20 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/02/2026)		2,244 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.9	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 14.4	Máximo: 31.2	
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 1.2	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 1.4	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

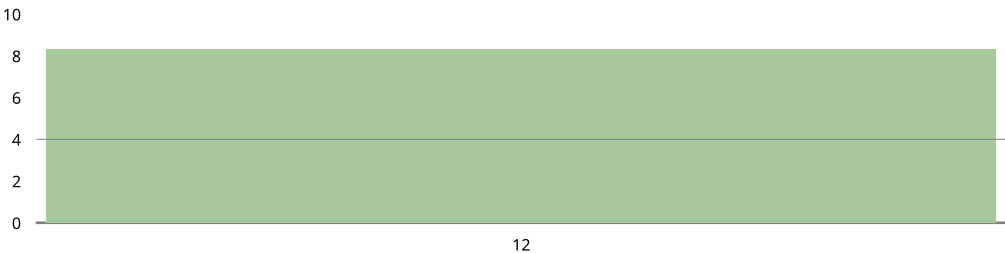


Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


Utilização (horas)

Dias de utilização	1/1 (100 %)
>= 4 horas dias	1 (100 %)
< 4 horas dias	0 (0 %)
Dias sem utilização	0 (0 %)
Dias sem dados	0 (0 %)
Utilização/dia (méd.)	8,3 h

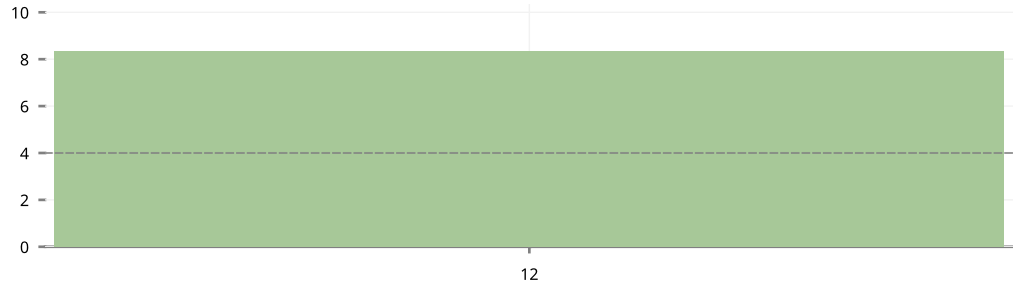


Fuga (l/min)

Limite definido	24,0 L/min
Máximo (méd.)	31,2
% 95.º (méd.)	14,4
Mediana (méd.)	1,2

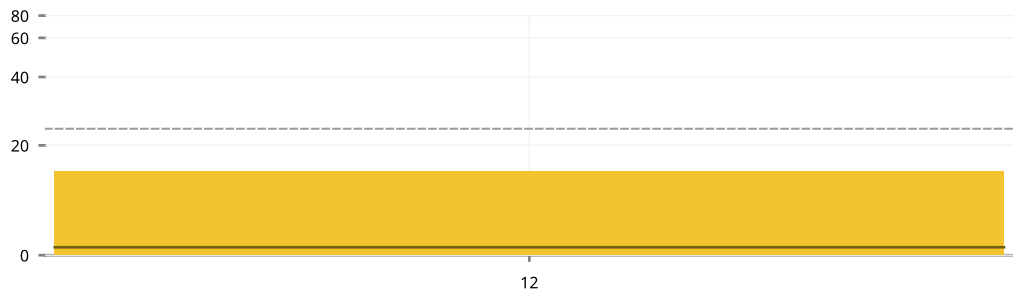

Pressão (cmH2O)

Modo	AutoSet
Definir EPR	Apenas rampa, 2.0
Definir pressão máx.	10,0
Definir pressão mín.	4,0
Máximo (méd.)	10,0
% 95.º (méd.)	8,9
Mediana (méd.)	5,9

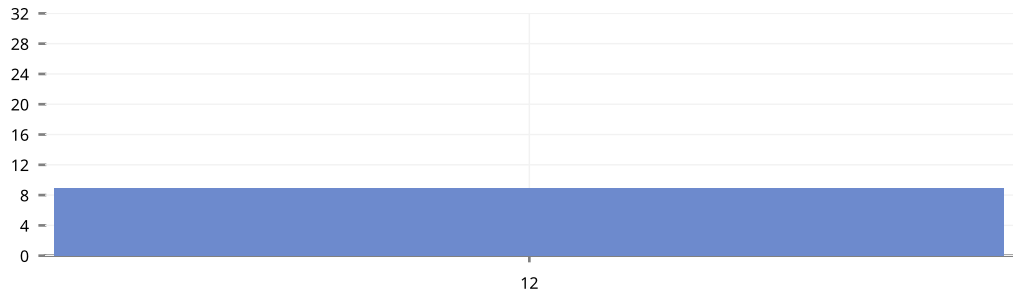

IAH (eventos/hora)

IAH	3.9
IH	1.2
IA	2.7
IAC	1.2
IAO	1.4
IAD	0.1
RERA	0.0
%RCS (méd.)	0.0

