


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/03/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização	29/29 dias (100%)	
>= 4 horas	27 dias (93%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	208 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)	208 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032389
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.0	Percentil 95.º: 7.5	Máximo: 7.5	
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 21.6	Máximo: 28.0	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.7	IAH: 2.5	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

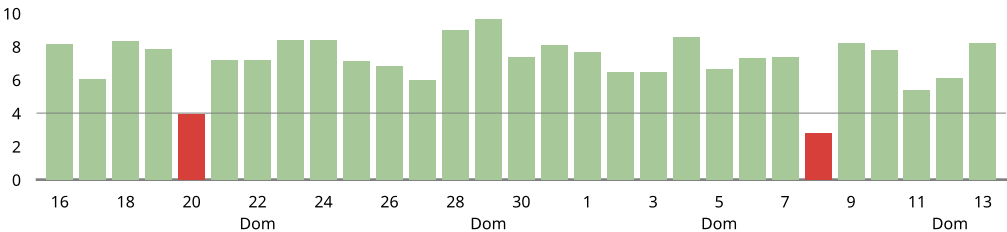


Relatório de terapia


AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032389


Utilização (horas)

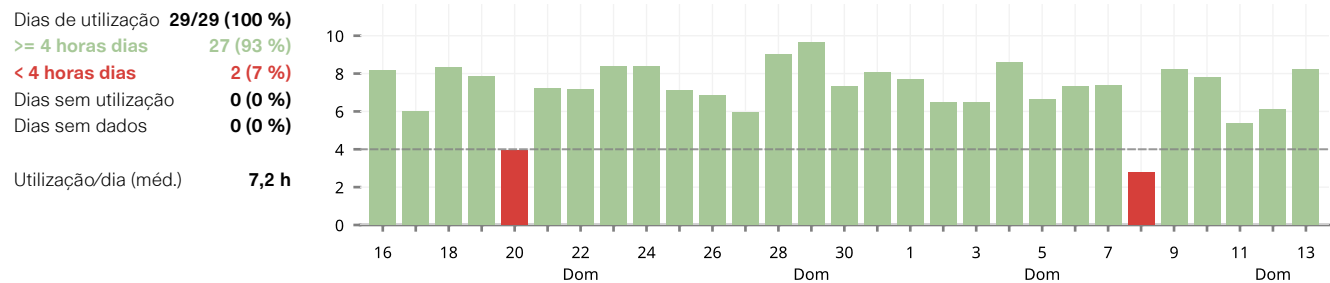


Fuga (l/min)

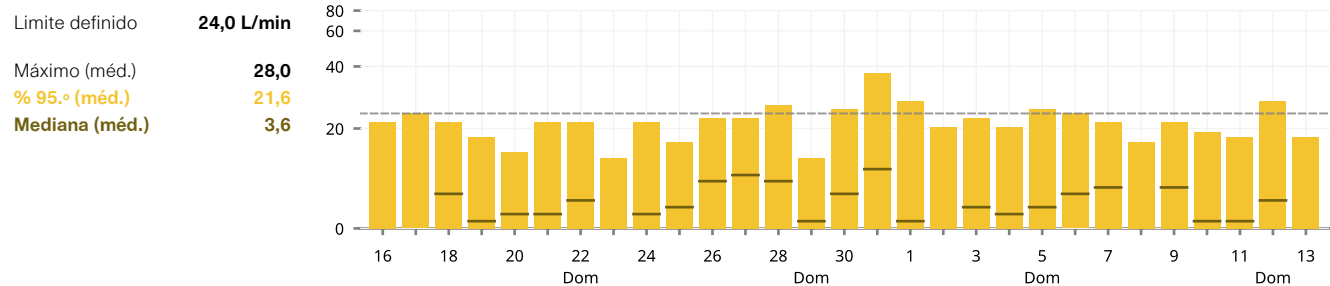

Pressão (cmH2O)

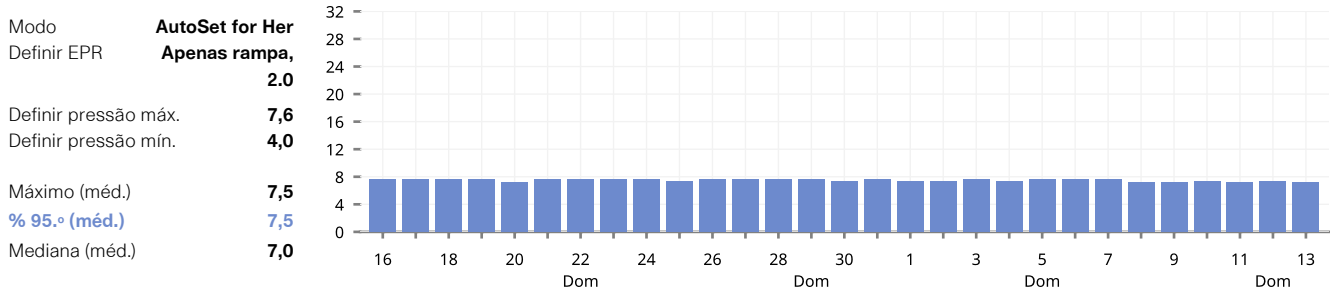


IAH (eventos/hora)

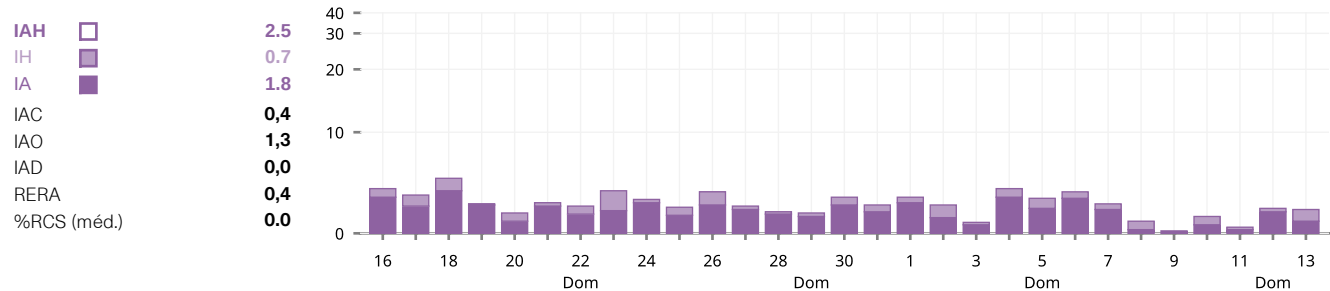


Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032389

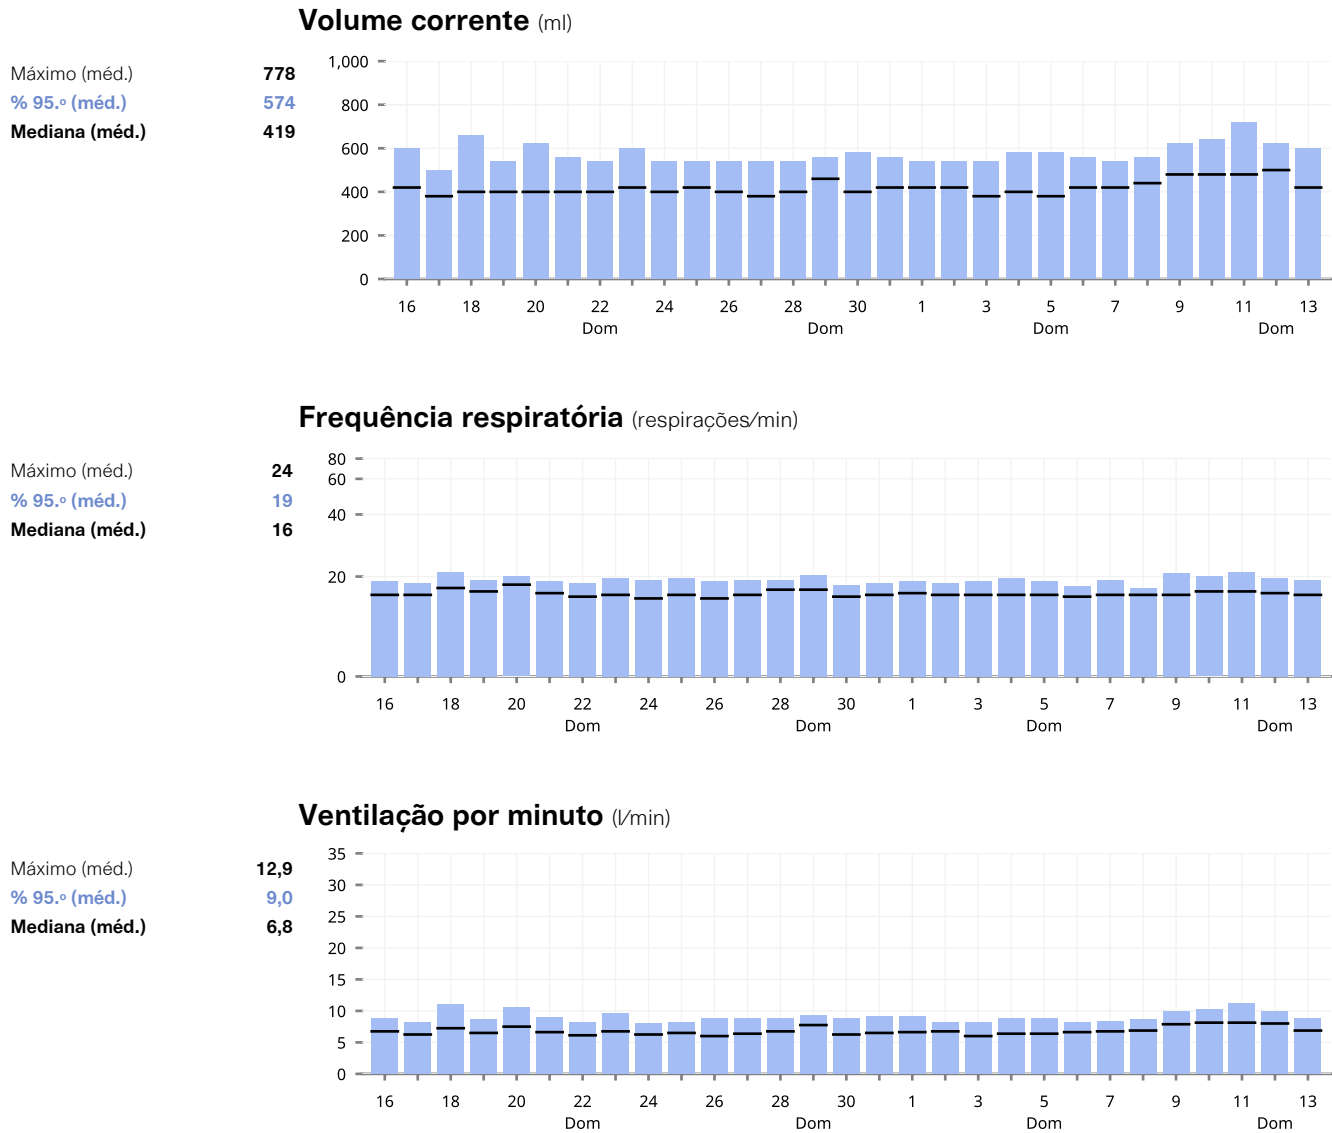

Ventilação por minuto (l/min)

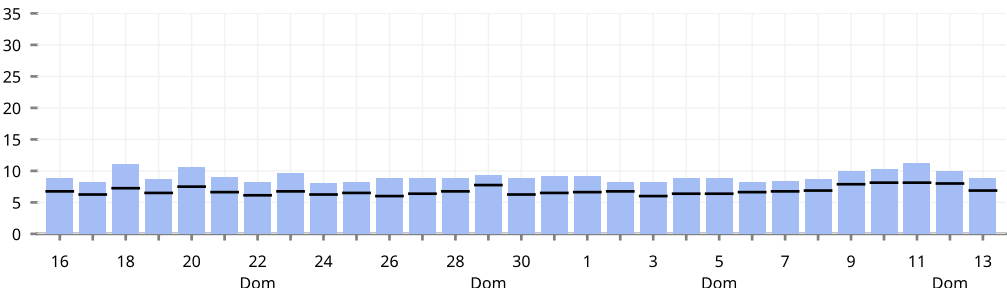

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032389

Care Check-In

06/04/2026	
Quão sonolento você se sentiu esta semana?	Levemente sonolento 
Como está sua terapia?	Bem 

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento