



YCL.M000696

其余：3.2

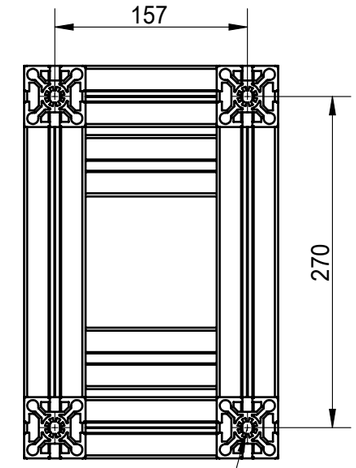

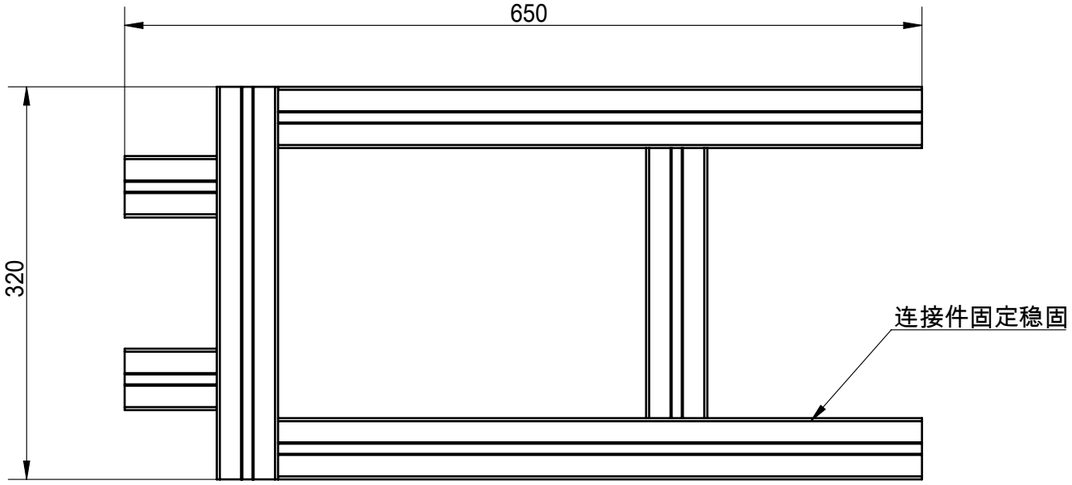

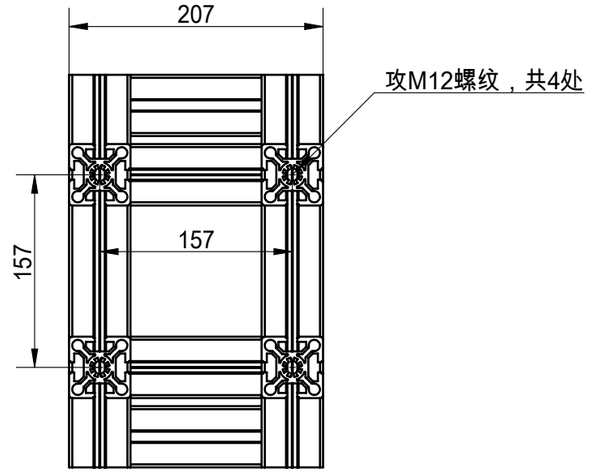

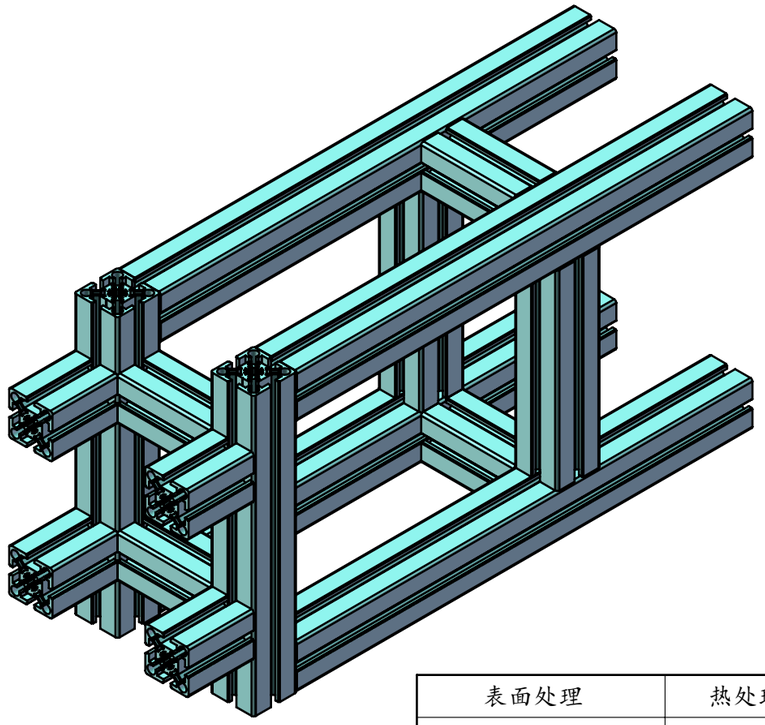

技术要求

1. 去除尖角、飞边、毛刺；
2. 未注棱边0.5×45° 倒钝；螺纹孔孔口倒钝；
3. 未注线性尺寸公差均采用GB/T 1800.3-98标准公差IT13级执行；
4. 未注形位尺寸公差按：GB/T1184-1996 K级执行；
5. 带▲尺寸为关键必检尺寸，需逐件检测并记录；

表面处理	热处理（含化学）	零件名称	图纸代号	材料材质	数量
		胸腔立柱	YCL.M000696	AL6061	
备注				材料标准	

上海萝博派对科技有限公司
Shanghai RoboPartyTechnology Co., Ltd

未标注公差/Limit

线性 \ Liner Measure							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1
倒角 \ Chamfer				角度 / Angle			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

人 员		日 期		版本号	重量	比 例
设 计	张正昱	设 计	2026/7/16		4.3	1:10
审 核		审 核		图纸大小	A3	
批 准		批 准		共 1 张	第 1 张	

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期