

光电效应与普朗克常数测量

Photon-Electron Effect and Planck Constant Measurement

【实验目的】

- 1, 通过实验加深对光的量子性的认识;
- 2, 验证爱因斯坦方程, 并测量普朗克常数以及阴极材料的“红限”频率。

【预备问题】

1. 光电效应的物理原理
2. 光电效应实验的设计思路
3. 普朗克常数的引入和意义

【实验背景】

1887 年德国物理学家 H. R. 赫兹发现电火花间隙受到紫外线照射时会产生更强的电火花。赫兹的论文《紫外光对放电的影响》发表在 1887 年《物理学年鉴》上。论文详细描述了他的发现。赫兹的论文发表后, 立即引起了广泛的反响, 许多物理学家纷纷对此现象进行了研究, 用紫外光或波长更短的 X 光照射一些金属, 都观察到金属表面有电子逸出的现象, 称之为光电效应。

对光电效应现象的研究, 使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质, 促进了光量子理论的建立和近代物理学的发展, 现在光电效应以及根据光电效应制成的各种光电器件已被广泛地应用于工农业生产、科研和国防等各领域。

【实验原理】

一、光电效应及其实验规律

当一定频率的光照射到某些金属表面上时, 可以使电子从金属表面逸出, 这种现象称为光电效应, 所产生的电子称为光电子。

研究光电效应的实验装置如图 1 所示, 入射光照射到阴极 K 时, 由光电效应产生的光电子以某一初动能飞出, 光电子受电场力的作用向阳极 A 迁移而构成光电流。一定频率的光照射阴极 K 所得到的光电流 I 和两极间的电压 U 的实验曲线如图 2 所示。随着光电管两端电压的增大, 光电流趋于一个饱和值 I_m , 当 $U \leq U_s$ 时, 光电流为零, U_s 称为反向遏止电压。

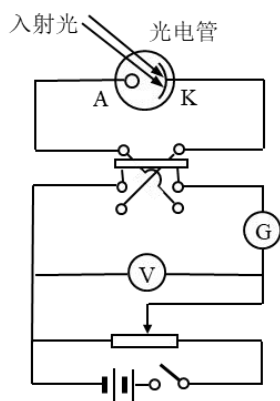


图 1 光电效应实验装置示意图

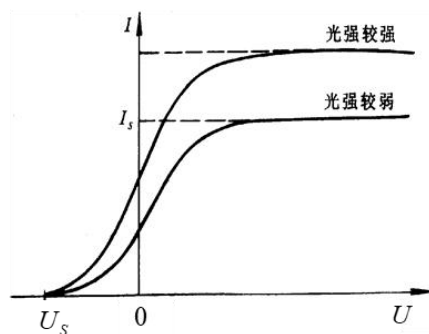


图 2 $U-I$ 特性曲线

总结所有的实验结果，光电效应的实验规律可归纳为：

1. 对于一种阴极材料，当照射光的频率确定时，饱和光电流 I_m 的大小与入射光的强度成正比。
2. 反向截止电压 U_s 的物理含义是：当在光电管两端所加的反向电压为 U_s 时，则逸出金属电极 K 后具有最大动能的电子也不能到达阳极 A，此时有

$$eU_s = \frac{1}{2} mV_{\max}^2 \quad (1)$$

实验得出光电子的初动能与入射光的强度无关，而只与入射光的频率有关。

3. 光电效应存在一个阈频率 ν_0 ，当入射光的频率 $\nu < \nu_0$ 时，不论光的强度如何都没有光电子产生。
4. 光电效应是瞬时效应，只要照射光的频率大于 ν_0 ，一经光线照射，立刻产生光电子，响应时间为 $10^{-9}s$ 。

对于这些实验事实，经典的波动理论无法给出圆满的解释。按照电磁波理论，电子从波阵面连续地获得能量。获得能量的大小应当与照射光的强度有关，与照射的时间长短有关，而与照射光的频率无关。因此对于任何频率的光，只要有足够的光强度或足够的照射时间，总会发生光电效应。这些结论是与实验结果直接矛盾的。

二、爱因斯坦方程和密立根实验

1905 年爱因斯坦受普朗克量子假设的启发，提出了光量子假说，即：一束光是一粒一粒以光速 c 运动的粒子流，这些粒子称为光子，光子的能量为 $E=h\nu$ (h 为普朗克常数， ν 为光的频率)。当光子照射金属时，金属中的电子全部吸收光子的能量 $h\nu$ ，电子把光子能量的一部分变成它逸出金属表面所需的功 A ，另一部分转化为光电子的动能，即：

$$h\nu = \frac{1}{2} mV_{\max}^2 + A \quad (2)$$

式中： h 为普朗克常数，公认值为 $6.62916 \times 10^{-34} J \cdot s$ 。(2) 式就是著名的爱因斯坦光电效应方

程。

根据这一理论，光电子的能量只决定于照射光的频率，并与之成线性关系。由（2）式可见，只有当 $h\nu \geq A$ 时，才会有光电子发射，我们把 A/h 记作 ν_0 ，即

$$\nu_0 = \frac{A}{h} \quad (3)$$

这就是说 ν_0 是能发生光电效应的入射光的最小频率，显然它的值随金属种类不同而不同，又称“红限”频率。

爱因斯坦光子理论圆满地解释了光电效应的各条实验规律。

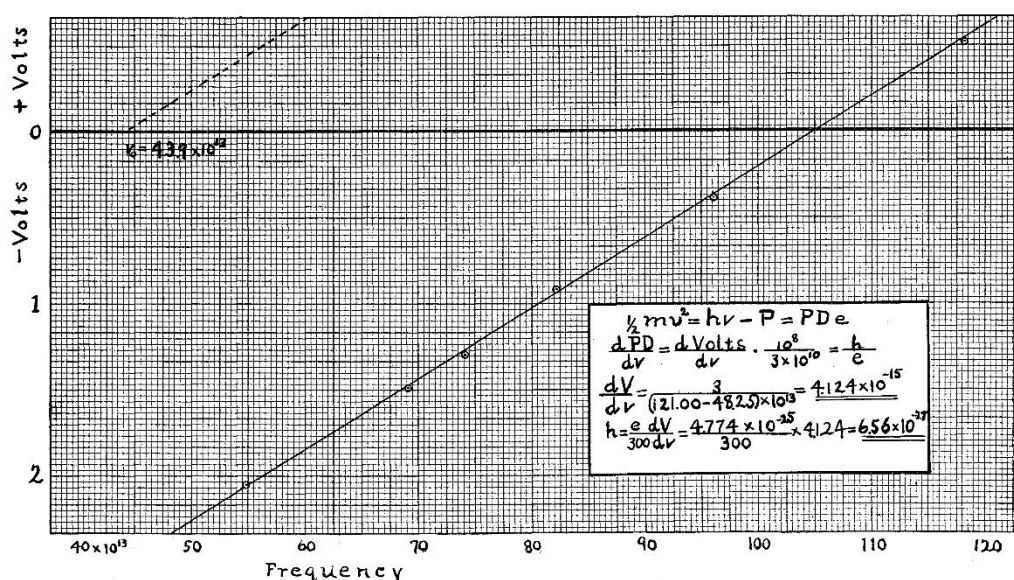


图3 $U_s - \nu$ 特征曲线，图片来自文献[1], P373

爱因斯坦的光子理论由于与经典电磁理论抵触，一开始受到怀疑和冷遇。一方面是因为人们受传统观念的束缚，另一方面是因为当时光电效应的实验精度不高，无法验证光电效应方程。密立根从1904年开始光电效应实验，1912-1915年间，密立根对一些金属进行测量，得出了光电子的最大动能和入射光频率之间的严格线性关系（图3），直线在横轴上的交点 ν_0 ，说明照射光的频率小于 ν_0 时不会有光电子发射。不同的金属其 ν_0 值不同，但所有的金属直线的斜率却是不变的。密立根于1916年发表论文证实了爱因斯坦方程的正确性，并直接运用光电方法对普朗克常数 h 作了首次测量。

历经十年，密立根用实验证实了爱因斯坦的光量子理论。两位物理大师因在光电效应等方面的杰出贡献，分别于1921和1923年获得诺贝尔物理学奖。

光量子理论创立后，在固体比热，辐射理论，原子光谱等方面都获得成功，人们逐步认识到光具有波动和粒子二象属性。光子的能量 $E=h\nu$ 与频率有关，当光传播时，显示出光的波动性，产生干涉，衍射，偏振等现象；当光和物体发生作用时，它的粒子性又突出了出来。后来科学家发现波粒二象性是一切微观物体的固有属性，并发展了量子力学来描述和解释微

观物体的运动规律，使人们对客观世界的认识前进了一大步。

三、普朗克常数的测量原理

根据爱因斯坦光电效应方程（2）式、截止电压 U_S 与光电子的最大初动能的关系（2）式以及“红限”频率 ν_0 与逸出金属表面所需的功 A 之间的关系（3）式，可得到：

$$e|U_S| = h(\nu - \nu_0) \quad (4)$$

此式表明截止电压 U_S 是频率 ν 的线性函数，相应的曲线如图 4 所示，可知 $U_S - \nu$ 直线的斜率为：

$$k = \frac{h}{e} \quad (5)$$

直线的延长线对纵轴的截距为

$$U_0 = \frac{A}{e} \quad (6)$$

$U_S - \nu$ 直线与横轴的交点为阴极材料的“红限”频率 ν_0 。

综上所述，通过用不同频率的光照射阴极，测得相应的截止电压，得出 $U_S - \nu$ 关系，即可求得 h 、 ν_0 、 A 。

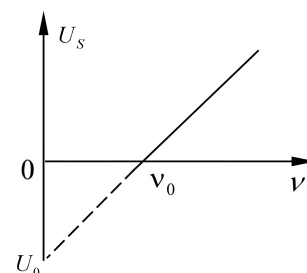


图 4 照射光频率与截止电压的关系

四、影响准确测量截止电压的因素以及测量方案

测量普朗克常数 h 的关键是正确的测出截止电压 U_S ，但实际上由于光电管制作工艺等原因，给准确测定截止电压带来了一定的困难。实际测量的光电管伏安特性曲线与理论曲线有明显的偏差，引起这种偏差的主要原因有：

1. 在无光照时，也会产生电流，

称之为暗电流。它是由阴极

在常温下的热电子发射形成

的热电流和封闭在暗盒里的光电管在外加电压下因管子阴极和阳极间绝缘电阻漏电而产生的漏电流两部分组成。

2. 受环境杂散光影响形成的本底电流。

3. 由于制作光电管时阳极上往往溅有阴极材料，所以当光照射到阳极上和杂散光漫射到阳极上时，阳极上往往有光电子发射。形成阳极反向电流。

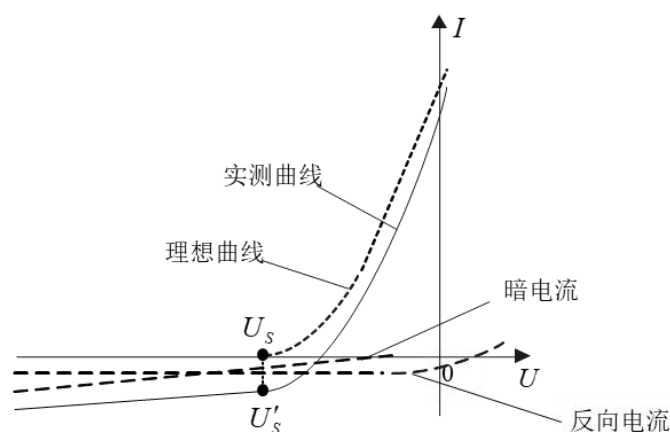


图 5 $U-I$ 实验曲线

其中以漏电流和阳极反向电流影响最大。

由于上述原因,实际测量的光电管伏安特性曲线如图 5 所示。实验曲线在负电压区下沉,截止电压并不对应光电流为零,而对应反向电流开始趋于常量的点(拐点) U'_s 。对此,一种解决方案是:通过实验测量光电管的伏安特性,根据 $U-I$ 实验曲线分析其“拐点” U'_s ,由此得出截止电压 U_s ,此方法称为“拐点法”(本实验不用)。

本实验仪器采用了新型结构的光电管。由于其特殊结构使光不能直接照射到阳极,由阴极反射照到阳极的光也很少,加上采用新型的阴、阳极材料及制造工艺,使得阳极反向电流大大降低,暗电流水平也很低。由于本仪器的特点,在测量各谱线的截止电压 U_s 时,可不用难于操作的“拐点法”,而用“零电流法”或“补偿法”。

零电流法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_s 。此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小,用零电流法测得的截止电压与真实值相差很小。且各谱线的截止电压都相差 ΔU 对 $U_s-\nu$ 曲线的斜率无大的影响,因此也不影响 h 的测量。

补偿法是调节电压 U_{AK} 使电流为零后,保持 U_{AK} 不变,遮挡汞灯光源,此时测得的电流 I_1 为电压接近截止电压时的暗电流和本底电流。重新让汞灯照射光电管,调节电压 U_{AK} 使电流值至 I_1 ,将此时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_s 。此法可补偿暗电流和本底电流对测量结果的影响。

【实验仪器】

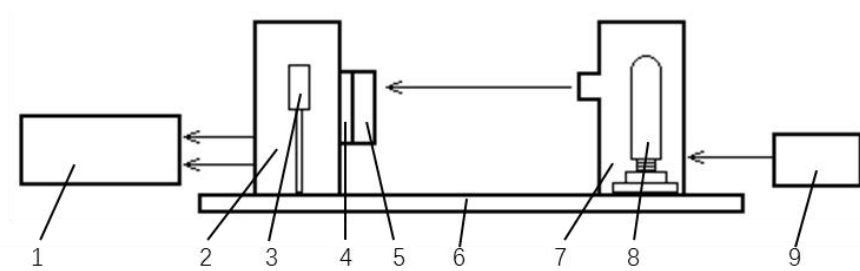


图 6 光电效应实验仪结构示意图

其中: 1-测试仪、2-光电管暗盒、3-光电管、4-光阑选择圈、5-滤色片选择圈、6-基座、7-汞灯暗盒、8-汞灯、9-汞灯电源

ZKY-GD-3+Z 型光电效应实验仪结构如图 6 所示。仪器由汞灯及电源,滤色片,光阑,光电管、测试仪组成,测试仪的调节面板如图 7 所示。



图7 仪器前面板示意图

1. 高压汞灯：在其发光的光谱范围内较强的谱线有 365nm、405nm、436nm、546nm、570nm。
2. 滤光片：仪器配有五种带通型滤光片，其透射波长为 365nm、405nm、436nm、546nm、570nm。
3. 光阑：仪器配有孔径分别为 2mm、4mm、8mm 的光阑，可通过调节光阑旋钮转换。
4. 光电管：阳极为镍圈，阴极为银-氧-钾 (Ag-O-K)，光谱响应范围 320 ~ 700nm，暗电流： $I \leq 2 \times 10^{-12} \text{A}$ ($-4 \text{V} \leq U_{AK} \leq 0 \text{V}$)。
5. 测试仪：它包括光电管工作电源和微电流放大器两部分。
 光电管工作电源：2 档， $-4 \sim 0 \text{V}$ ， $-4 \sim +30 \text{V}$ ，三位半数显，稳定度 $\leq 0.1\%$ 。
 微电流放大器：6 档， $10^{-8} \sim 10^{-13} \text{A}$ ，分辨率 10^{-13}A ，三位半数显，稳定度 $\leq 0.2\%$ 。

【实验内容】

测试前准备

该实验建议环境温度为 $15 \sim 30^\circ \text{C}$ ，湿度 $< 70\%$ 。实验前宜将光电管闭光 24 小时，即将光电管暗盒的光阑选择圈调整到任意两个光阑的中间位置，并盖上光电管暗盒遮光盖，以此遮住光电管 24 小时，以使得光电管的暗电流尽量小且稳定。

将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口，调整光电管与汞灯距离为约 40cm 并保持不变。盖上汞灯光源遮光盖，打开汞灯光源，预热至少 20 分钟，使其电路工作稳定，汞灯光强稳定。注意：汞灯点亮时请勿直视汞灯光源，以免强光伤眼。

打开测试仪电源，预热至少 10 分钟，使其电路工作稳定。

需了解的测试仪调零方法：将“电流量程”选择开关置于所选档位，仪器在充分预热后，进行测试前调零。调零时，将“调零/测量”切换开关切换到“调零”档位，旋转“电流调零”旋钮使电流指示为“000.0”。调节好后，将“调零/测量”切换开关切换到“测量”档位，就可以进行实验了。

注意：

* 在电流量程或电压档位切换时，必须按照上面的调零方法进行调零，否则会影响实验精

度。

* 实验应先测量普朗克常数后测量光电管伏安特性，避免暗电流过大影响前者实验精度。

一、测量普朗克常数 h 、“红限”频率 ν_0

1. 用零电流法测定 h 和 ν_0

将电压选择按键置于-4V~0V 档；将“电流量程”选择开关置于 10^{-13}A 档，将测试仪电流输入电缆断开，调零后重新接上；旋转光阑选择圈的“ $\Phi 4$ ”光阑及滤色片选择圈的“365”滤色片到“↓”下方，打开汞灯暗盒遮光盖开始实验。

从低到高往 0V 电压方向调节电压（应尽量避免光电流大幅超过零后的回调），用“零电流法”测量该波长对应的 U_s ，重复测量 4 次，记录数据。

旋转滤色片选择圈，依次换 405nm，436nm，546nm，577nm 的滤色片，重复以上测量步骤。

表 1 零电流法测定 h 和 ν_0

光阑孔 $\Phi = 4\text{ mm}$

波长 λ (nm)		365	405	436	546	577
频率 ν ($\times 10^{14}\text{Hz}$)		8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
截止电压 U_s (V)	1					
	2					
	3					
	4					
	平均值					

2. 用补偿法测定 h 和 ν_0 （选做）

要求：可以只选择一个光阑，每个频率下至少重复测量 3 次，自己设计实验。

二、测量光电管的伏安特性曲线 (I - U 曲线)

盖上汞灯及光电管暗盒遮光盖。将电压选择按键置于-4V~+30V 档，将电流量程选择 10^{-13}A 档调零，再切换到“测量”档。将直径 2mm 的光阑及 436nm 的滤色片装在光电管暗盒光输入口上。

取下汞灯遮光盖，从低到高调节电压，电压间隔分段取值（-4~0V: 0.5V； 0~15V: 1.0V； 15~30V: 1.5V），记录电流值，以及电流为零时所对应的电压值。测试中如遇电流值超量程，更换为下一个低精度的电流档（量程顺序 10^{-13}A -- 10^{-12}A -- 10^{-11}A ），更换量程需重新调零！

分别换上直径 4mm 的光阑及 546nm 的滤光片，重复上述测量步骤。（换光阑前需盖上汞灯遮光盖）

表 2 $I-U$ 关系数据

436nm 光阑 2mm	U_{AK} (V)									
	I ($\times 10^{-13}A$)									
546nm 光阑 4mm	U_{AK} (V)									
	I ($\times 10^{-13}A$)									

三、验证光电管的饱和光电流 I_m 与入射光强 P 的正比关系

盖上汞灯及光电管暗盒遮光盖，将“电流量程”选择开关置于 $10^{-10}A$ 档（测量时根据实际情况调节档位），重新调节测试仪零点。将直径 2mm 的光阑及 436nm 的滤色片装在光电管暗盒光输入口。将电压调到 30V，在同一谱线，同一入射距离下，记录光阑分别为 2mm，4mm，8mm 时对应的电流值。（数据记录数量级统一用： $10^{-10}A$ ）

表 3 $I_m - P$ 关系数据

436nm	光阑孔 Φ	2mm	4mm	8mm
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I 的平均值			
546nm	光阑孔 Φ			
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I ($\times 10^{-10}A$)			
	I 的平均值			

由于照到光电管上的光强与光阑面积成正比，用表 3 数据验证光电管的饱和光电流与入射光强成正比。每次换光阑或滤波片后，均需重新调零！

【数据处理】

1. 根据内容一测量数据，分别用作图法和最小二乘法求 h 和 ν_0 ，并与公认值进行比较，计算 h 的相对误差，写出 h 的结果表达式。
2. 根据内容二测量数据，在同一坐标系中画出相应的 $I-U$ 曲线。
3. 根据内容三测量数据，在同一坐标系中画出相应的 I_m-P （这里是相对光强，可以选光阑直径 Φ 的数值的平方作为相对光强）曲线。

【注意事项】

1. 实验过程中注意随时盖上汞灯的遮光盖，严禁让汞灯不经滤光片直接入射光电管窗口。
2. 汞灯一旦开启，不要随意关闭！
3. 在进行每一组实验前，必须对测试仪进行调零，否则会影响实验精度。
4. 电压旋钮缓慢调节，以免损坏仪器！
5. 本实验可不要求在暗室环境，但应尽量避免背景光强的剧烈变化。
6. 实验结束时，将光电管暗盒的光阑选择圈调整到任意两个光阑的中间位置，盖上光电管暗盒遮光盖和汞灯遮光盖！电压及电流回零。

【思考题】

1. 经典的波动理论是如何解释光电效应的各条实验规律？
2. 爱因斯坦光量子假说的内容是什么？它是如何解释光电效应的各条实验规律？
3. 密立根验证爱因斯坦光电效应方程的主要实验思想是什么？
4. 影响准确测量截止电压的主要因素有哪些？
5. 照射光的非单色性如何影响 $U-I$ 特性曲线？

【参考文献】

- [1] R. A. Millikan, *Physical Review*, vol. 7, Issue 3, pp. 355-388, 1916。
- [2] 熊永红等主编，《大学物理实验》，科学出版社，2008 年。
- [3] 母国光等主编，《光学》，人民教育出版社，1979 年。
- [4] 周殿清主编，《基础物理实验》科学出版社，2008 年。