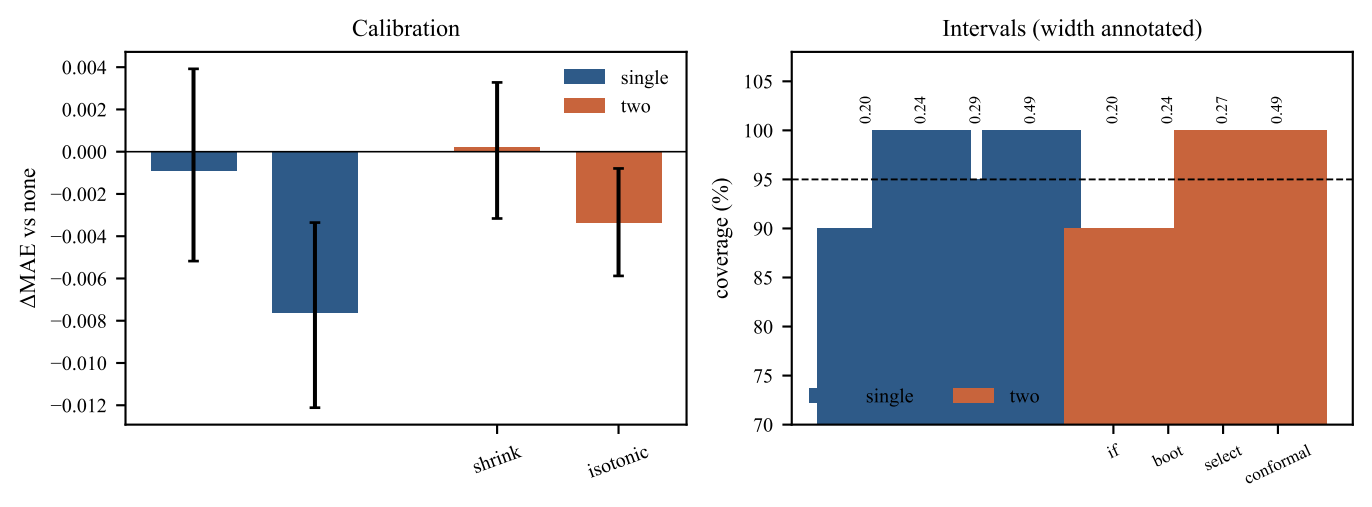
Calibration
ΔMAE vs none
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.010
−0.012
single
two
shrink
isotonic
Intervals (width annotated)
coverage (%)
105
100
95
90
85
80
75
70
0.20
0.24
0.29
0.49
0.20
0.24
0.27
0.49
single
two
if
boot
select
conformal