


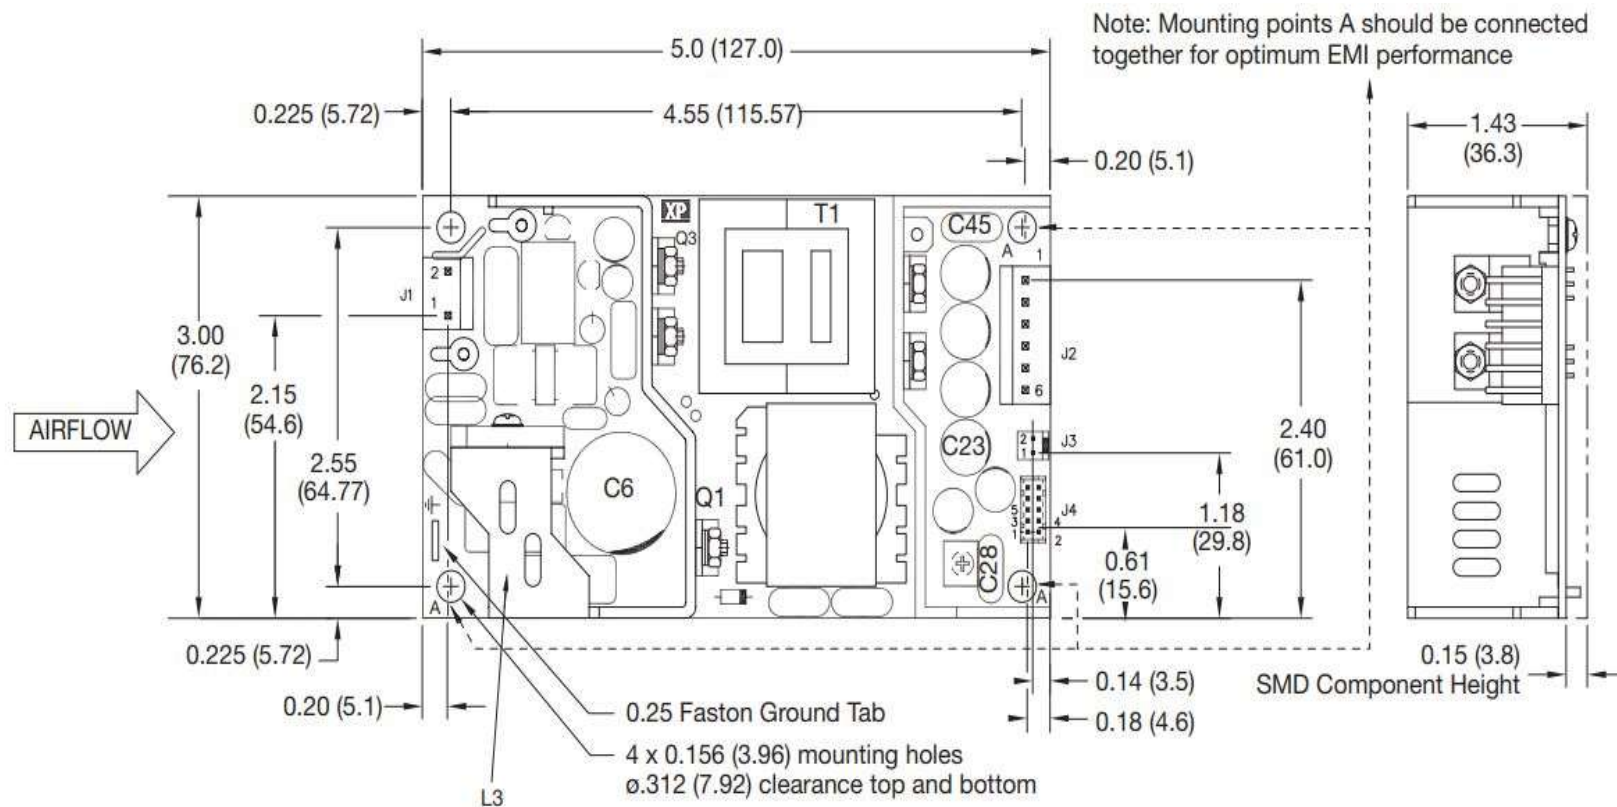

DIGI-KEY:1470-1329-ND

ISOLATION:

INPUT TO OUTPUT 4KVAC

INPUT TO GROUND 1K5VAC

OUTPUT TO GROUND 1K5VAC

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

SEGAINVEX, Dpto. Electrónica

Diseñado: Patricio Coronado

Dibujado: Patricio Coronado

Título: fuente detector de haces moleculares_PWS 2

Tam. Orden de Trabajo: 20220390

A Archivo: <Archivo>

Rev.
V1

Fecha: Tuesday, October 29, 2024

Hoja 1 de 15

