


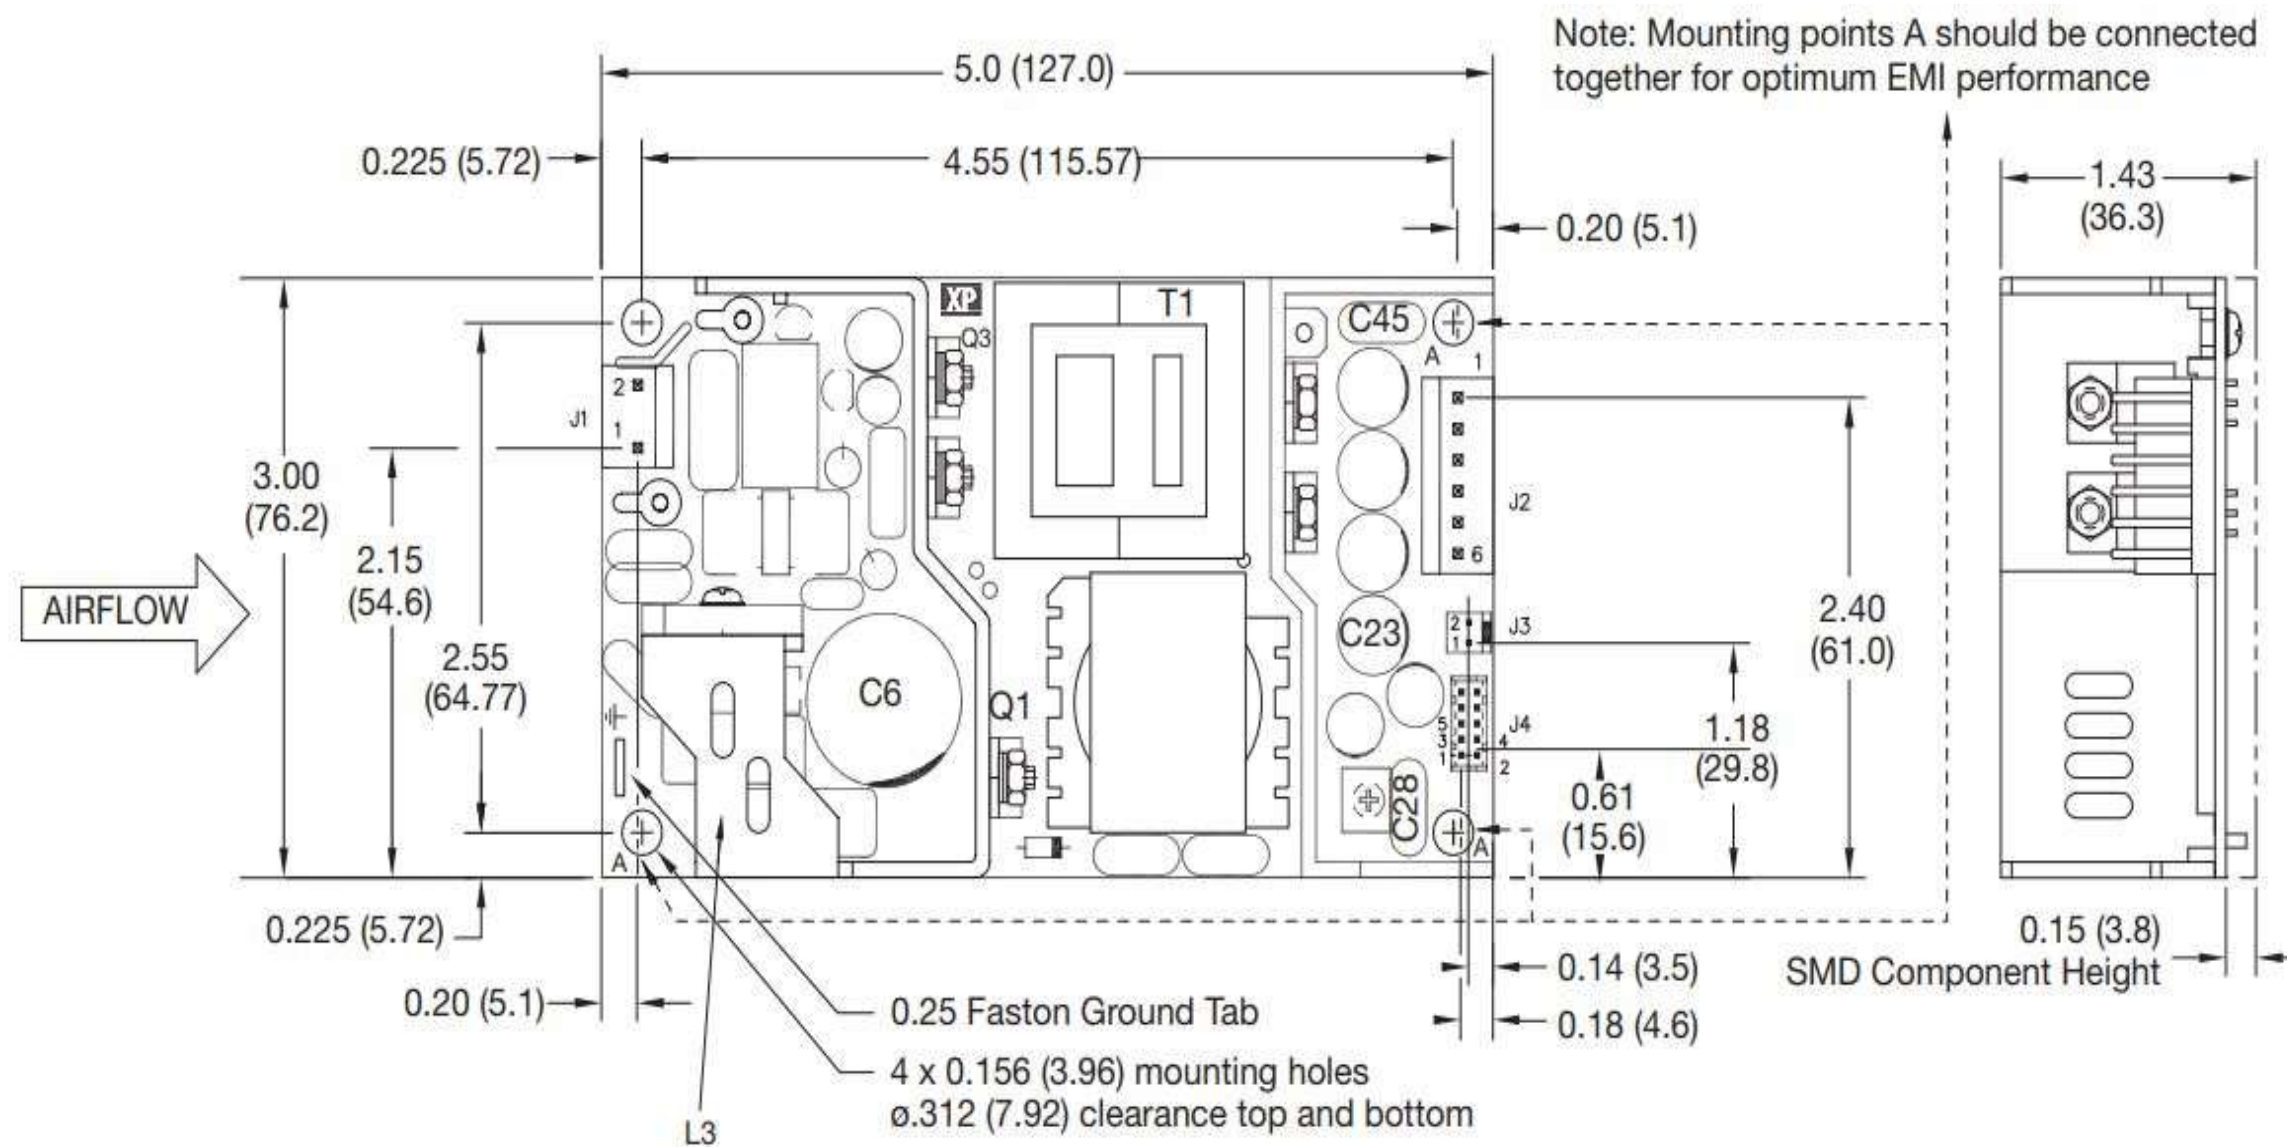

DIGI-KEY:1470-1329-ND
ISOLATION:
INPUT TO OUTPUT 4KVAC
INPUT TO GROUND 1K5VAC
OUTPUT TO GROUND 1K5VAC

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID		
SEGAINVEX, Dpto. Electrónica		
Diseñado: Patricio Coronado Dibujado: Patricio Coronado		
Título: fuente detector de haces moleculares_PWS 2		
Tam.	Orden de Trabajo: 20220390	Rev. V1
A	Archivo: <Archivo>	
Fecha: Thursday, October 24, 2024		Hoja 1 de 15