Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2025-03-26	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1800
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	2025-03-26
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	24.00	24.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	N.A
2	N.A
3	N.A
4	N.A
5	N.A
6	N.A
7	N.A
9	N.A
10	N.A
11	N.A
16	N.A

Prueba de Fugas

Referencia	100.24	Delta	0.01
Retención	100.22		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		37%		Porcentaje Final Bomba		37%
Flujo Calibrador		1.1643				
Linearización	Set point	0	Raw	0.8521	Corregido	0.1444
		51		52.19		50.98

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	0.39	40.04	40.00	0.39	-0.10

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	44.92

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	N.A	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	N.A	
K anterior	N.A	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\sin compensación)}$
Valor de gas Span	N.A	
Valor de lectura (sin compensación)	N.A	
K nuevo	#¡VALOR!	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	N.A	N.A	0.00	0.00	0.00
2	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-41**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

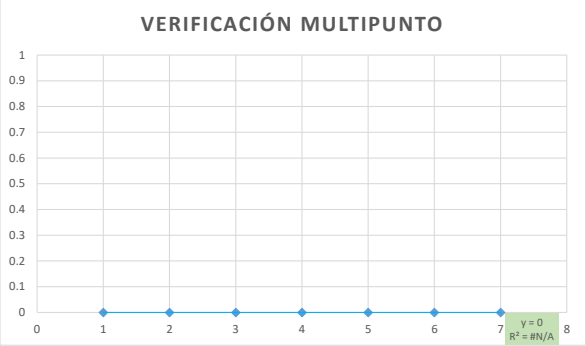

Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz