Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 05** 2024-09-02 **FOM303-44**

FECHA:	2025-06-26	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	1380
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Oxido de nitrogeno
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	2025-06-26

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	N.A
2	N.A
3	N.A
4	N.A
5	N.A
6	N.A
7	N.A
8	N.A
9	N.A
10	N.A
11	N.A
12	N.A
13	N.A

Prueba de Fugas

Referencia	136	Delta	0
Retención	136		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación punto de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
	0.00	0.000	800.00	800.50	#¡DIV/0!	

Punto de Precisión

Punto de Precisión NO (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)	Punto de Precisión NOx (ppb) 90% CL CV < 15.1%	Medición Equipo (ppb)
900.0	900.50	918.0	920.40

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	N.A	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	N.A	
K anterior	N.A	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	N.A	
Valor de lectura (sin compensación)	N.A	
K nuevo	#¡VALOR!	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	N.A	N.A	0.00	0.00	0.00
2	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	N.A	N.A	0.00	0.00	0.00
2	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	N.A	N.A	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	2024-09-02 FOM303-44

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	0.00	0.00	0.00
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	#¡VALOR!	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

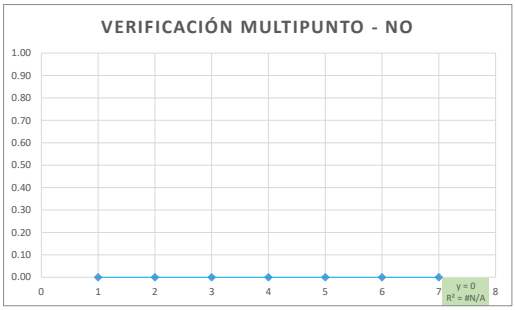

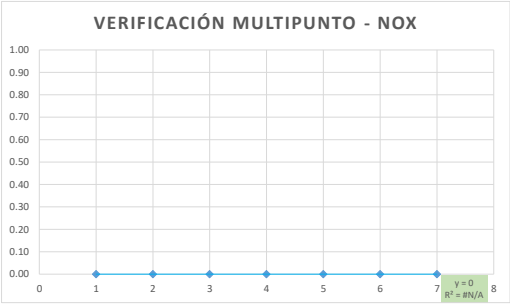

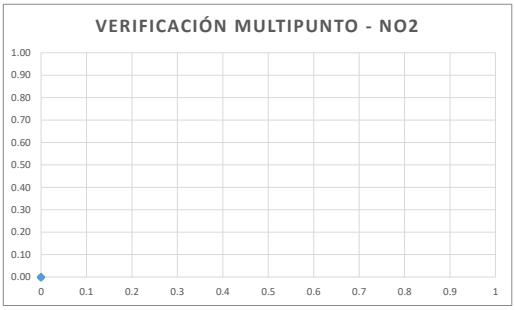

Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	---
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Coeficiente Correlación	#¡VALOR!

Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	LEONARDO PEREZ

H. Leonardo Perez Diaz