	PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CÓDIGO	ITAC-FO-007
MAHT Monitoreos Ambientales High Technology SAS.	**CAPTURA DE DATOS - CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO Y VERIFICACIÓN MULTIPUNTO**	VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	2022-12-01

DATOS DEL PROYECTO						
ID del proyecto:	1302A-26	**Nombre del Proyecto:**		MONITOREO CALIDAD DE AIRE PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO		
Nombre de Estación:	CA4-FUNZA	**Coordenadas:**	**Longitud (W) / Este (E):**	4870008,203	**Latitud (N) / Norte (N):**	2078871,805
Lugar de monitoreo				Centro Nacional de Aeronavegacion		
DATOS DE LOS EQUIPOS						
ID del equipo analizador	DVT3NM08	**Fecha encendido (precalentamiento)**	9/12/2025		**Fecha de calibración**	9/12/2025
ID del dilutor de gases	DT-01	**ID del generador de aire cero**	GA-01	**Botella (serie y concentración)**	serie 4010 / 400	
DATOS DE CALIBRACIÓN SPAN Y AIRE CERO - VERIFICACIÓN MULTIPUNTO						

CALIBRACIÓN ZERO SET		
Respuesta analizador (ppb) - Cero	**Antes del ajuste**	**Despues del ajuste**
|O3|	2,00	0,00

CALIBRACIÓN SPAN SET		
Respuesta analizador (ppb) - SPAN	**Antes del ajuste**	**Despues del ajuste**
|O3|	388,67	400,00

Toma de medidas Multipunto O3

n	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 80% FE 400ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 80 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 60% FE 300 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 60 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 40% FE 200 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 40 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - 20% FE 100 ppb	|O3| Respuesta analizador (ppb) - 20 % FE	|O3| Salida Calibrador (ppb) - Cero	|O3| Respuesta analizador (ppb) - Cero
1	400,00	400,00	300,00	301,15	200,00	199,95	100,00	100,70	0,00	0,00
2	397,00	400,00	299,00	300,00	200,00	199,96	100,00	100,50	0,00	0,01
3	398,00	400,00	299,00	300,25	199,99	196,99	100,00	101,60	0,00	0,00
4	398,00	400,10	300,00	300,00	199,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,01
5	398,00	400,10	299,00	300,00	199,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,05
Promedio	**398,20**	**400,04**	**299,40**	**300,28**	**199,60**	**199,38**	**100,00**	**100,56**	**0,00**	**0,01**

OBSERVACIONES	N/A

Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	**Revisado por**	MAHT SAS

	PROCESO INGENIERÍA, TÉCNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CÓDIGO	ITAC-FO-007
MAHT	CALIBRACION/VERIFICACION ANALIZADOR O3	VERSIÓN	2
		PÁGINA	2 de 3
		FECHA	2022-12-01

PUNTOS TEÓRICOS		CÁLCULO DE DILUCIONES		CALIBRADOR		ANALIZADOR		RESULTADOS		
% EC	|O3| (ppb)	Faire (l/min)	Concentración Calculada	|O3| Salida Calibrador (ppb)	|O3| Salida Calibrador (%FE)	|O3| Respuesta analizador (ppb)	|O3| Respuesta analizador (%FE)	|O3| Respuesta Calculada (ppb)	|O3| Respuesta Calculada (%FE)	Diferencia con Mejor Recta (% FE)
0	0	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,05
20	100	5	100	100,0	25,1	100,6	25,3	100,2	25,2	0,09
40	200	5	200	199,6	50,1	199,4	50,1	200,2	50,3	0,21
60	300	5	300	299,4	75,2	300,3	75,4	300,4	75,4	0,03
80	400	5	400	398,2	100,0	400,0	100,5	399,6	100,4	0,11

y = a + bx	
Pendiente (b)	1,0040
Intercepto (a)	-0,180
R2	0,99999

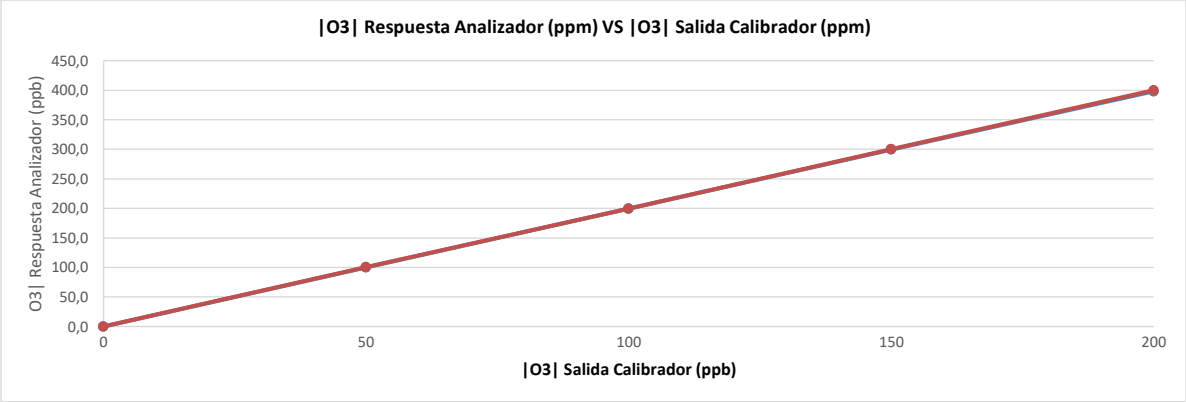

OBSERVACIONES	N/A		
Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	Revisado por	MAHT SAS

#	VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Ref. (ppb)	Valor Medido (ppb)	Diferencia (ppb)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - APÉNDICE D				
							Criterio Aplicado	Límite	Diferencia %	Resultado	ESTADO
1	24 Horas de monitoreo	2026-01-07	ZERO	0,0	3,1	3,10	Drift ≤ 003 ppb (24h)	3,10	N/A	3,10	CUMPLE
			SPAN	400,0	396,9	3,09	Drift ≤ ±07%	7,1	0,77	0,77	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	68,5	1,55	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	2,21	2,21	CUMPLE
2	1ª Verificación	2026-01-21	ZERO	0,0	0,1	0,10	Drift ≤ 005 ppb (>24h)	5,10	N/A	0,10	CUMPLE
			SPAN	400,0	399,5	0,55	Drift ≤ ±07%	7,1	0,14	0,14	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	69,8	0,19	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	0,27	0,27	CUMPLE
3	2ª Verificación	2026-02-04	ZERO	0,0	0,1	0,08	Drift ≤ 005 ppb (>24h)	5,10	N/A	0,08	CUMPLE
			SPAN	400,0	399,9	0,09	Drift ≤ ±07%	7,1	0,02	0,02	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	70,0	0,00	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	0,00	0,00	CUMPLE
4	3ª Verificación	2026-02-18	ZERO	0,0	0,0	0,00	Drift ≤ 005 ppb (>24h)	5,10	N/A	0,00	CUMPLE
			SPAN	400,0	400,1	0,09	Drift ≤ ±07%	7,1	0,02	0,02	CUMPLE
			SINGLE POINT	70,0	70,1	0,08	≤ ±07% ó ≤ ±02 ppb	7,1	0,11	0,11	CUMPLE
5	4ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							
6	5ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							
7	6ª Verificación		ZERO	0,0							
			SPAN	400,0							
			SINGLE POINT	70,0							

OBSERVACIONES	N/A

Elaborado por	Juan Camilo Jimenez Alonso	Revisado por	MAHT SAS