

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ KIM LONG
Bắc Ninh : Số 102CT1, Tòa Nhà Môi Trường Xanh,
Khu đô thị Đồng Nguyên, Phường Đồng Nguyên,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
HCM: 35D1, KP Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP HCM
Email: infor@kimlongelectronics.com
Điện thoại : 02223 666 079-0904963380



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration certificate)

Số / (No): VLĐT-0426-13

Tên phương tiện đo / (Description)

BẾP CÁCH THỦY / WATER BATH

Hãng sản xuất/ (Maker) CHINA

Quy cách/ (Model) : HH-4

Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specification)

60°C

Số thiết bị / (Serial No) : 90127

Mã thiết bị / (Asset No):

N/A

Ngày hiệu chuẩn

28-Apr-26

Calibrated date

Ngày hiệu chuẩn tiếp theo, theo yêu cầu của khách

hàng Recalibration date

28-Apr-27

Tên khách hàng /

(Customer) :

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Địa chỉ /

(Address) :

LÔ CN-10-28, KHU CÔNG NGHIỆP VĂN TRUNG, PHƯỜNG NẾNH, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

Phương pháp thực hiện/ (Method of calibration: Đo so sánh)

KLE-QT-006

DANH SÁCH CÁC CHUẨN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HIỆU CHUẨN / (STANDARD EQUIPMENT LIST)

Mã
chuẩn/ID

Tên thiết bị chuẩn

(Standard equipments name)

Quy cách/ Model

Hiệu lực đến/
Valid date

Chuẩn liên kết đến
(Traceable to)

KLE0006

THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU
DATA ACQUISITION

34970A/34901A

14-Jan-27

CỤC ĐO LƯỜNG

Môi trường hiệu chuẩn thực tế/ Actual calibration environment

Nhiệt độ / Temperature :

Bắt đầu: 22,4 °C

Kết thúc:

22,6 °C

Độ ẩm / Relative Humidity :

Bắt đầu: 64 % RH

Kết thúc:

65 % RH

Địa điểm / Place :

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Ngày ban hành
(Date issue)

28 April 2026

Kết quả hiệu chuẩn/ Result of calibration:

Xem kết quả hiệu chuẩn trang sau

GIÁM ĐỐC
(Director)

Được duyệt bởi
(Approved by)

Người thực hiện
(Calibrated by)



NGUYỄN TRỌNG HÓA

NGUYỄN TRỌNG THĂNG

BM-GCNHC-01 | Lần BH/SĐ: 2/1 | Ngày BH: 15/12/2025

GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Chung



Biên Bản Hiệu Chuẩn / Calibration Report

Số Biên Bản / Report No : VLĐT-0426-13

Nhà sản xuất: CHINA
Manufacturer

Kiểu: HH-4
Model

Mã số quản lý / Số seri: N/A / 90127
Asset No / Serial No


Kết quả hiệu chuẩn / Result of Calibration

1. Kết quả hiệu chuẩn nhiệt độ / Temperature Calibration Results

Test at 60 °C

Thời gian Time	Giá trị UUT UUT Value	Giá trị chuẩn Standard Value					Tmax - Tmin
		Vị trí 1 Pos. 1	Vị trí 2 Pos. 2	Vị trí 3 Pos. 3	Vị trí 4 Pos. 4	Vị trí 5 Pos. 5	
5 Min	60,0 °C	60,6	60,8	60,9	60,1	60,6	0,8
10 Min		60,3	60,6	60,7	60,3	60,8	0,5
15 Min		60,7	60,4	60,5	60,2	60,5	0,5
20 Min		60,5	60,2	60,6	60,5	60,6	0,4
25 Min		60,6	60,8	60,8	60,3	60,4	0,5
30 Min		60,2	60,1	60,3	60,1	60,9	0,8
Tmax-Tmin		0,4	0,6	0,4	0,4	0,3	
Nhiệt độ trung bình Average Temperature			60,5 °C		Sai số Error		0,5 °C
Độ đồng đều Temperature Uniformity			0,2 °C		Độ không đảm bảo đo mở rộng Expanded Uncertainty		0,6 °C
Độ ổn định Temperature Stability			0,3 °C				

Vị trí đặt cảm biến nhiệt độ →
Probe Position

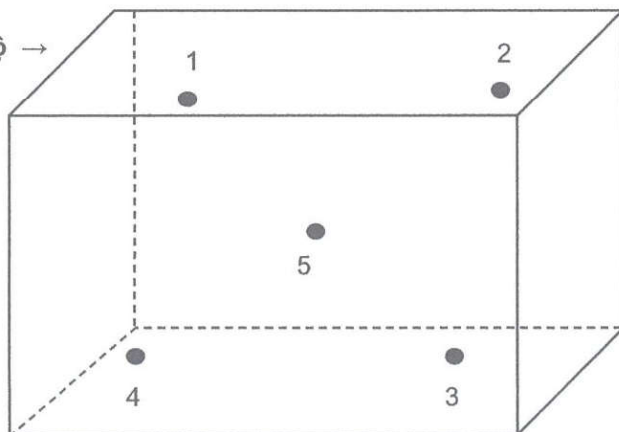



Biên Bản Hiệu Chuẩn / Calibration Report

Số Biên Bản / Report No : VLĐT-0426-13

Nhà sản xuất: CHINA
Manufacturer

Kiểu: HH-4
Model

Mã số quản lý / Số seri: N/A / 90127
Asset No / Serial No

Độ không đảm bảo đo báo cáo được dựa trên độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, ở mức độ tin cậy 95%
The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$ providing a level of confidence of approximately 95 %.

Chú thích / Remarks

- Phương tiện này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
- Phương tiện này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.
- Tmax-Tmin: Giá trị cao nhất - giá trị thấp nhất / Max value - Min value
- Độ đồng đều nhiệt độ : xét tại một thời điểm, so sánh sai lệch giữa các vị trí đo.
Temperature Uniformity : At one point in time, compare differences between positions.
- Độ ổn định nhiệt độ : xét tại một vị trí, so sánh sai lệch tại một vị trí theo thời gian.
Temperature Stability: At one location, compare the deviation over time.
- UUT: Thiết bị cần hiệu chuẩn/ Unit Under Test
- Quy tắc ra Quyết định và Công bố về sự phù hợp ILAC-G8:09/2019 trang số 12 mục 4.2.1
Rules for decisions and declarations of conformity ILAC-G8:09/2019 page 12 section 4.2.1.
Công bố sự phù hợp được báo cáo như sau/ The declaration of conformity is reported as follows:
- ĐẠT : Giá trị đo trung bình $\leq$ giới hạn trên và $\geq$ giới hạn dưới / PASS : The average measured value $\leq$ the upper limit and $\geq$ the lower limit.
- KHÔNG ĐẠT: Giá trị đo trung bình $>$ giới hạn trên hoặc $<$ giới hạn dưới / FAIL : Average measured value $>$ upper limit or $<$ lower limit.

