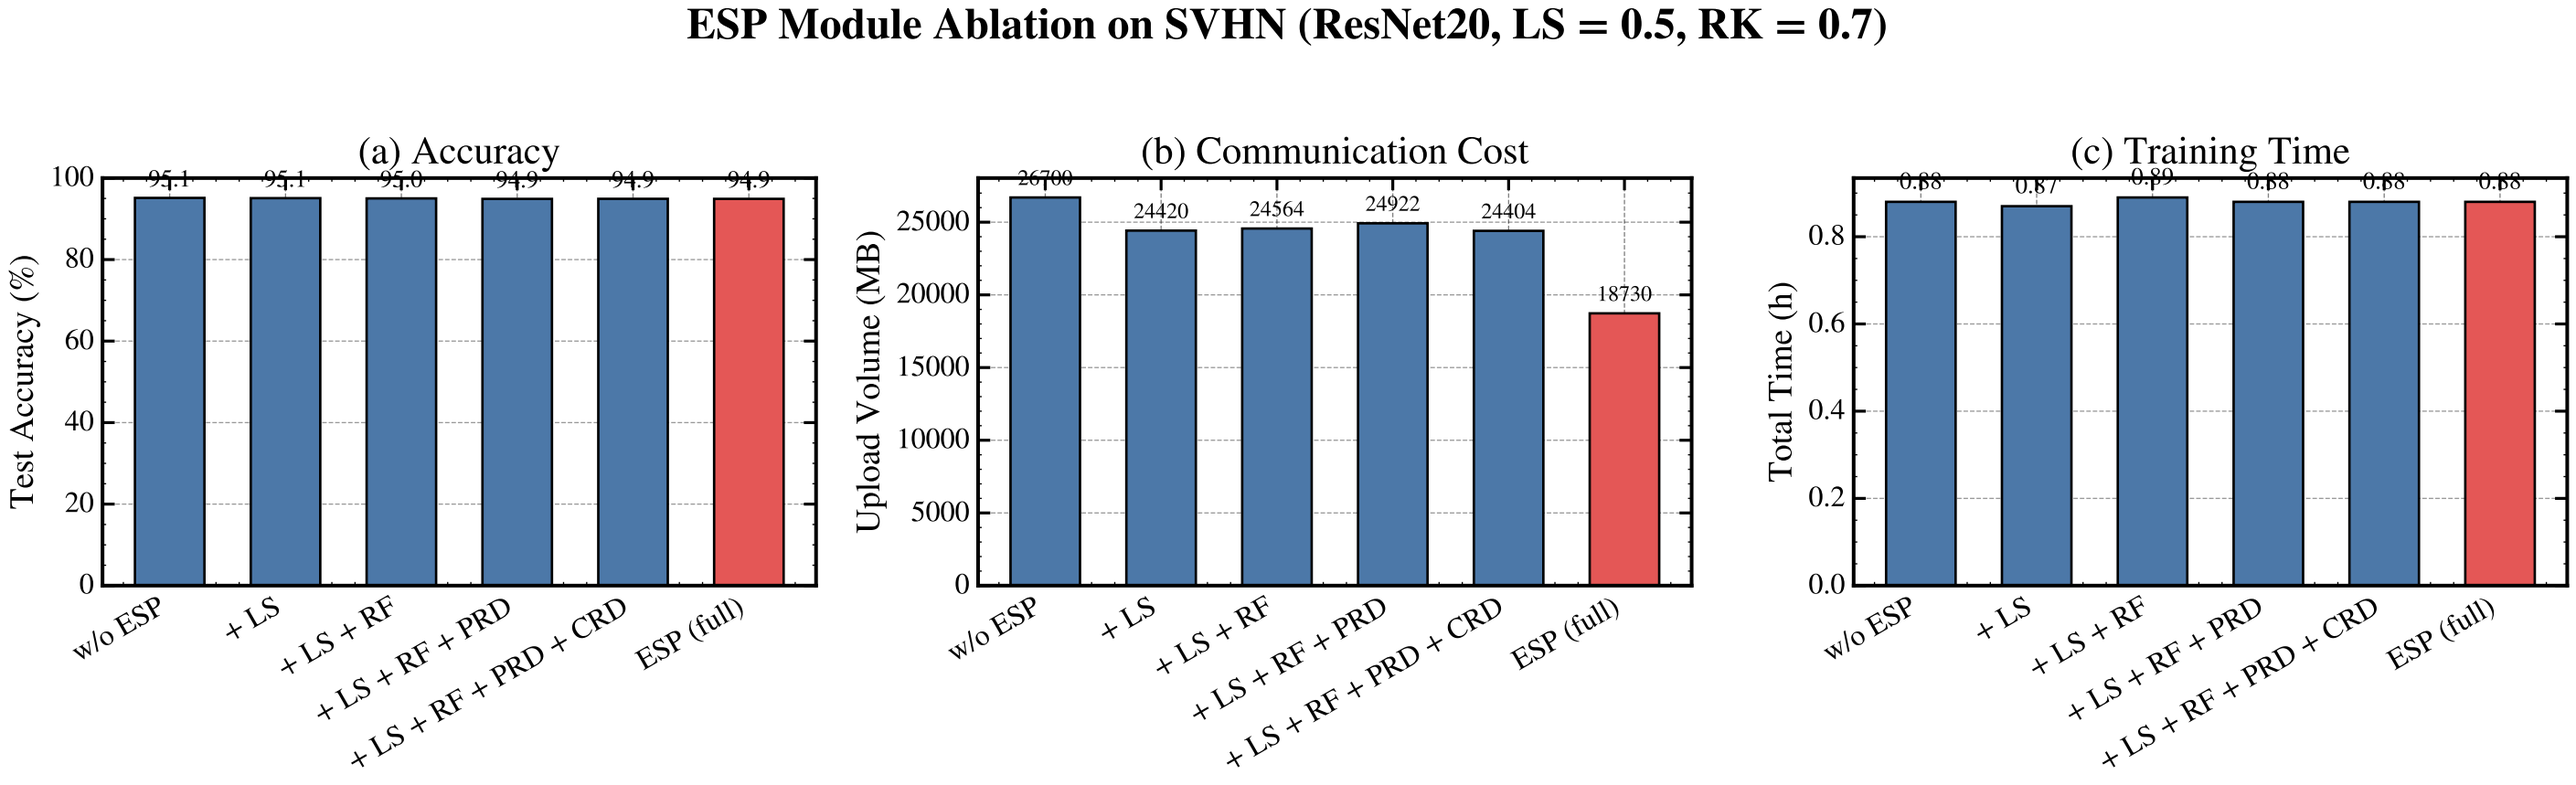
ESP Module Ablation on SVHN (ResNet20, LS = 0.5, RK = 0.7)
(a) Accuracy
Test Accuracy (%)
95.1
95.1
95.0
94.9
94.9
94.9
(b) Communication Cost
Upload Volume (MB)
26700
24420
24564
24922
24404
18730
(c) Training Time
Total Time (h)
0.88
0.87
0.89
0.88
0.88
0.88
w/o ESP
+ LS
+ LS + RF
+ LS + RF + PRD
+ LS + RF + PRD + CRD
ESP (full)