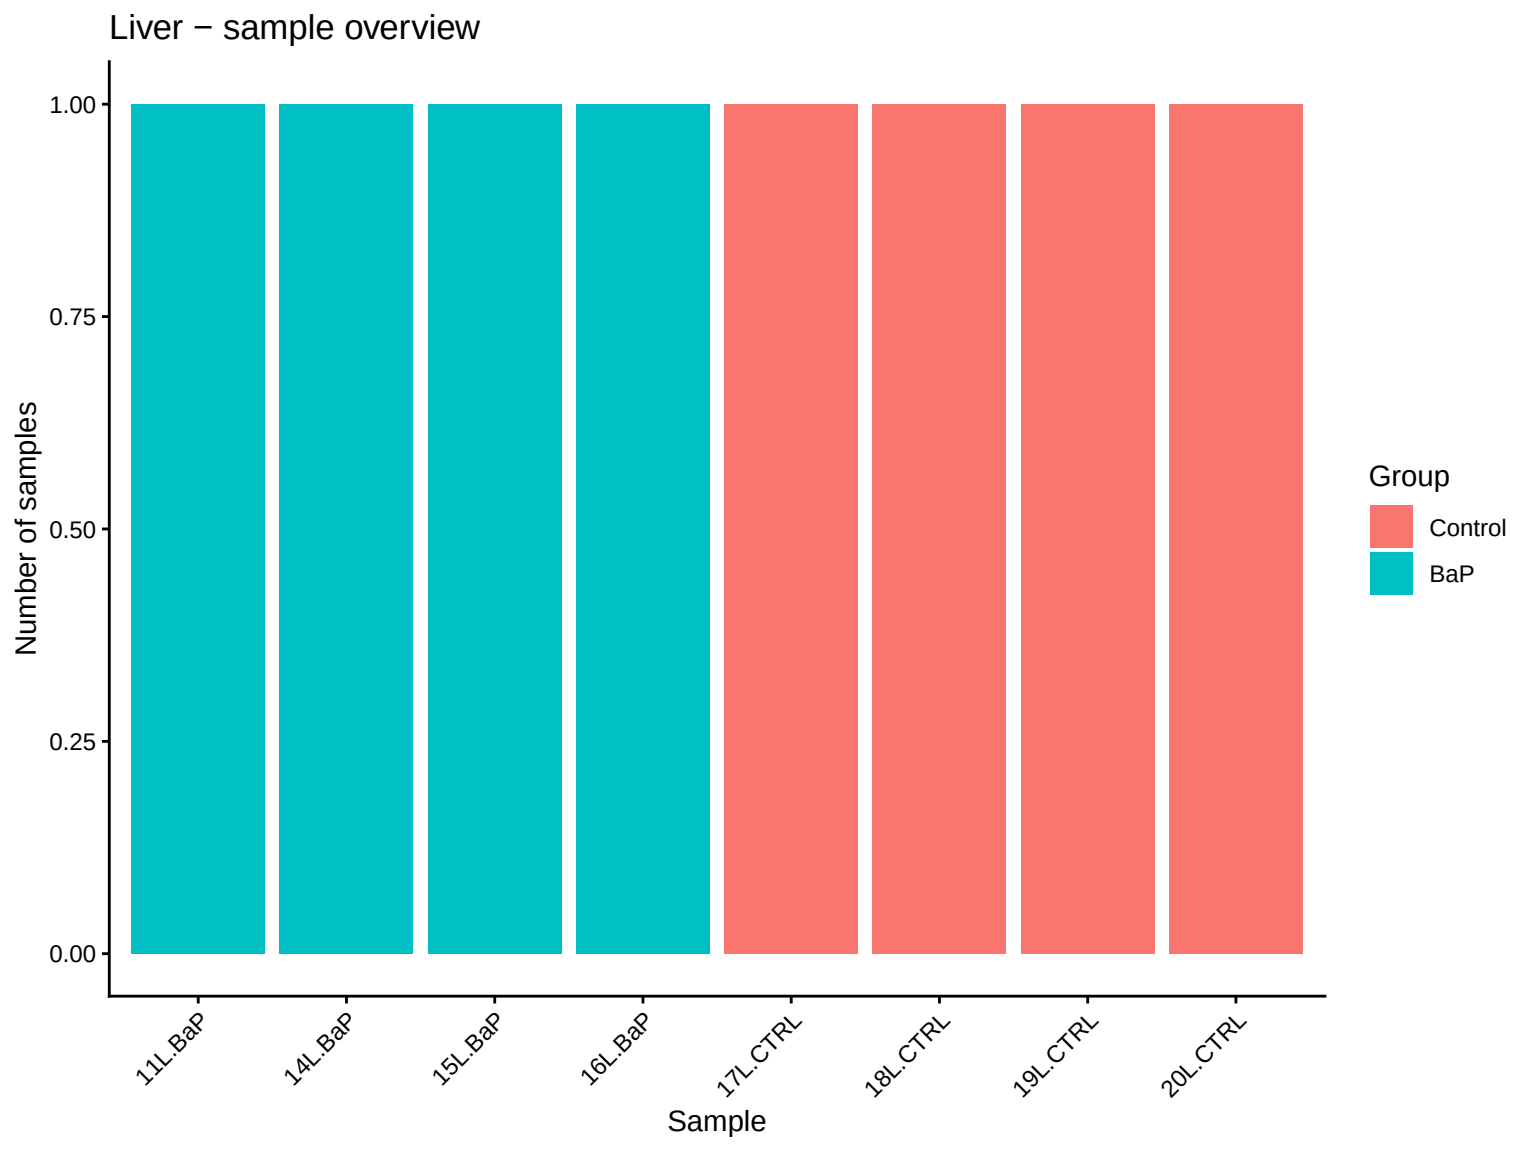
Liver − sample overview
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Number of samples
11L.BaP
14L.BaP
15L.BaP
16L.BaP
17L.CTRL
18L.CTRL
19L.CTRL
20L.CTRL
Sample
Group
Control
BaP