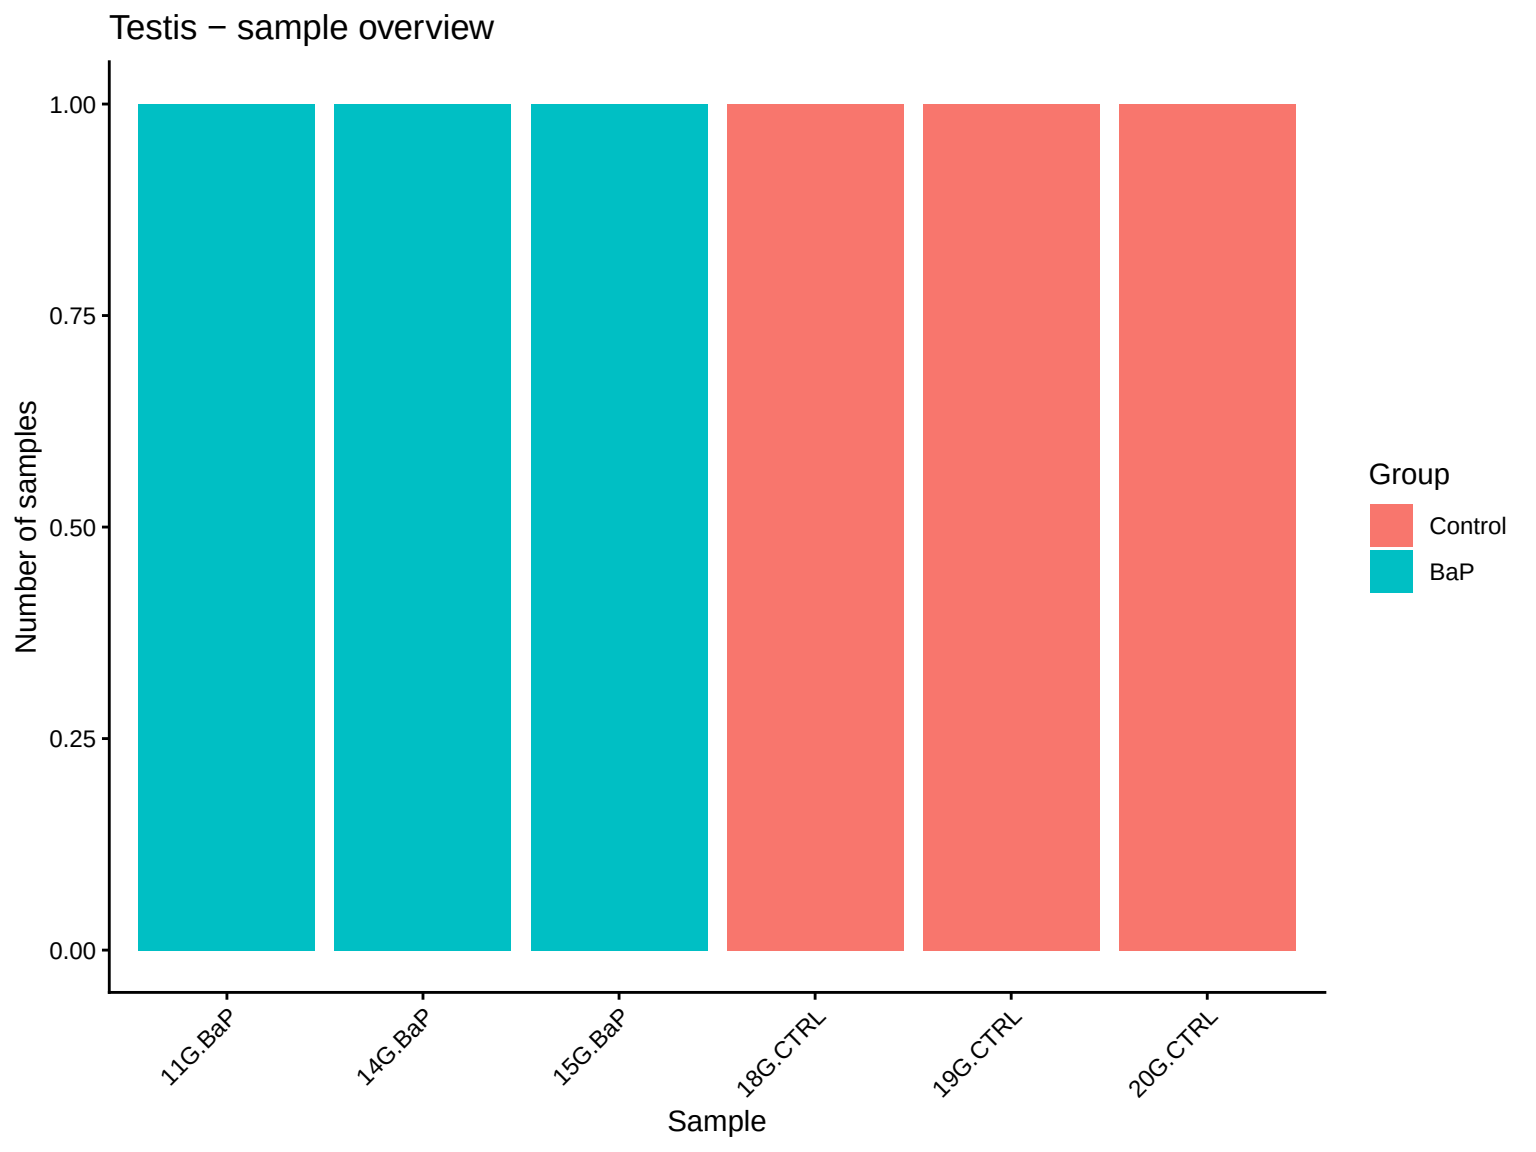
Testis − sample overview
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Number of samples
11G.BaP
14G.BaP
15G.BaP
18G.CTRL
19G.CTRL
20G.CTRL
Sample
Group
Control
BaP