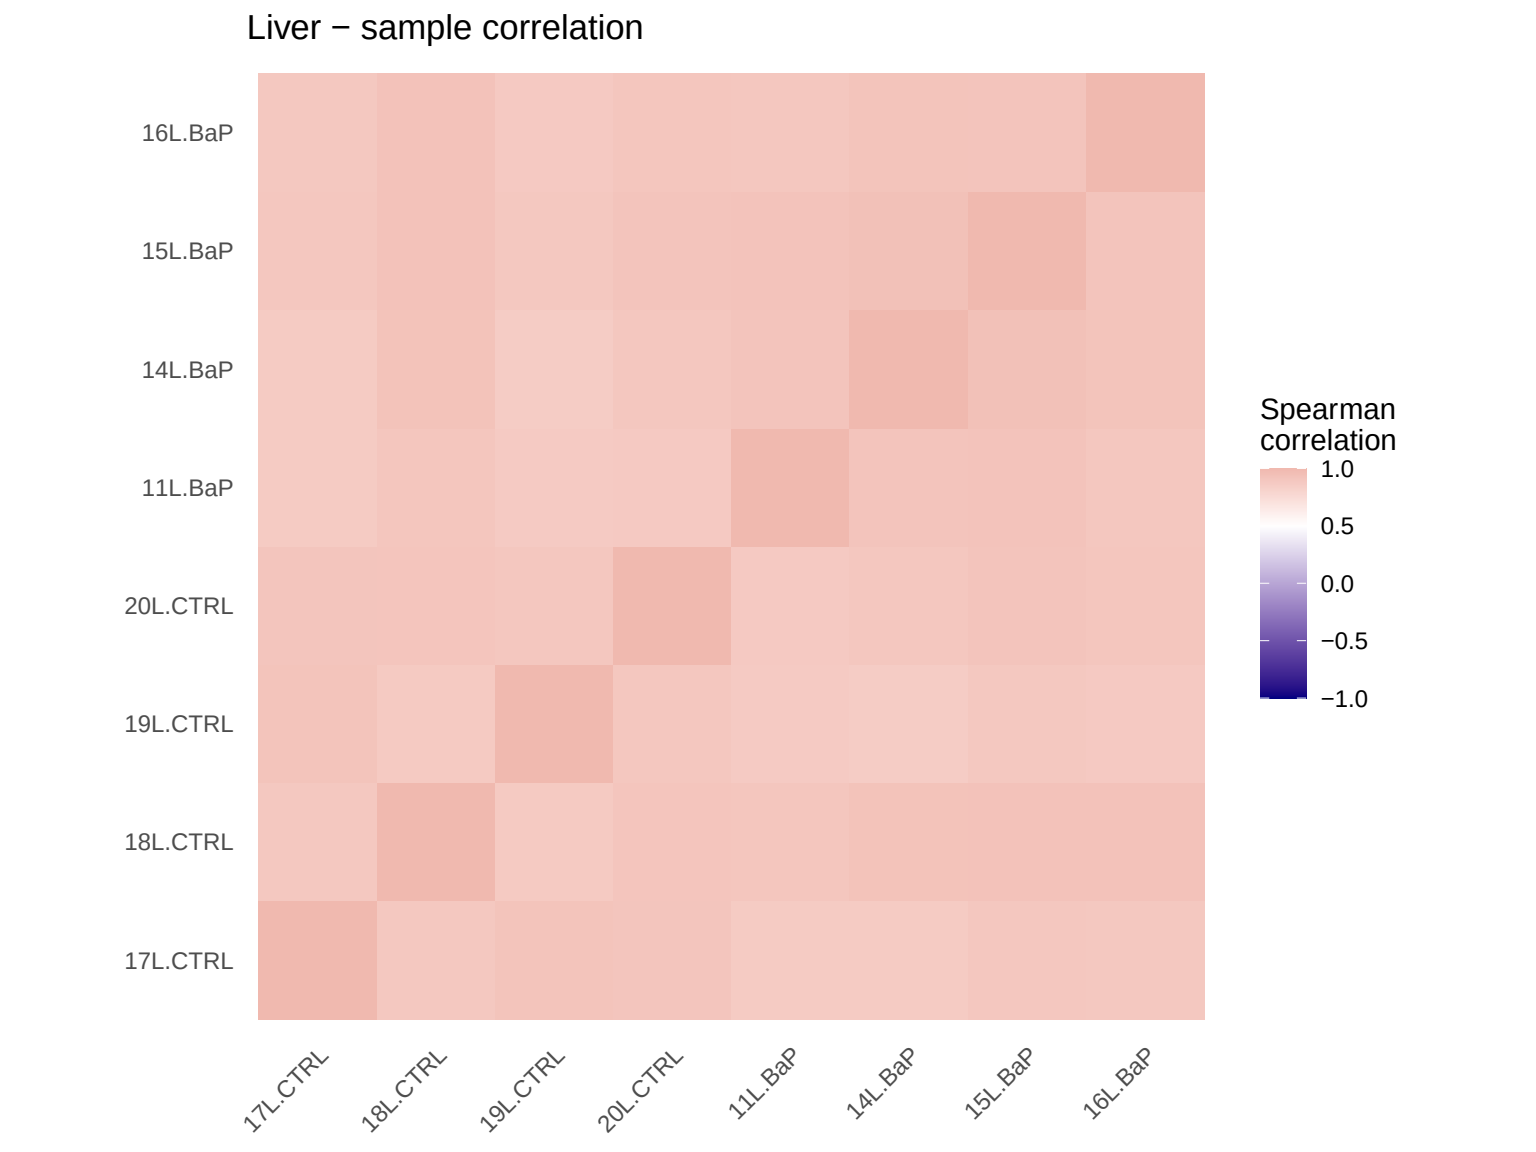
Liver − sample correlation
16L.BaP
15L.BaP
14L.BaP
11L.BaP
20L.CTRL
19L.CTRL
18L.CTRL
17L.CTRL
17L.CTRL
18L.CTRL
19L.CTRL
20L.CTRL
11L.BaP
14L.BaP
15L.BaP
16L.BaP
Spearman correlation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0