

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Целзиор разтвор за съхраняване на органи / Celsior solution for organ preservation

Глутатион, Манитол, Лактобионовна киселина, Глутаминова киселина, Натриев хидроксид, Калциев хлорид, Калиев хлорид, Магнезиев хлорид, Хистидин

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Целзиор и за какво се използва
2. Преди да използвате Целзиор
3. Как да използвате Целзиор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Целзиор
6. Допълнителна информация

РЕПУБЛИКАНСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20120024
Разрешение №	28229 / 29-04-2015
Одобрение №	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕЛЗИОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Целзиор е разтвор за съхраняване на паренхимни органи (сърце, бял дроб, бъбрек, черен дроб и панкреас). Използва се от отстраняването на органа от донора, по време на съхранението и транспортирането на органа, до трансплантацията.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЕЛЗИОР


Не използвайте Целзиор

Целзиор не трябва да се използва за съхранение на донорски органи, ако донорът(ите) или реципиента(ите) е(са) алергичен(ни) (свръхчувствителен(ни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Целзиор (вж. точка 6 Допълнителна информация).

Обърнете специално внимание при употребата на Целзиор

Целзиор е неподходящ за директно инжектиране или за интравенозна употреба при реципиента на органа и трябва да се използва само за промиване и съхранение в хладилна камера на паренхимни органи.

Целзиор е за еднократна употреба. Той не е подходящ за използване в машини, които изпомпват разтвора за съхранение непрекъснато през органа (имитирайки кръвообращението).

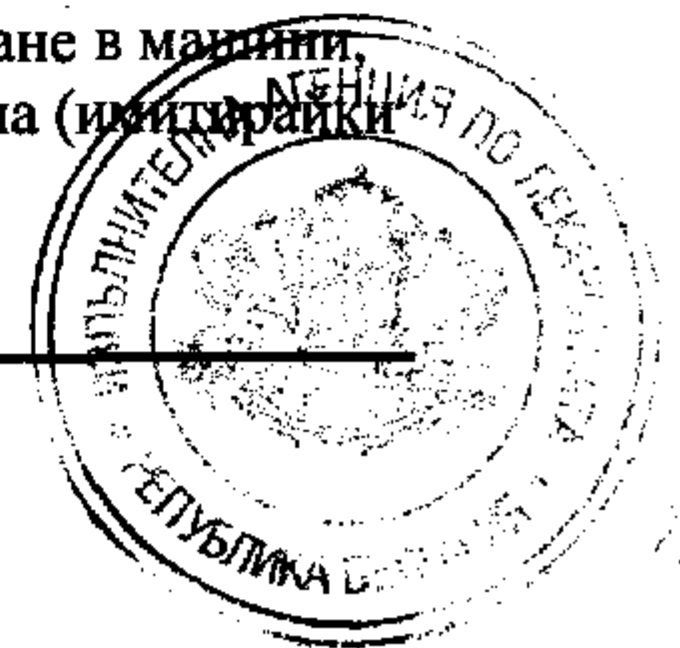

Употреба на други лекарства

Не са известни взаимодействия, когато се използва по предназначение.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, за да прецени дали са необходими адаптивни мерки.

Бременност и кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или предполагате, че сте бременна или ако кърмите, за да прецени дали са необходими адаптивни мерки.

Шофиране и работа с машини

Не се отнася за това лекарство

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЕЛЗИОР

Целзиор трябва да се употребява единствено от обучен персонал, както е описано в съответната точка: **Следващата информация е предназначена само за лекари или работещи в здравеопазването**

След като един орган е бил отстранен от донора, преди да бъде трансплантиран на реципиента, той не разполага със запас от кръв и кислород и трябва да се съхраняват при температура 2 - 8° C, за да може да функционира добре в реципиента. Обикновено органите се промиват, за да се премахне кръвта и органа да се охлади, при което той забавя своя метаболизъм. Органът(ите) незабавно се поставя в стерилен контейнер, пълен с Целзиор и се държи на хладно, но не се замразява.

Въпреки, че опитът при деца и юноши е ограничен, не са известни причини, поради които Целзиор не трябва да бъде използван за органи преди трансплантация в тази група пациенти.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Тъй като Целзиор не се прилага на самите органи на реципиентите, не се очакват специфични към разтвора нежелани реакции. Все пак, трябва да съобщите за всички нежелани реакции, включително тези, за които се знае, че са свързани с други лекарства, приемани по време на процедурата по трансплантация.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦЕЛЗИОР

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Целзиор след изтичане на срока за годност, отбелязан върху сака и външната опаковка след Годен до.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната алуминиева защитна опаковка, за да се предпази от светлина. Да се съхранява и транспортира в хладилник (2 - 8° C). Да не се замразява.



След отваряне Целзиор трябва да се използват в рамките на 24 часа.

Целзиор не трябва да се използва, ако разтворът съдържа видими частици, не е бистър или безцветен, или е с жълтеникав цвят.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Целзиор

Активните вещества са глутатион, манитол, лактобионовата киселина, глутаминова киселина, натриев хидроксид, калциев хлорид, калиев хлорид, магнезиев хлорид и хистидин.

Всеки сак с 1 литър разтвор съдържа:

Глутатион	0,921 g	(3 mmol)
Манитол	10,930 g	(60 mmol)
Лактобионовата киселина	28,664 g	(80 mmol)
Глутаминова киселина	2,942 g	(20 mmol)
Натриев хидроксид	4,000 g	(100 mmol)
Калциев хлорид дихидрат	0,037 g	(0,25 mmol)
Калиев хлорид	1,118 g	(15 mmol)
Магнезиев хлорид хексахидрат	2,642 g	(13 mmol)
Хистидин	4,650 g	(30 mmol)

– Другите съставки са:

вода за инжекции

натриев хидроксид, 4% (pH коректор).

Как изглежда Целзиор и какво съдържа опаковката

Разтвор за съхраняване на органи.

Целзиор е бистър, безцветен (или бледо жълт) разтвор в сак от етилен винилацетатен ко-полимер във външен алуминиев сак, съдържащ кислороден абсорбер.

pH = 7,3

Осмоалитет: 320 mosmol/kg

Опаковка: 4 сака, всеки съдържащ 1 литър разтвор.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Institut Georges Lopez - IGL

Parc tertiaire du Bois Dieu, RN6



1 allée des Chevreuils,
69380 Lissieu
Франция

Производител

Genzyme Polyclonals S.A.S.
23 Boulevard Chambaud de la Bruyère
69007 Lyon
Франция

Този лекарствен продукт е регистриран в страните-членки на ЕИП под следните имена:

Австрия	Целзиор Organkonservierungslösung
Белгия	Целзиор solution pour conservation d'organes / Целзиор bewaaroplossing voor organen / Целзиор Organkonservierungslösung
България	Целзиор
Чешка република	Целзиор roztok na konzervování orgánů
Германия	Целзиор Organkonservierungslösung
Гърция	Целзиор
Финландия	Целзиор
Унгария	Целзиор szervtartósító oldat
Ирландия	Целзиор Solution for organ preservation
Италия	Целзиор
Нидерландия	Целзиор bewaaroplossing voor organen
Норвегия	Целзиор
Полша	Целзиор
Португалия	Целзиор
Румъния	Целзиор soluție pentru prezervarea organelor
Словакия	Целзиор roztok na konzervovanie orgánov
Словения	Целзиор raztopina za ohranjanje organov
Испания	Целзиор solución para la conservación de órganos
Швеция	Целзиор

Тази листовка е одобрена през хх 2014

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба и приложение

Целзиор е неподходящ за директно инжектиране или за интравенозна употреба при реципиента на органа, и трябва да се използва само за промиване и съхранение в хладилна камера на паренхимни органи.

Целзиор е за еднократна употреба. Да не се замразява. Той не е подходящ за непрекъсната перфузия с машина.

Не може да се изключи, че остатъчни количества от разтвора може да доведат до аритмия по време на деклампирането или че в случай на неспазване на оптималното съхранение на сърцето в ранната посттрансплантационна фаза



може да се наблюдава увредена сърдечна функция.

Работа

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8 °C). Да не се замразява. Съхранявайте торбичката в картонена опаковка с алуминиево покритие, за да се предпази от светлина.

Разтворът може да пожълте по време на съхранение. Това не влошава качеството и ефективността на Целзиор.

Въпреки, че опаковъчните материали се произвеждат при асептични условия, външната страна на торбичката на Целзиор не е стерилна. Външната страна на торбичката трябва да се обеззарази, ако Целзиор се разсипе.

Няма нужда да се филтрира преди употреба. Външната торбичка с алуминиево покритие съдържа абсорбиращи кислорода вещества, в отделно саше, което гарантира по-добра стабилност на активното вещество, редуциран глутатион. Съдържанието на това саше, не трябва да се смесва с разтвора.

Външната алуминиева опаковка и абсорбиращото кислорода саше трябва да бъдат отстранени преди употреба.

Веднага след отстраняването на външната опаковка, вътрешната опаковка трябва да бъде проверена за течове чрез притискане на торбичката. Ако се установи теч, разтворът не трябва да се използва.

В торбичката на Целзиор има 3 отвора. Иглата на системата, използвана за промиване на органа трябва да се вкара в отвора на лявата страна на торбичката (чрез завъртане). До започване на вливането, системата трябва да е клампирана.

Торбичката на разтвора трябва да е поставена вътре в ръкав с налягане, с подходящ размер. Ръкавът трябва да бъде изпълнен с въздух, за да се приложи достатъчно налягане, необходимо за изцеждане на течността. В допълнение, преди вливане контейнерът на разтвора трябва да бъде окачен на подходяща височина, за да се гарантира постоянен поток на разтвора.

Въвеждане/Дозировка

Органът е промит посредством канюла, въведена в артерия, като се поддържа достатъчен натиск за получаване на постоянен поток от разтвора, за да се извършва адекватно промиване. В случай на чернодробна трансплантация, жлъчните канали обикновено се промиват след експлантация, преди поставянето му в контейнера за съхранение и транспорт. Обемът на разтвора за промиване зависи от съответния орган(и).

Предложени минимални обеми:

Сърце: Възрастни: 1-2 литра; Новородени: 30 ml/kg

Бял дроб: 4-6 литра

Черен дроб: Възрастни: 6-8 литра;



Бъбрек: 4-5 литра;

Панкреас: 4 литра.

Многоорганна: в съответствие със съответните органи.

Промиването, трябва да продължи, докато органът е еднакво светъл и отпадните води са относително бистри.

След изваждане от хладилната камера (2-8° C), охладеният разтвор трябва да се използва незабавно.

Педиатрични пациенти

Въпреки, че опитът при деца и юноши е ограничен, няма никакви възражения по отношение използването на Целзиор в тази група пациенти.

Съхранение в хладилни условия

Органът се съхранява при $5 \pm 3^{\circ} \text{C}$ в стерилен контейнер, с подходящ размер за органа. Органът трябва да бъде изцяло покрит от охладения разтвор.

Контейнерът за съхранение на органи трябва да бъде плътно асептично затворен.

Контейнерът трябва да бъде поставен поне във втори контейнер. Той трябва да се напълни с лед, но лед не трябва да попада в контейнера за съхранение на органа, където ледът може да влезе в пряк контакт с органа. Трябва да се гарантира, че органът е асептично съхраняван в неговия контейнер, т.е. вътрешността на контейнера за съхранение на органа и съдържанието му трябва да останат стерилни.

Допълнителният(те) контейнер(и) трябва да бъде надеждно плътно затворен.

Контейнерите за съхранение на органи трябва да бъдат държани в добре изолирани транспортни контейнери. Контейнерите за съхранение на органи трябва да бъдат заобиколени от лед.

Времето за транспортиране трябва да бъде възможно най-кратко.

