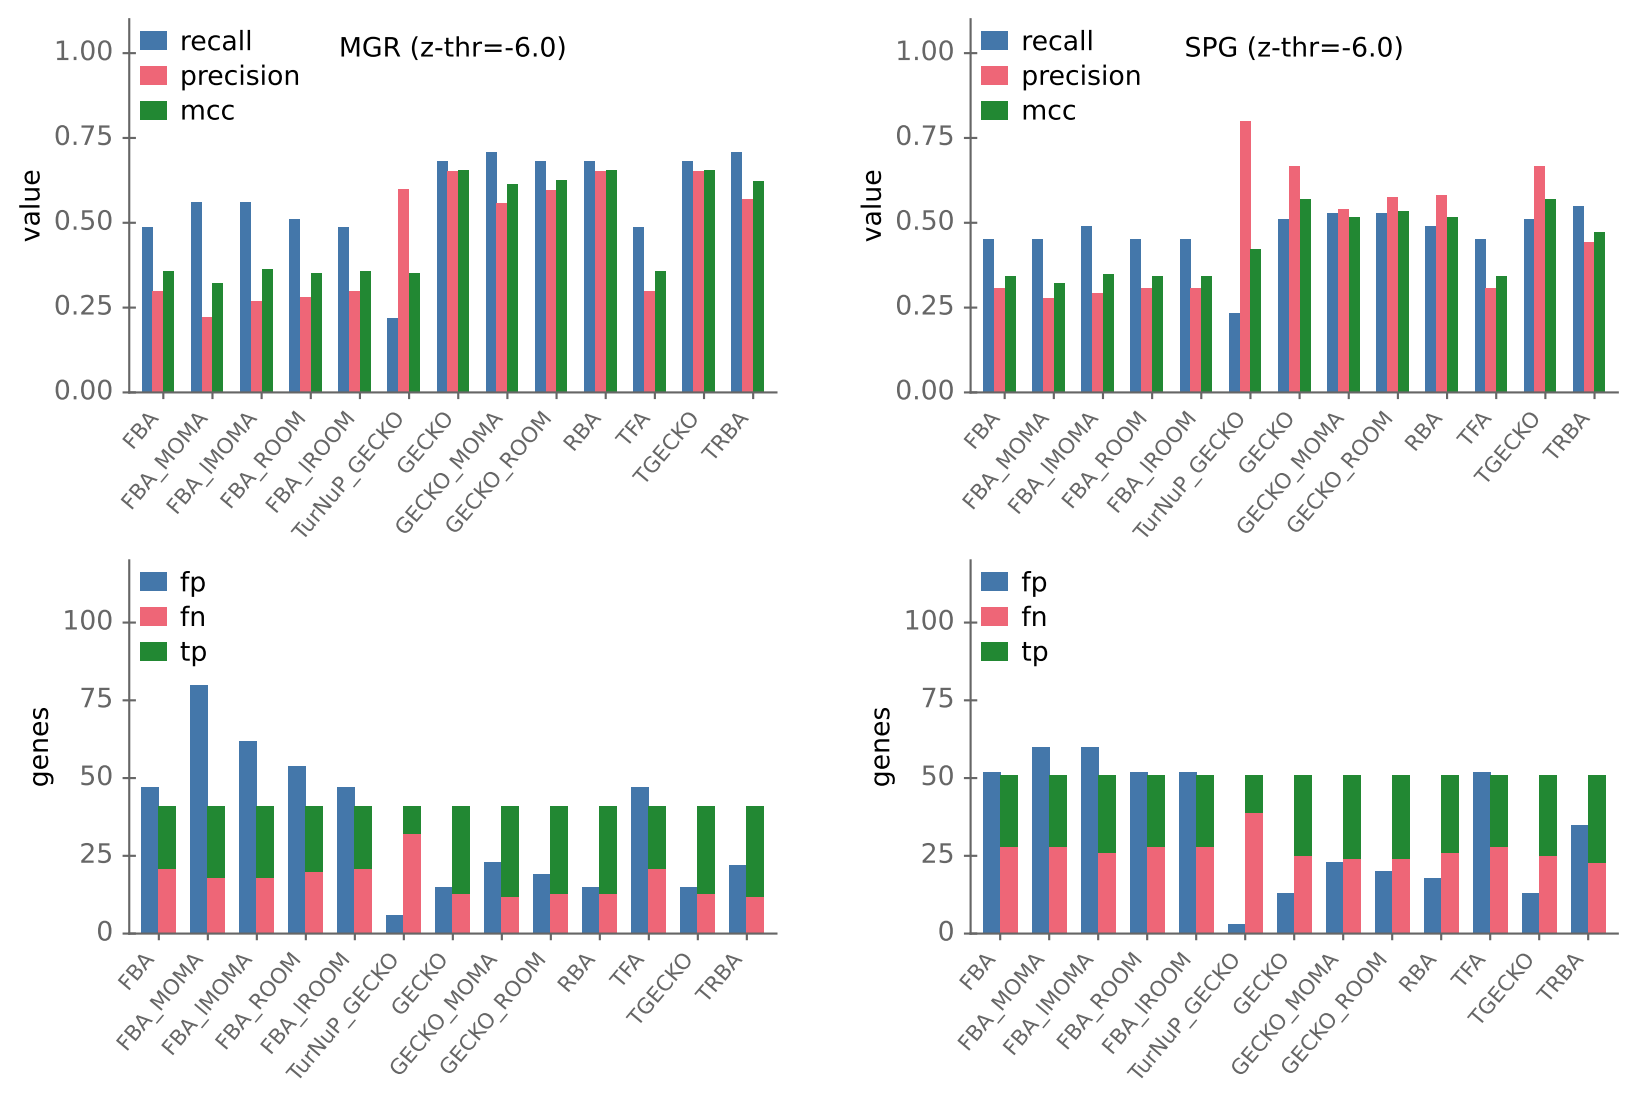
MGR (z-thr=-6.0)
SPG (z-thr=-6.0)
recall
precision
mcc
value
fp
fn
tp
genes
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
100
75
50
25
0
FBA
FBA_MOMA
FBA_IMOMA
FBA_ROOM
FBA_IROOM
TurNuP_GECKO
GECKO
GECKO_MOMA
GECKO_ROOM
RBA
TFA
TGECKO
TRBA