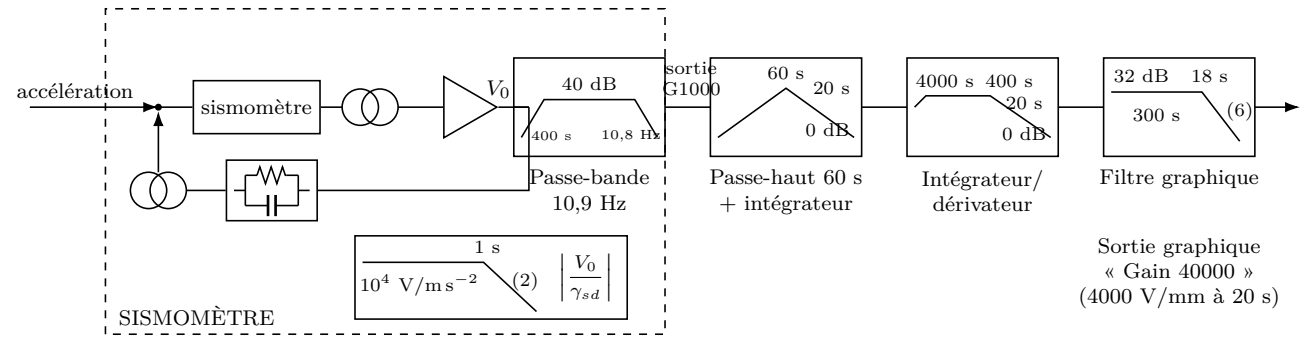

accélération
sismomètre
V_0
40 dB
400 s
10,8 Hz
sortie G1000
Passe-bande 10,9 Hz
60 s
20 s
0 dB
Passe-haut 60 s + intégrateur
4000 s
400 s
20 s
0 dB
Intégrateur/ dérivateur
32 dB
18 s
300 s
(6)
Filtre graphique
1 s
10^4 V/m s^{-2}
(2)
$\left|\frac{V_0}{\gamma_{sd}}\right|$
SISMOMÈTRE
Sortie graphique « Gain 40000 » (4000 V/mm à 20 s)