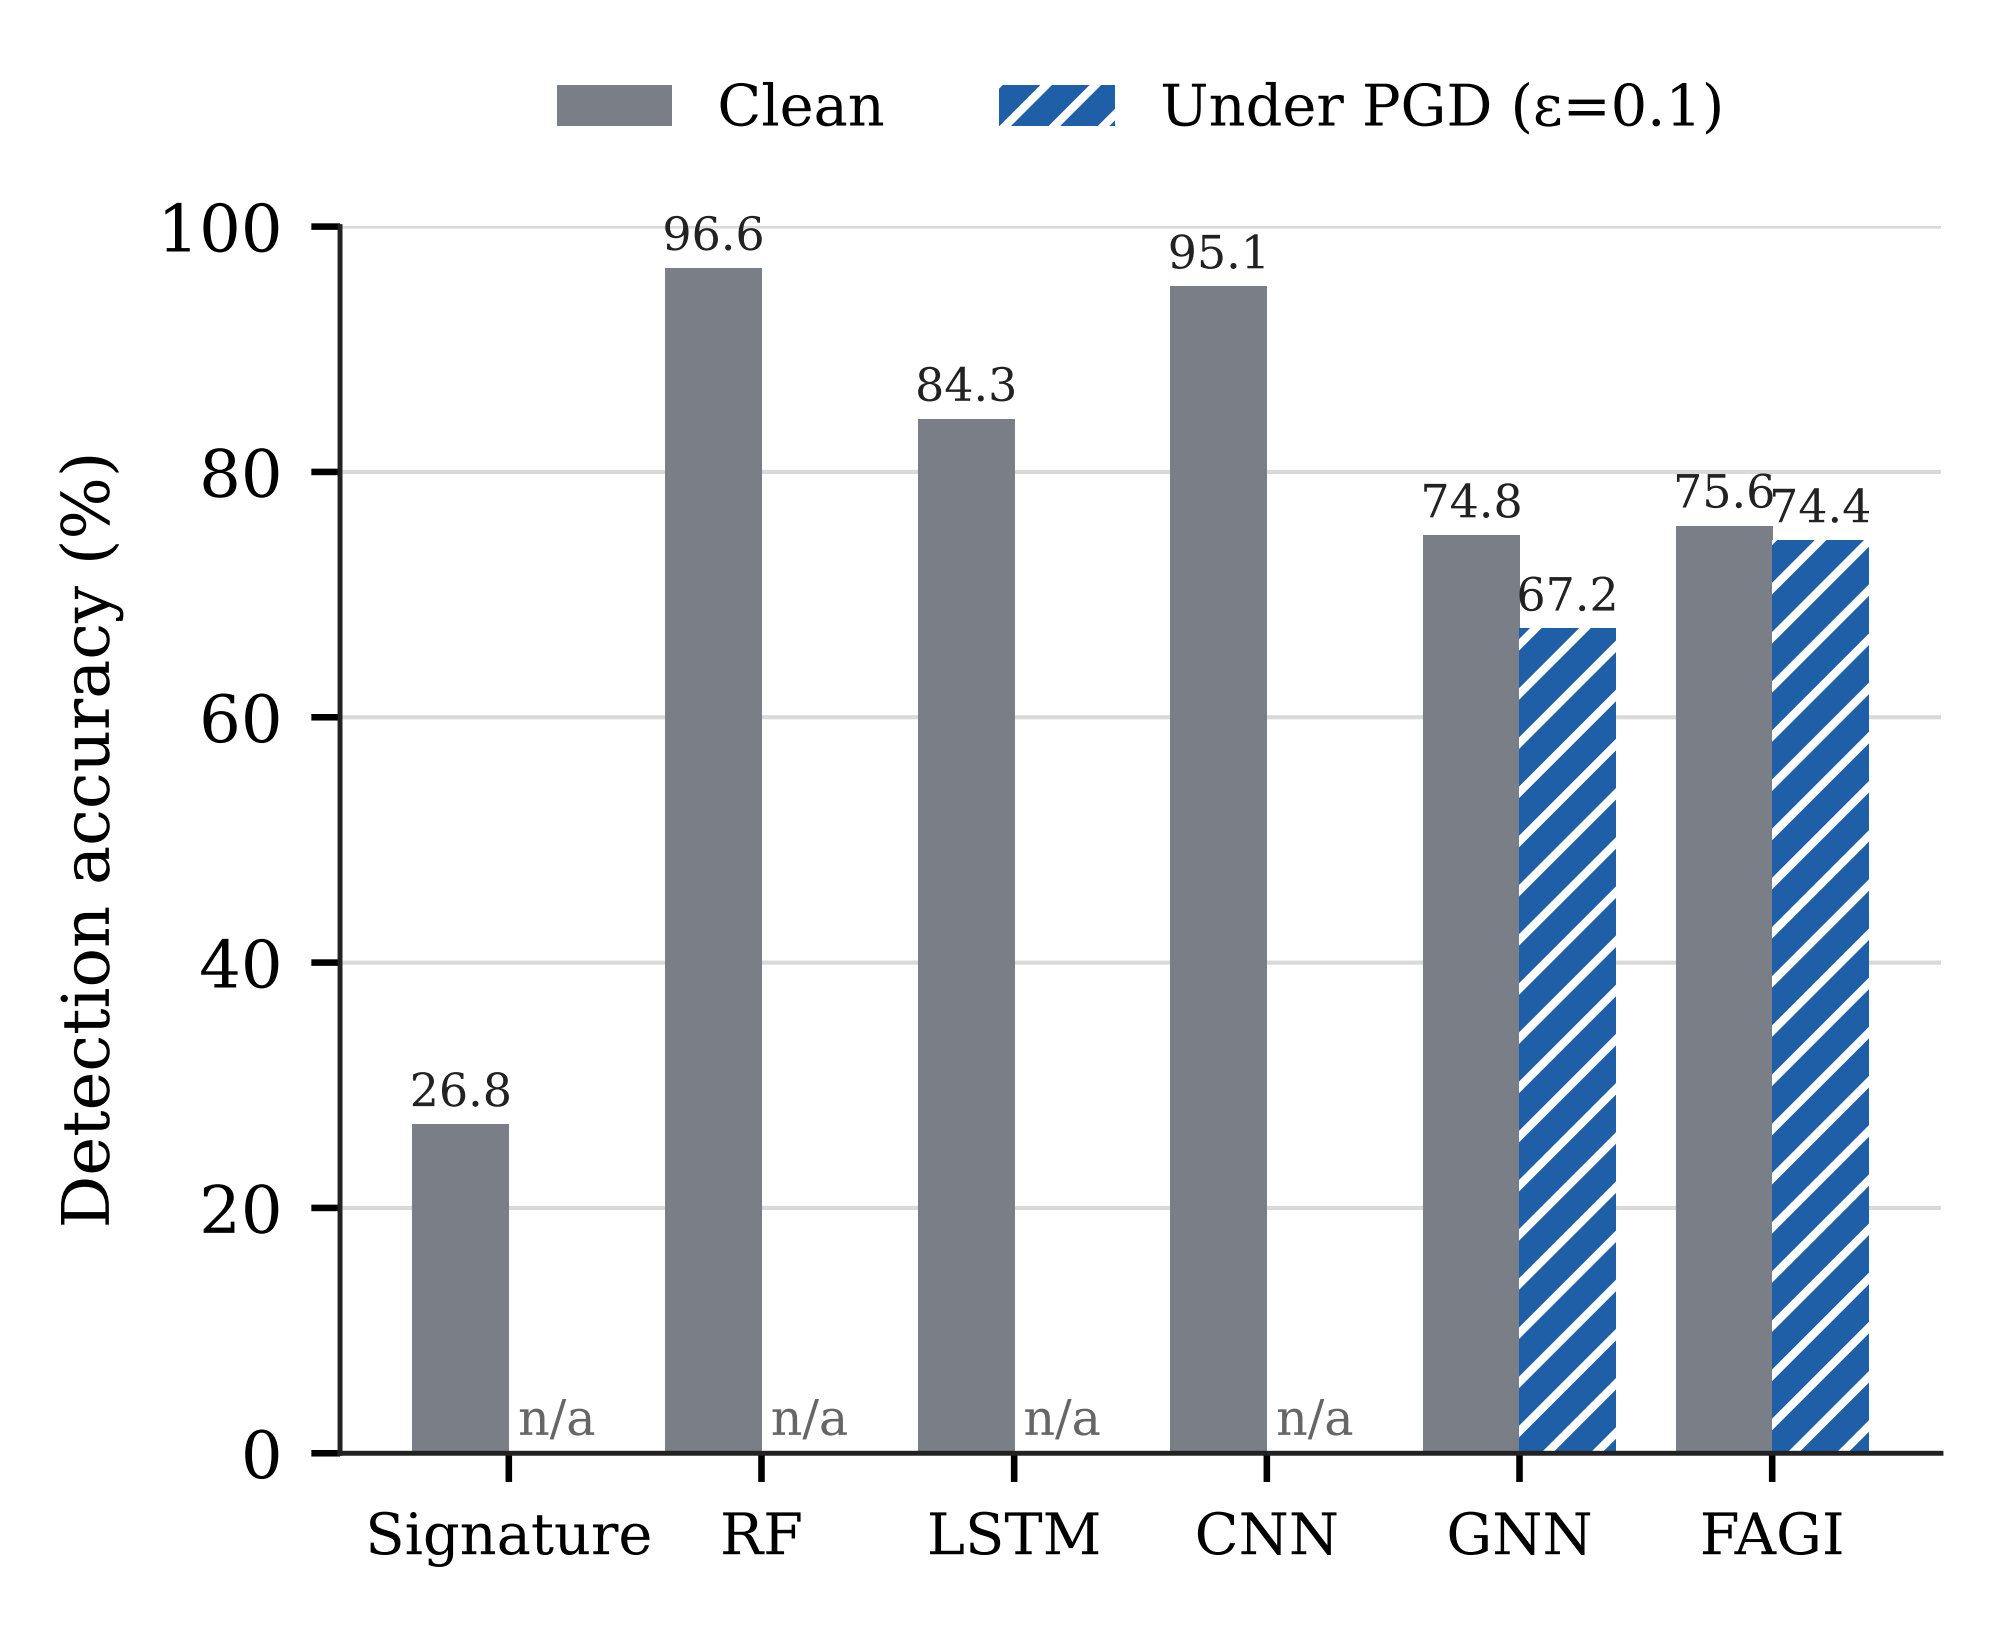
Clean
Under PGD (ε=0.1)
Detection accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
96.6
95.1
84.3
74.8
67.2
75.6
74.4
26.8
n/a
n/a
n/a
n/a
Signature
RF
LSTM
CNN
GNN
FAGI