




### Podrobnosti o důvodu ukončení

#### 1 - Žádné hodnoty GS

Hodnoty GS nebyly k dispozici (např. Ztracen signál senzoru, Vyměnit senzor, Zkontrolujte spojení, Vybitý vysílač, Žádný signál senzoru, Chyba kalibrace GS 2, atd.)

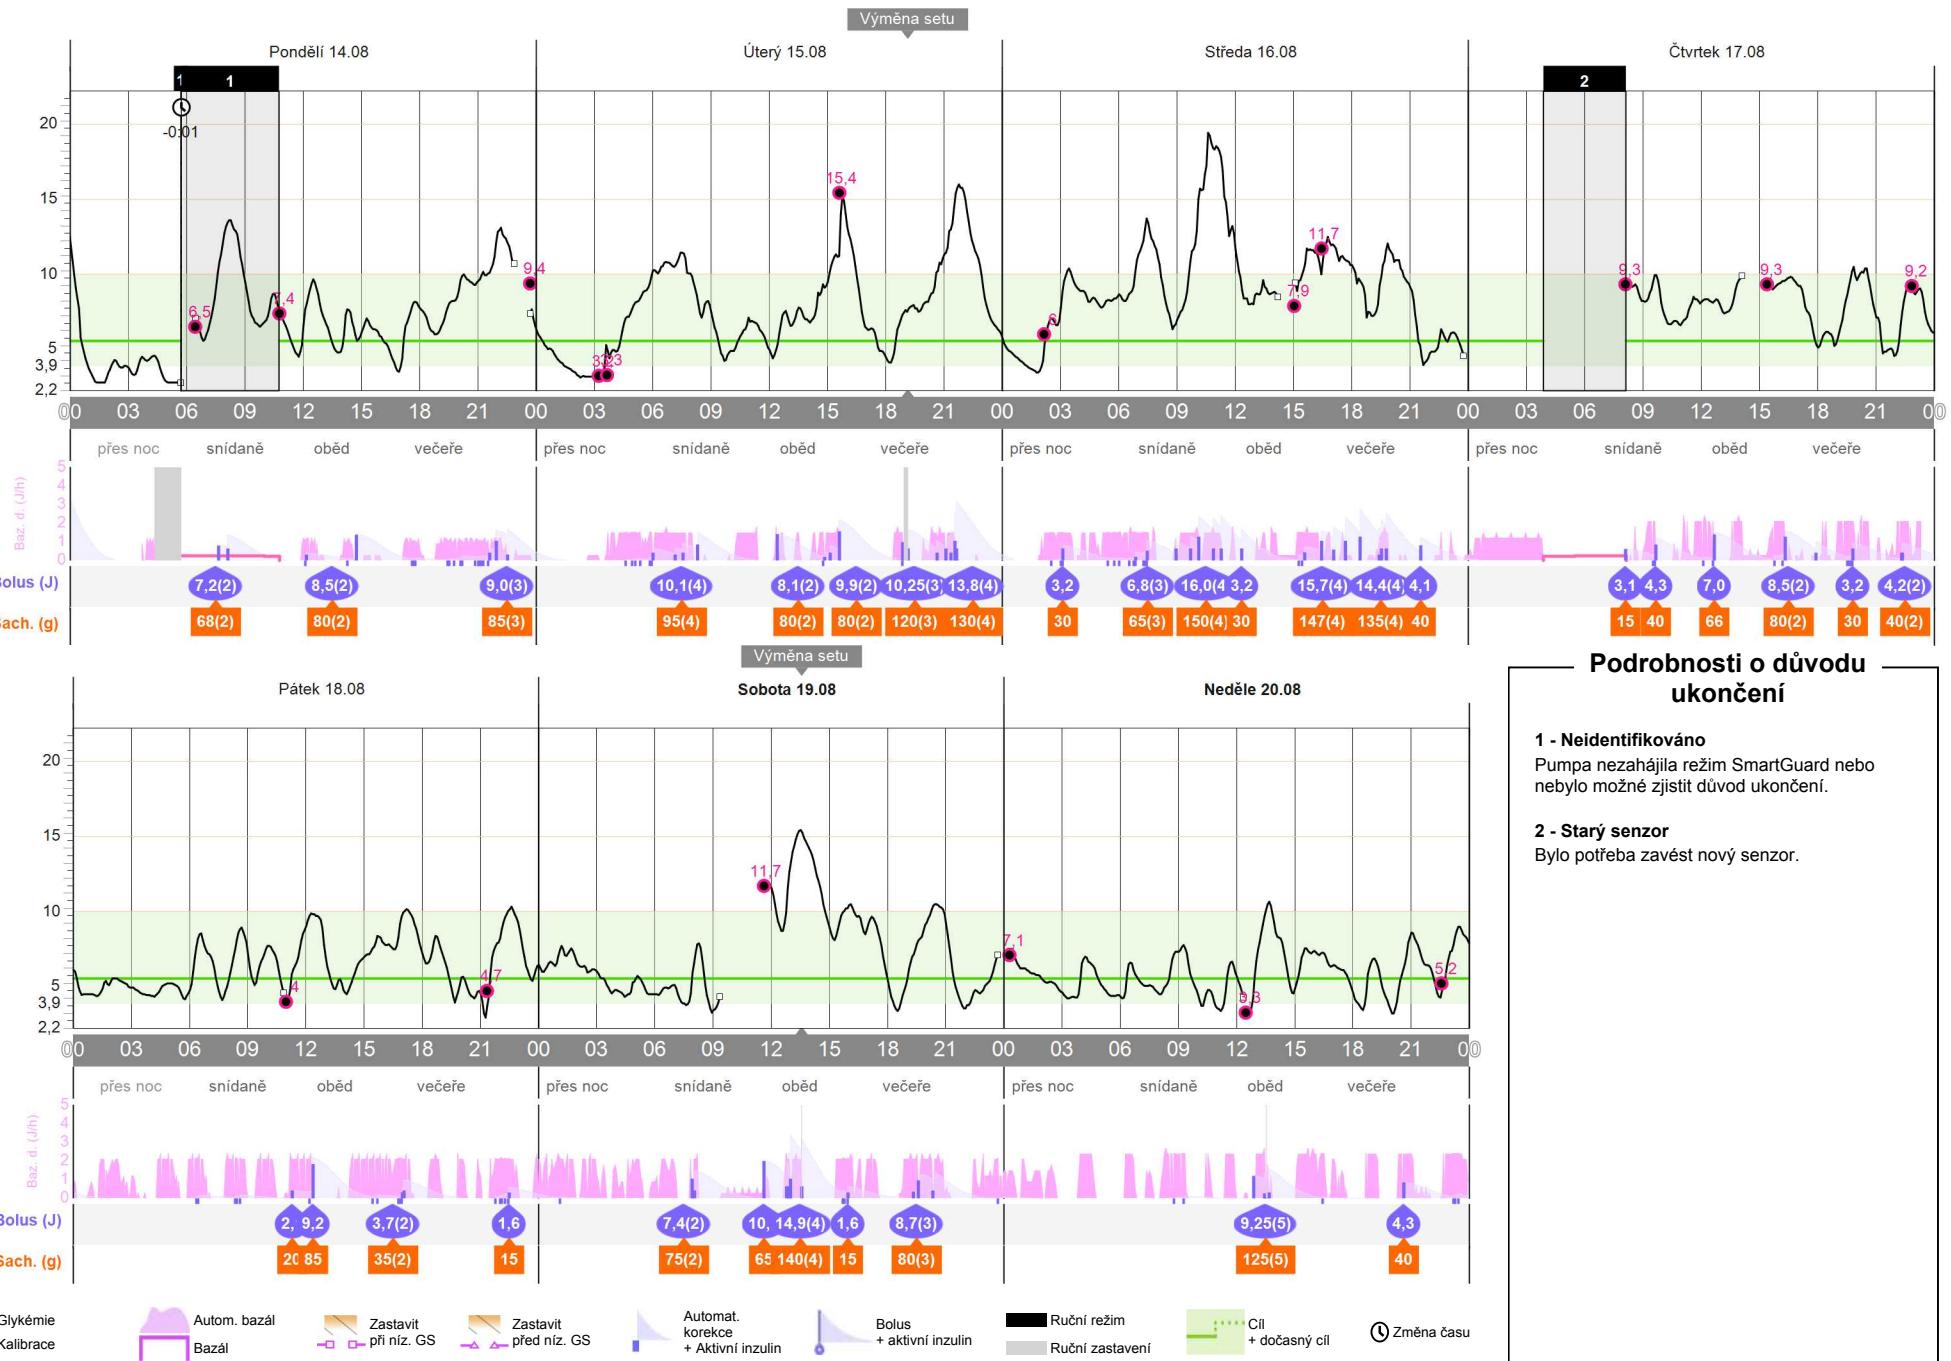

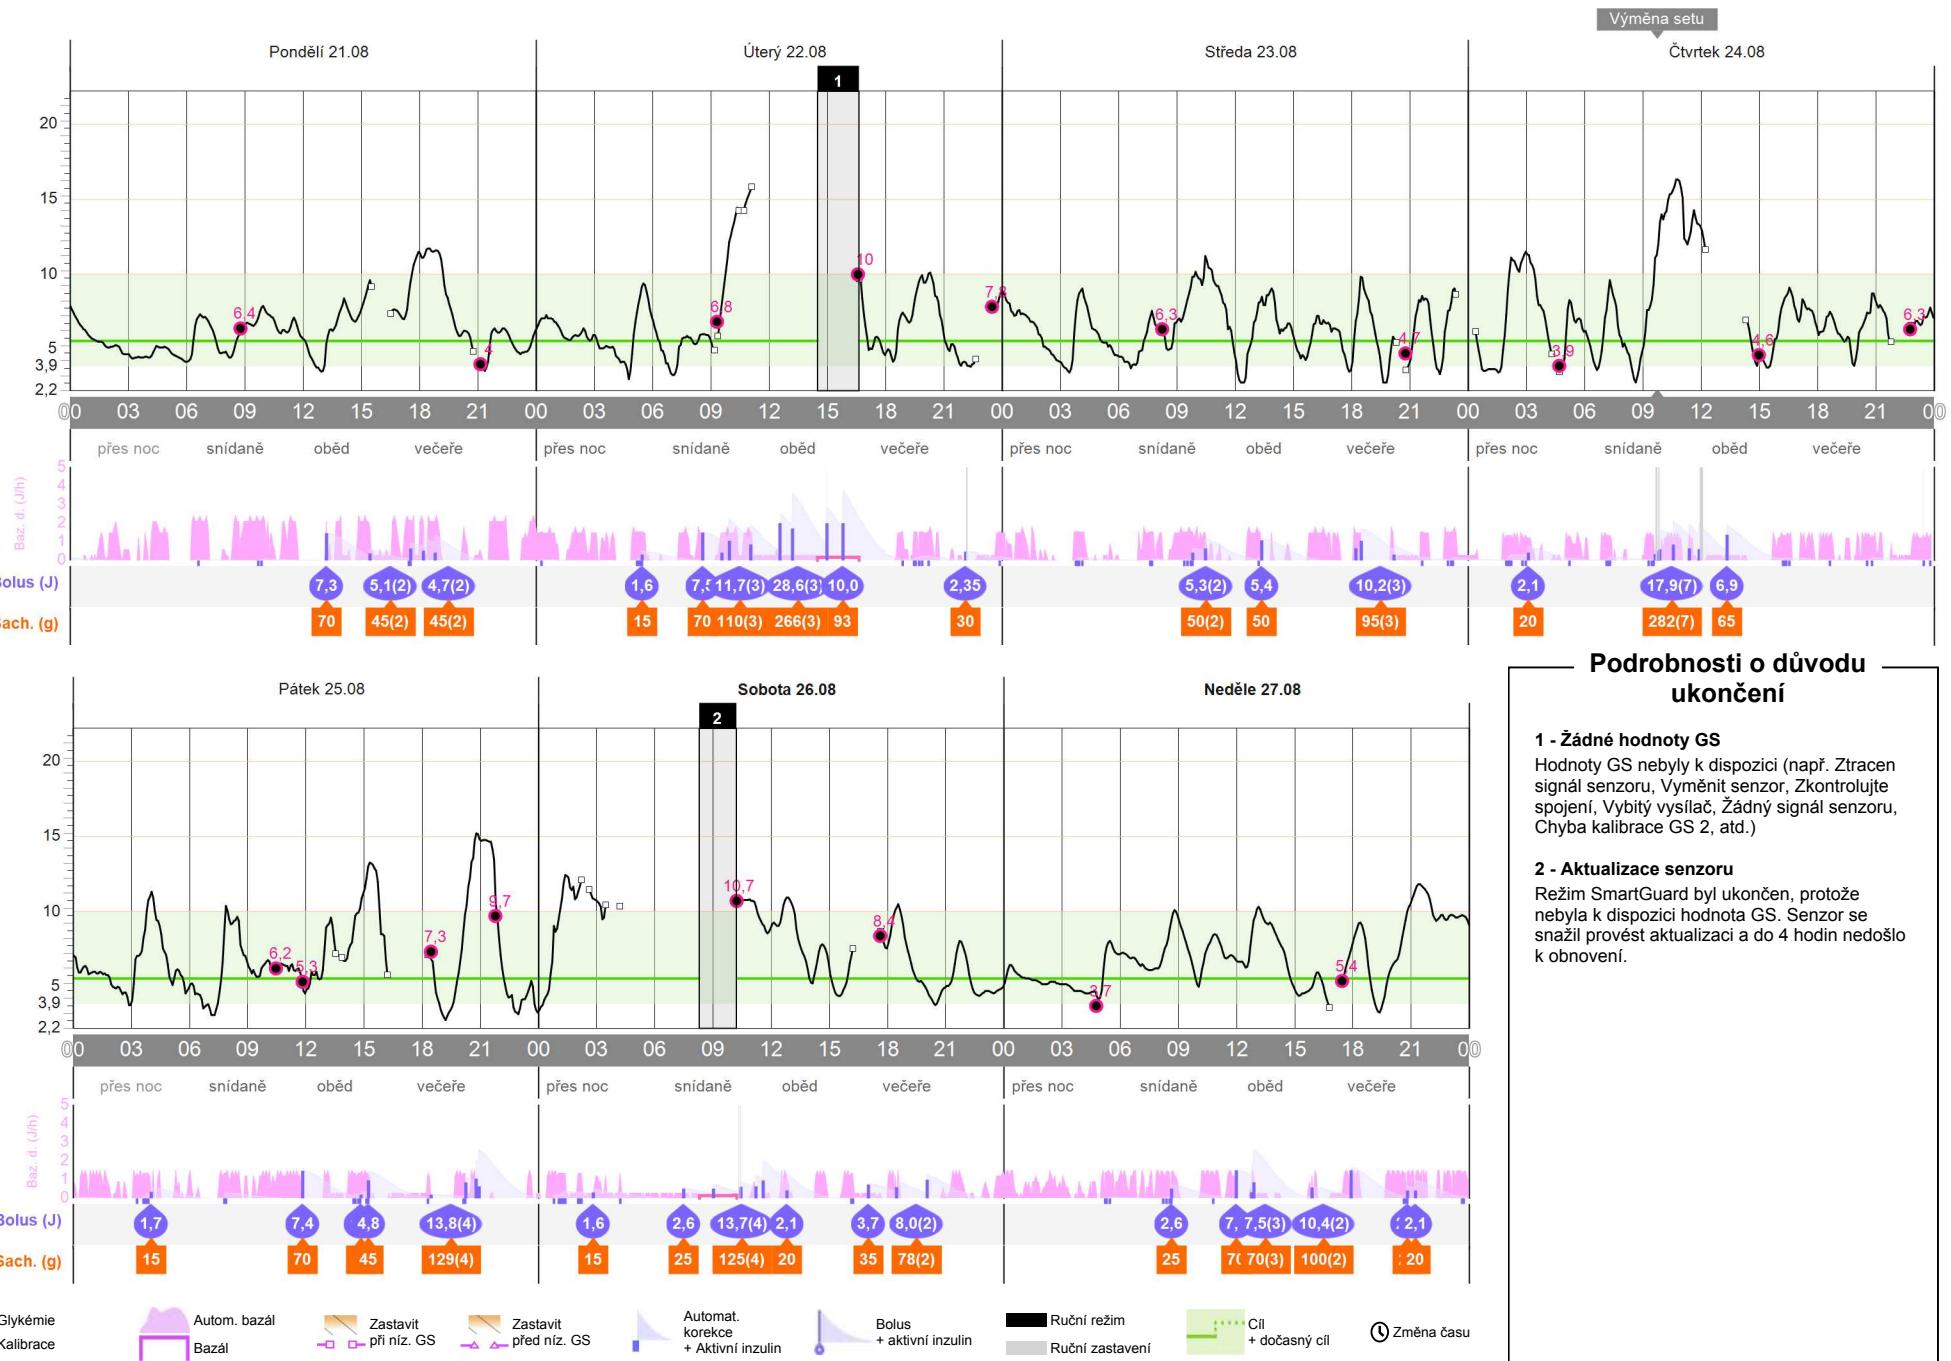

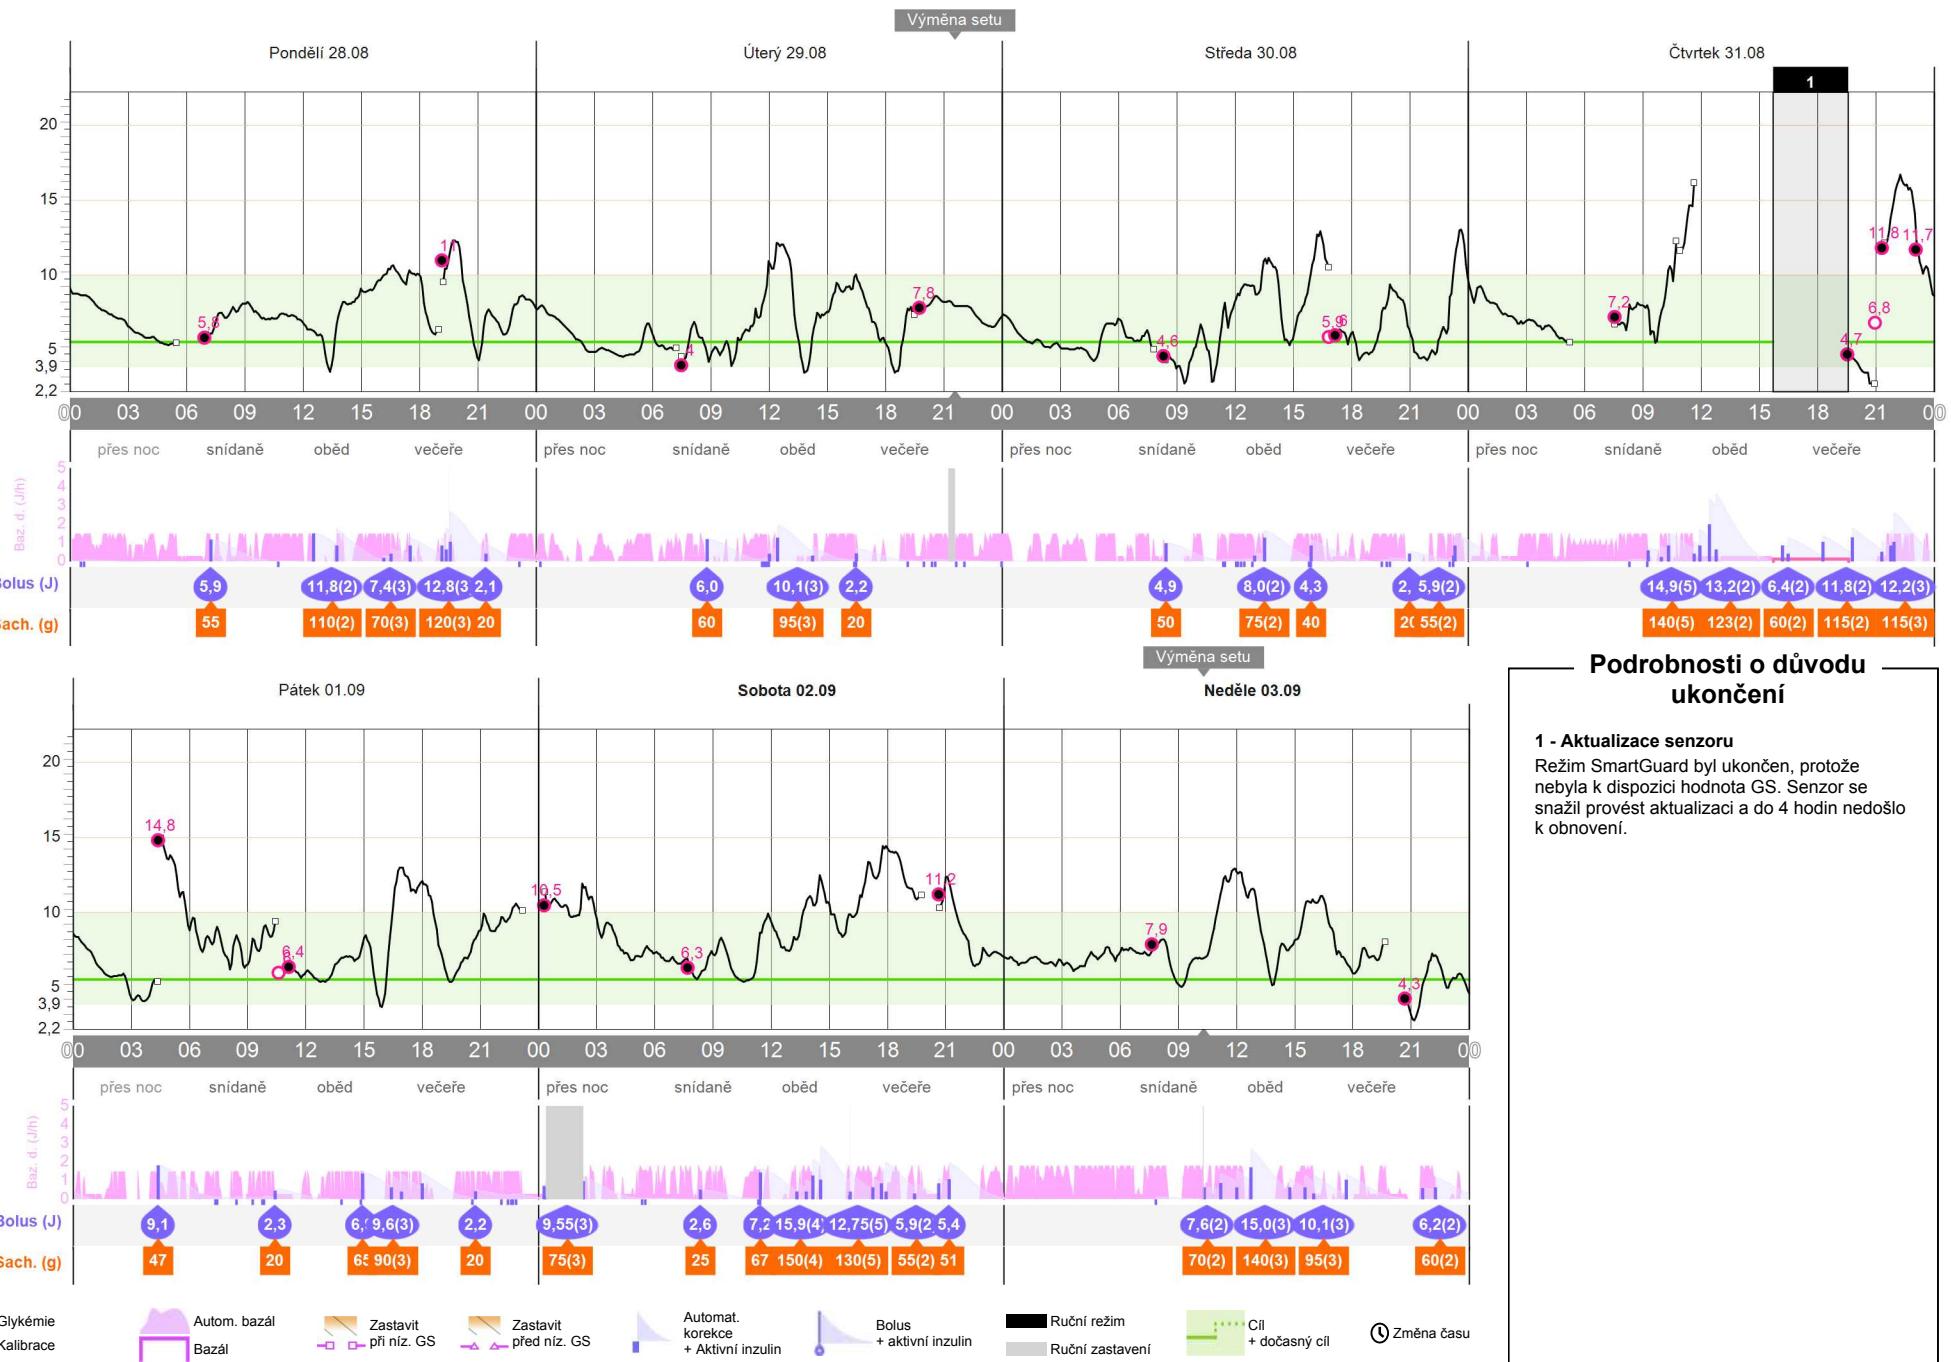


### Podrobnosti o důvodu ukončení

#### 1 - Aktualizace senzoru

Režim SmartGuard byl ukončen, protože nebyla k dispozici hodnota GS. Senzor se snažil provést aktualizaci a do 4 hodin nedošlo k obnovení.




## Všechny bolusy k jídlu

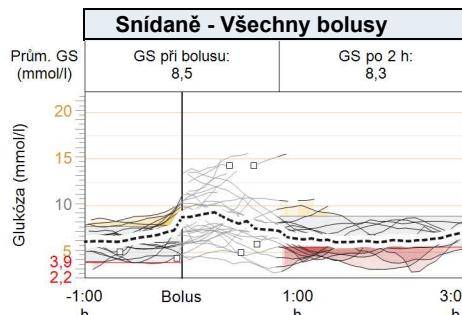

Statist.	
Čas	06:00 - 10:00
Počet bolusů	39
Sachar. poměr (g/J)	9,3
Prům. sacharidy (g)	33 ± 18
Prům. bolus (J)	3,5 ± 1,9

## Snídaně - Analyzovaná jídla


Poznámky

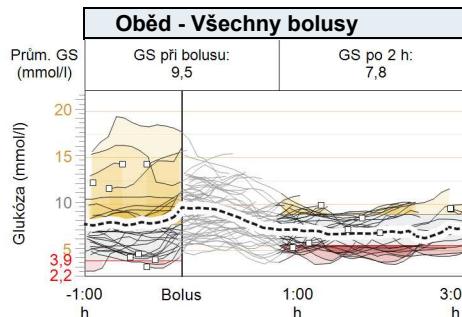

Statist.	
Čas	11:00 - 15:00
Počet bolusů	79
Sachar. poměr (g/J)	9,3
Prům. sacharidy (g)	44 ± 25
Prům. bolus (J)	4,7 ± 2,7

## Oběd - Analyzovaná jídla


Poznámky

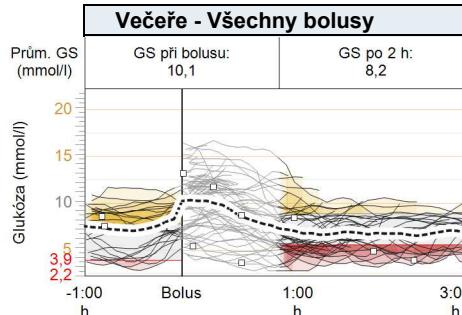

Statist.	
Čas	16:00 - 22:00
Počet bolusů	99
Sachar. poměr (g/J)	9,3
Prům. sacharidy (g)	33 ± 15
Prům. bolus (J)	3,5 ± 1,6

## Večeře - Analyzovaná jídla

Poznámky

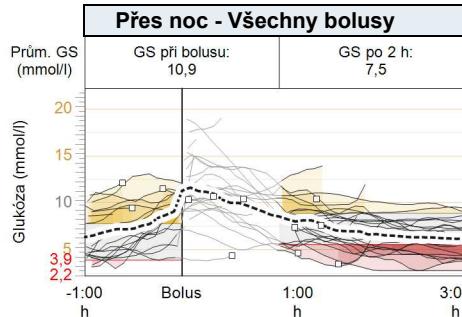

Statist.	
Čas	22:00 - 06:00
Počet bolusů	40
Sachar. poměr (g/J)	9,3
Prům. sacharidy (g)	28 ± 13
Prům. bolus (J)	3,0 ± 1,4


## Přes noc - Analyzovaná jídla

Poznámky


	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 07.08.2023	2	22:55	10	10	10	2							
Úterý 08.08.2023	2	23:55	11	12	12		1	1	1	0,05	1	21,0	0:09 
Středa 09.08.2023	1	17:05	7	8	8								
Čtvrttek 10.08.2023	3	23:00	14	5	5	3							
Pátek 11.08.2023	2	23:15	15	7	7	5	4	1	1	0,05	1	21,8	0:09 
Sobota 12.08.2023	2	21:15	8	9	9	1							
Neděle 13.08.2023	2	22:45	33	18	18	1		1	0,05				0:01 
 Pondělí 14.08.2023	3	22:35	16	7	7								1:24 
Úterý 15.08.2023	3	24:00	8	15	15	2	1	1					0:14 
Středa 16.08.2023	3	23:00	14	18	18	2		1	0,05				0:01 
Čtvrttek 17.08.2023	3	14:40	10	8	8	1							
Pátek 18.08.2023	2	23:55	16	5	5	1							
Sobota 19.08.2023	1	21:30	5	11	11	3		1	0,05	1	21,0	0:02 	
Neděle 20.08.2023	3	23:35	6	6	6	1	3						0:03 
Shrnutí	2,3/den	12d 19h 25m	12,4/den	9,9/den	100,0%	15,8%	6,5%	4	5	0,05J /naplnění	4	21,5J /naplnění	2h 03m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 21.08.2023	2	22:45	5	5	5	2							
Úterý 22.08.2023	3	17:30	12	10	10	1	1		1	0,05			0:05
Středa 23.08.2023	2	23:00	15	6	6	2							
Čtvrtek 24.08.2023	3	20:25	22	9	9		4	1	1	0,05	1	24,3	0:20
Pátek 25.08.2023	4	21:40	16	8	8	3							
Sobota 26.08.2023	2	15:45	12	10	10	2			1	0,75			0:04
Neděle 27.08.2023	2	23:25	13	9	9	1							
Pondělí 28.08.2023	2	22:25	4	10	10				1	0,75			0:01
Úterý 29.08.2023	2	23:35	15	5	5	2		1			1	24,9	0:22
Středa 30.08.2023	3	23:10	14	7	7	1							
Čtvrtek 31.08.2023	5	13:25	3	14	14	1							
Pátek 01.09.2023	3	22:20	14	7	7	3							
Sobota 02.09.2023	3	22:55	4	17	17	2	2						1:56
Neděle 03.09.2023	2	23:00	1	10	10	2		1	1	0,75	1	20,2	0:03
Shrnutí	2,7/den	12d 07h 20m	10,7/den	9,1/den	100,0%	17,3%	5,5%	3	5	0,47J /naplnění	3	23,1J /naplnění	2h 51m

Měření glykémie			Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 04.09.2023	2	23:40	9	11	11	2							
Úterý 05.09.2023	1	8:50	13	3	3								
Shrnutí	1,5/den	1d 08h 30m	11,0/den	7,0/den	100,0%	14,3%	0%	0	0	--	0	--	0m

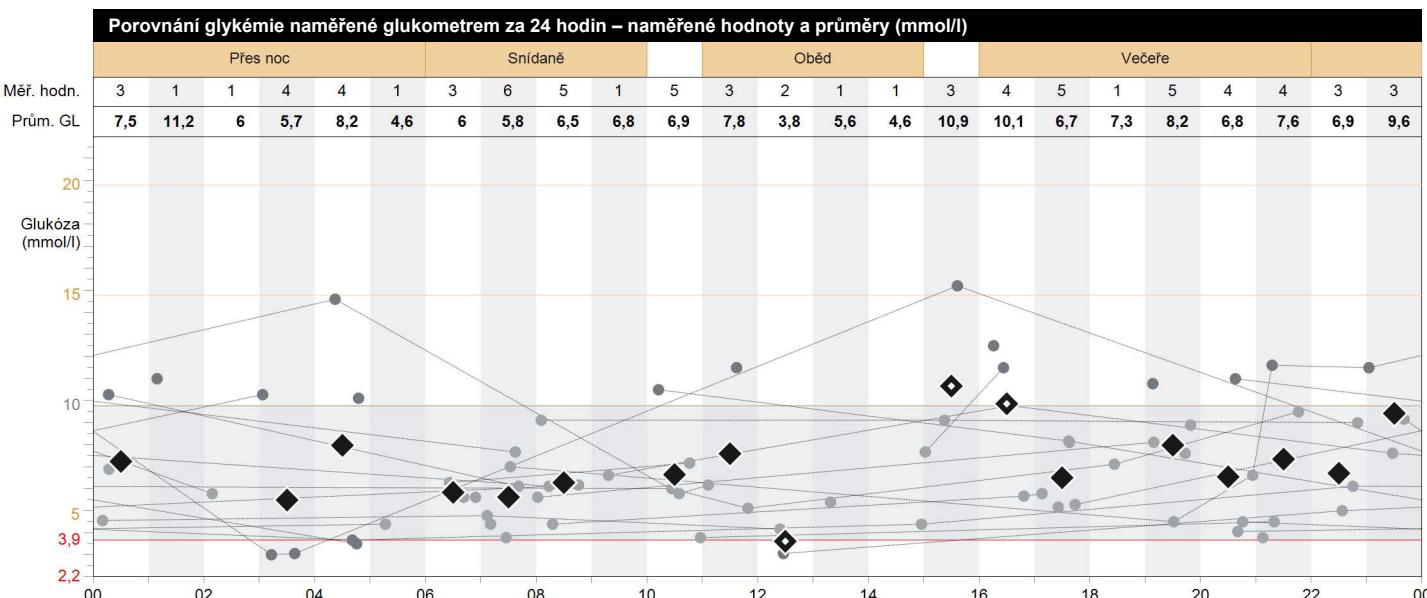

Statistické údaje	07.08 - 05.09
Prům. GL (mmol/l)	7,3 ± 2,8
Naměř. hodn. GL	73   2,4/den
Naměř. hodn. nad cíl. rozsahem	14   19%
Naměř. hodn. pod cíl. rozsahem	4   5%
Denní prům. sach. (g)	330 ± 145
Sach./inzulinový bolus (g/J)	8,8
Celk. denní prům. inzulinu (J)	56,5 ± 14,6
Prům. denní baz. dávka (J)	18,2   32%
Prům. denní bolus (J)	38,3   68%

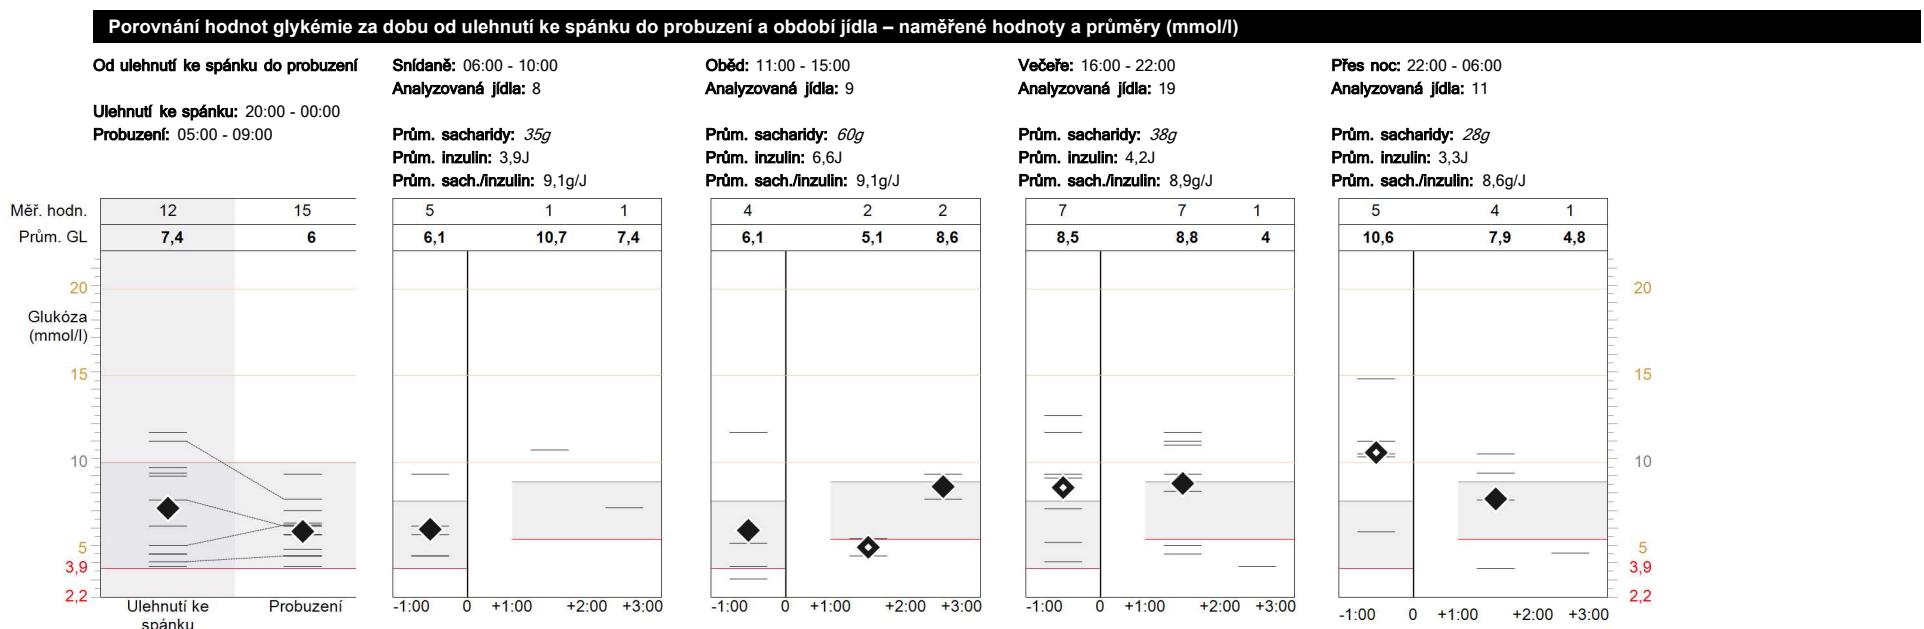

Naměřená hodnota GL

Naměřená hodnota GL

Mimo graf

Průměr v cílovém rozsahu

Průměr mimo cílový rozsah

	Přes noc						Snídaně				Oběd					Večeře					Přes noc			Celk. denní dávky		
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Pondělí 07.08.2023							5,8		0,483	0,783		90	40	88					9,1	10	78	50	50		Průměr (2): 7,5mmol/l Sacharidy: 406g Inzulin: 62,9J Bolus: 73%	
Úterý 08.08.2023								5,8	70		60	40	30						8,3						Průměr (2): 7,1mmol/l Sacharidy: 480g Inzulin: 74,5J Bolus: 72%	
Sředa 09.08.2023							4,6	10		20	60	40	93						40						Průměr (1): 4,6mmol/l Sacharidy: 293g Inzulin: 50,0J Bolus: 67%	
Čtvrtek 10.08.2023	4,8						5	15	80		6,40	4,30	10,0	4,4		10	75			15					Průměr (3): 4,7mmol/l Sacharidy: 195g Inzulin: 48,6J Bolus: 49%	
Pátek 11.08.2023		11,2	114						1,00	0,858	8,60			5,6		0,343	0,586		0,243	20					Průměr (2): 8,4mmol/l Sacharidy: 209g Inzulin: 43,6J Bolus: 44%	
Sobota 12.08.2023	0,200			5,8					65		15	75					12,7	80		15				15	Průměr (2): 9,3mmol/l Sacharidy: 265g Inzulin: 50,9J Bolus: 65%	
Neděle 13.08.2023	0,103	0,308	0,305	0,305	10,3	20			6,90		1,60	8,00					11,9			1,60	0,501	0,802		1,60	Průměr (2): 9,3mmol/l Sacharidy: 595g Inzulin: 86,9J Bolus: 80%	
Pondělí 14.08.2023	●						6,5	38	30		7,4			15		65			0,527					9,4	Průměr (3): 7,8mmol/l Sacharidy: 233g Inzulin: 36,2J Bolus: 76%	
Úterý 15.08.2023				3,2				4,00	3,20								15,4								Průměr (3): 7,3mmol/l Sacharidy: 505g Inzulin: 67,7J Bolus: 80%	
Sředa 16.08.2023			6	30				20	35	40			70		10	80		7,9	11,7		70	30	20	130	Průměr (3): 8,5mmol/l Sacharidy: 597g Inzulin: 84,8J Bolus: 80%	
Čtvrtek 17.08.2023			0,173	3,85				0,345	2,09	3,62	10	25	30	30	90	30	30		3,75	5,30	8,20	6,40	8,00		9,2	Průměr (3): 9,3mmol/l Sacharidy: 271g Inzulin: 54,1J Bolus: 63%
Pátek 18.08.2023									9,3	15	40						9,3	60	20		30	40			Průměr (2): 4,4mmol/l Sacharidy: 155g Inzulin: 48,8J Bolus: 44%	
Sobota 19.08.2023		0,219							55	20						11,7									Průměr (1): 11,7mmol/l Sacharidy: 375g Inzulin: 67,7J Bolus: 65%	
Neděle 20.08.2023	7,1							5,30	2,10							65	110	30		15	60	20		0,219	Průměr (3): 5,2mmol/l Sacharidy: 165g Inzulin: 39,8J Bolus: 38%	

&gt; 10,0mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

Zastavení

Částečný den

Změna času

&lt; 3,9mmol/l

Ruční bolus nebo bolus s korekcí

Zastavit pomocí senzoru

Přetočení pumpy

Vynechaný jídlo

	Přes noc						Snídaně				Oběd				Večeře					Přes noc			Celk. denní dávky					
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Pondělí 21.08.2023									6,4					70	15				30	45		4				Průměr (2): 5,2mmol/l Sacharidy: 160g Inzulin: 41,2J Bolus: 46%		
Úterý 22.08.2023								0,219		0,438				7,30	1,90				4,24	4,70					7,8	Průměr (3): 8,2mmol/l Sacharidy: 584g Inzulin: 79,0J Bolus: 82%		
Sředa 23.08.2023									6,8					40	93	80	93	93			10	0,370	0,980	0,070		2,35	0,270	Průměr (2): 5,5mmol/l Sacharidy: 195g Inzulin: 39,5J Bolus: 62%
Čtvrtek 24.08.2023								15	2,48		70	70	4,30	10,0	8,60	10,0	10,0								6,3	0,373	Průměr (3): 4,9mmol/l Sacharidy: 367g Inzulin: 47,6J Bolus: 69%	
Pátek 25.08.2023								1,70	3,9		7,50	7,40								7,3	9	120	13,7			9,7	Průměr (4): 7,1mmol/l Sacharidy: 269g Inzulin: 47,8J Bolus: 71%	
Sobota 26.08.2023								1,14	15		0,588			25	25	75	20				8,4	35	28	50				Průměr (2): 9,5mmol/l Sacharidy: 298g Inzulin: 44,8J Bolus: 79%
Neděle 27.08.2023								2,06					2,60	2,60	3,10	8,00	2,10				0,276	3,70	3,00	5,00				Průměr (2): 4,6mmol/l Sacharidy: 305g Inzulin: 51,7J Bolus: 67%
Pondělí 28.08.2023								1,34	1,70					10,7													Průměr (2): 8,4mmol/l Sacharidy: 375g Inzulin: 60,0J Bolus: 68%	
Úterý 29.08.2023								3,7						25	25	75	20										Průměr (2): 5,9mmol/l Sacharidy: 175g Inzulin: 40,5J Bolus: 55%	
Sředa 30.08.2023								0,350					25	3,53	0,083	7,50	7,50				30	70	7,50		2,95	2,10	0,167	Průměr (3): 5,5mmol/l Sacharidy: 240g Inzulin: 47,6J Bolus: 61%
Čtvrtek 31.08.2023								0,080					5,8	55	0,180						11			20			0,180	Průměr (5): 8,5mmol/l Sacharidy: 553g Inzulin: 73,9J Bolus: 80%
Pátek 01.09.2023								14,8	47		9,10			40	40	60	123				6,0	15	60	40	6,4	0,075	7,07	Průměr (3): 9,1mmol/l Sacharidy: 242g Inzulin: 53,8J Bolus: 62%
Sobota 02.09.2023								10,5					6,3	25	2,60												Průměr (3): 9,3mmol/l Sacharidy: 553g Inzulin: 78,4J Bolus: 77%	
Neděle 03.09.2023								45	4,65		30	4,90		0,334													Průměr (2): 6,1mmol/l Sacharidy: 365g Inzulin: 63,5J Bolus: 62%	

&gt; 10,0mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

Zastavení

Částečný den

Změna času


&lt; 3,9mmol/l

Ruční bolus nebo bolus s korekcí

Zastavit pomocí senzoru

Přetočení pumpy

Vynechaný jídlo

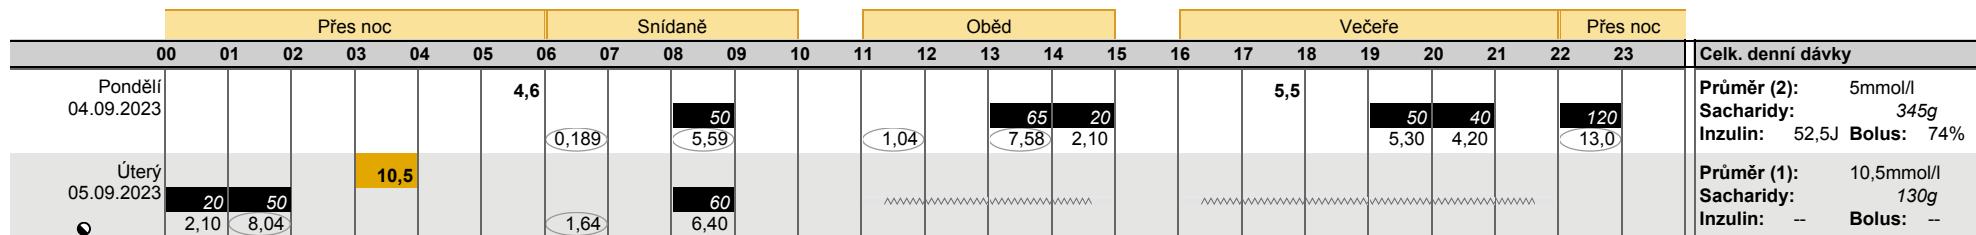

■ &gt; 10,0mmol/l

■ &lt; 3,9mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

○ Ruční bolus nebo bolus s korekcí

● Zastavení

✖ Zastavit pomocí senzoru

● Částečný den

|||| Přetočení pumpy

⌚ Změna času

~~~~~ Vynechané jídlo

Bazál

|                                |            |  |  |                |
|--------------------------------|------------|--|--|----------------|
| <b>Maximální bazální dávka</b> | 2,00 J/hod |  |  | <b>Aktual.</b> |
|--------------------------------|------------|--|--|----------------|

## Bazál 1 (aktivní)

**24 hod celkem** 3,150 J 

| Čas   | J/hod |  |
|-------|-------|--|
| 00:00 | 0,100 |  |
| 05:30 | 0,150 |  |
| 10:00 | 0,175 |  |
| 13:30 | 0,125 |  |

Bazál 2

24 hod celkem --

| Čas | J/hod |  |
|-----|-------|--|
| --  | --    |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |

Bazál 3

24 hod celkem --

| Čas | J/hod |  |
|-----|-------|--|
| --  | --    |  |
|     |       |  |
|     |       |  |
|     |       |  |

## Bolus

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Bolus Wizard</b>                       | Zap.      |
| <b>Jednotky</b>                           | g, mmol/l |
| <b>Doba aktivního inzulinu<br/>(h:mm)</b> | 3:00      |
| <b>Maximální bolus</b>                    | 10,0 J    |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Snadný bolus</b>     | 0,10 J     |
| <b>Přírůstek bolusu</b> | 0,1 J      |
| <b>Rychlosť bolusu</b>  | Standardná |
| <b>Komb./Rozl.</b>      | Vyp/Vyp    |

## Sacharidový p (g/J)

Citl. na inzulin  
(mmol/l na J)

## Cílová glykémie (mmol/l)

## Přednastav. bolus

| Název   | Normální | Rozložený |  | Aktual. |
|---------|----------|-----------|--|---------|
| Bolus 1 |          |           |  |         |
| Snídaně |          |           |  |         |
| Večeře  |          |           |  |         |
| Oběd    |          |           |  |         |
| Svačina |          |           |  |         |
| Bolus 2 |          |           |  |         |
| Bolus 3 |          |           |  |         |
| Bolus 4 |          |           |  |         |

Přednast. doč. b.

| Název        | Rychl. | Trvání |  |
|--------------|--------|--------|--|
| Vys. zátěž   |        |        |  |
| Střed. zátěž |        |        |  |
| Nízká zátěž  |        |        |  |
| Nemoc        |        |        |  |

| Název       | Rychl. | Trvání |  |
|-------------|--------|--------|--|
| Doč. baz. 1 |        |        |  |
| Doč. baz. 2 |        |        |  |
| Doč. baz. 3 |        |        |  |
| Doč. baz. 4 |        |        |  |

SmartGuard

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>SmartGuard</b>       | Zap        |
| <b>Cílová hodnota</b>   | 5,5 mmol/l |
| <b>Automat. korekce</b> | Zap        |

Výstrahy vys. GS

## **p (Odložení 0:20)**

Výstrahy níz. GS

p (Odložení 0:10)

Senzor

Senzor Zap

Připomínka kalibrace Zap

Čas připomínky kalibrace 1:00

Poznámky

## Bazál (pokračování)

## Připomínky

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Varov. při nízk. stavu zás.</b> | Jednotky inzul. |
| <b>Množství</b>                    | 20 J            |
| <b>Kontrola GL po bolusu</b>       | Zap             |
| <b>Výměna setu</b>                 | Vyp             |

### Zmeškaný bolus k jídlu

| Název   | Počátek | Konec |
|---------|---------|-------|
| Jídlo 1 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 2 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 3 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 4 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 5 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 6 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 7 | Vyp     | Vyp   |
| Jídlo 8 | Vyp     | Vyp   |

## **Osobní připomínky**

| Název        | Čas |
|--------------|-----|
| Připominka 1 | Vyp |
| Připominka 2 | Vyp |
| Připominka 3 | Vyp |
| Připominka 4 | Vyp |
| Připominka 5 | Vyp |
| Připominka 6 | Vyp |
| Změrite GL   | Vyp |
| Léky         | Vyp |

Příslušenství

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Režim blokování</b>    | Vyp            |
| <b>Formát času</b>        | 24 hod         |
| <b>Jas</b>                | Autom.         |
| <b>Doba podsvícení</b>    | 15 s           |
| <b>Možnosti zvuku</b>     | Zvuk a vibrace |
| <b>Hlasitost alarmu</b>   | 3              |
| <b>Automat. zastavení</b> | 12:00          |

Středa 23.08

Celk. denní dávka 39,5 J


Celkový bazál 38 % | 15,0 J

Celkový bolus 62 % | 24,5 J

{ Bolus 85% | 20,9 J

+ Automat. korekce 15% | 3,6 J }

Čas v cíl. rozs.

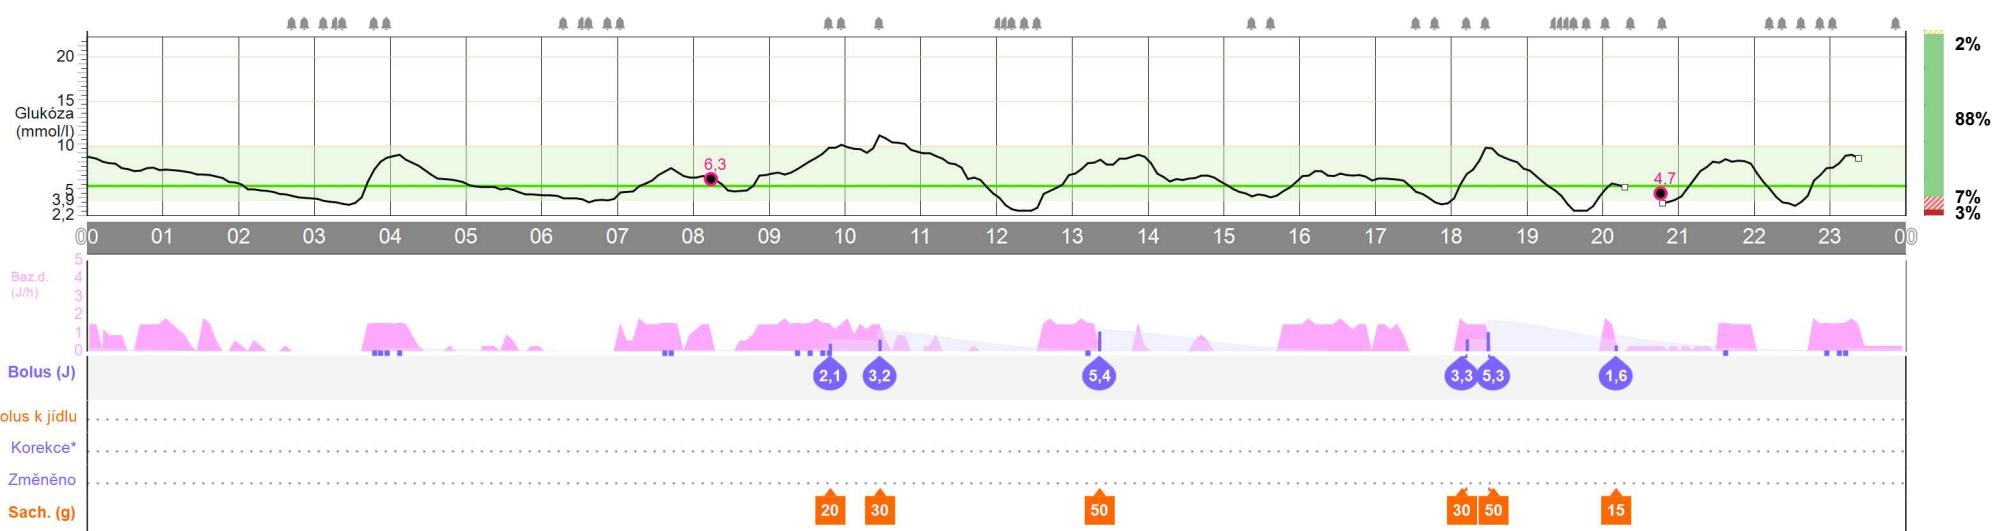

Čtvrtek 24.08

Celk. denní dávka 47,6 J


Celkový bazál 31 % | 14,6 J

Výměna setu  
Celkový bolus 69 % | 33,0 J

{ Bolus 82% | 26,9 J

+ Automat. korekce 18% | 6,1 J }

Čas v cíl. rozs.

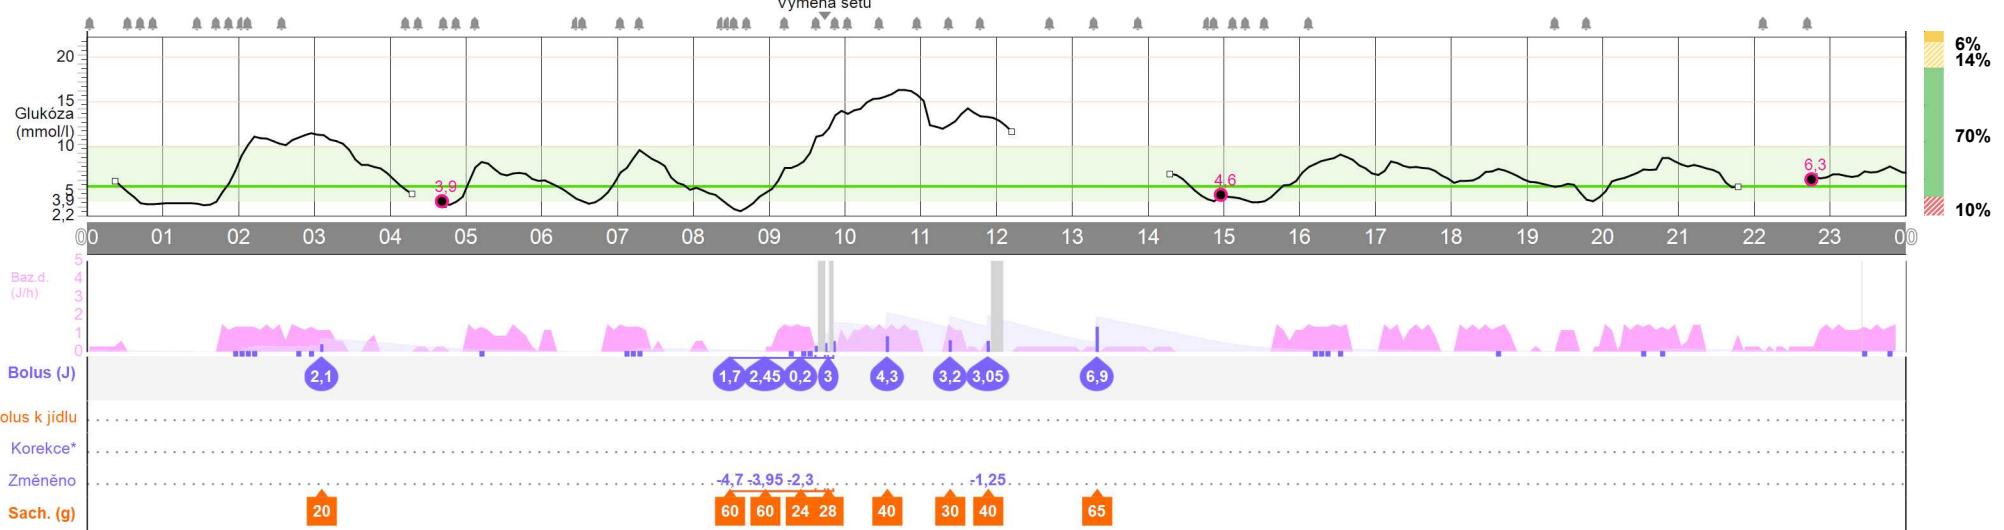

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Pátek 25.08

Celk. denní dávka 47,8 J


Celkový bazál 29 % | 13,8 J

Celkový bolus 71 % | 34,0 J

{ Bolus 84% | 28,7 J

+ Automat. korekce 16% | 5,3 J }

Čas v cíl. rozs.

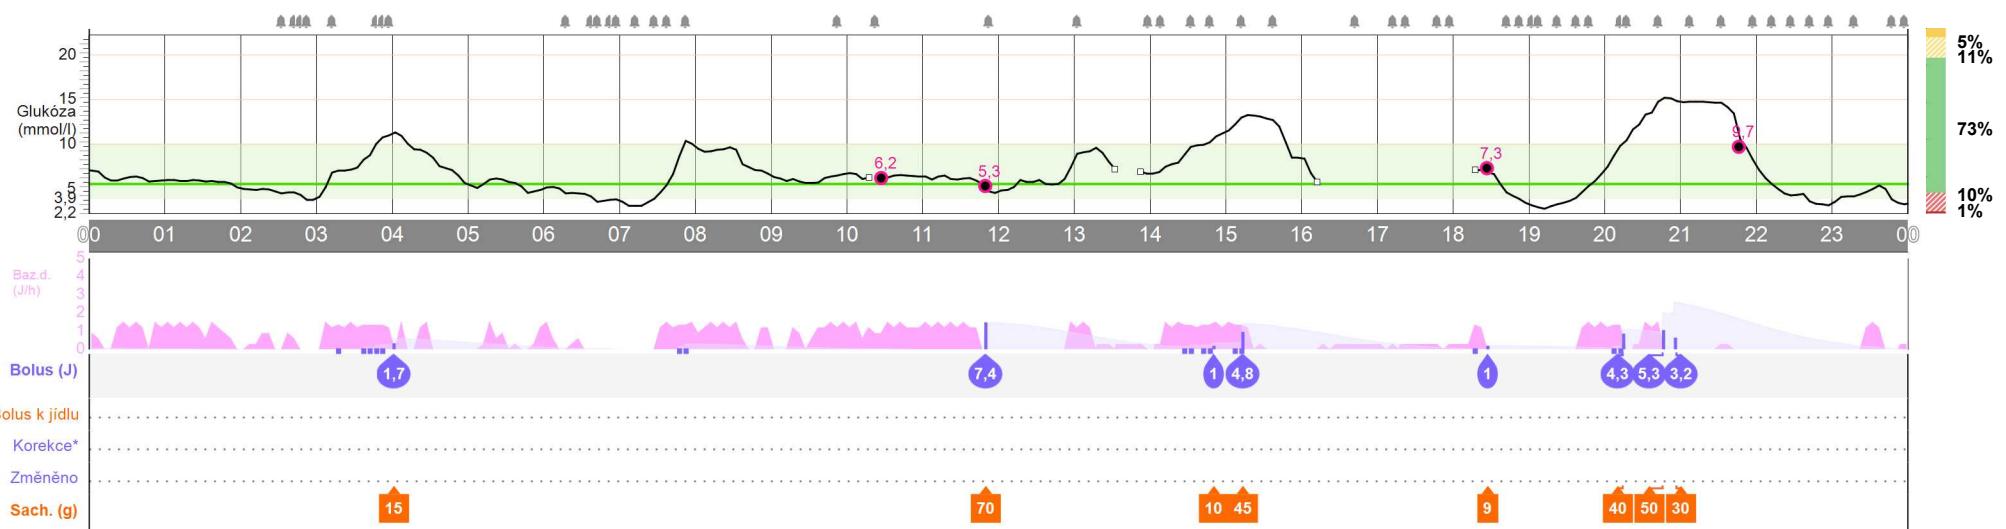

Sobota 26.08

Celk. denní dávka 44,8 J


Celkový bazál 21 % | 9,6 J

Celkový bolus 79 % | 35,2 J

{ Bolus 90% | 31,7 J

+ Automat. korekce 10% | 3,5 J }

Čas v cíl. rozs.

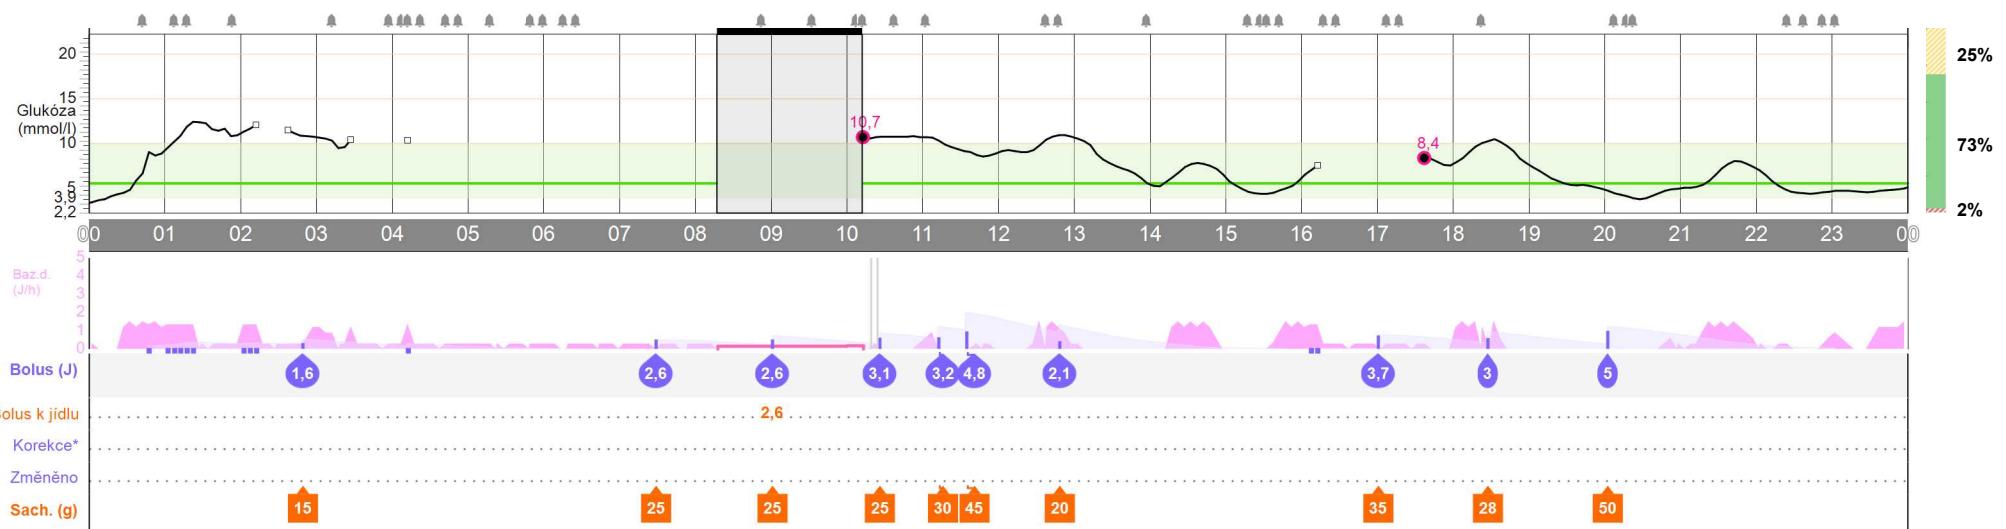

\*S ohledem na aktivní insulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní insulin

Bolus + Aktivní insulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

Ruční zastavení

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Neděle 27.08

Celk. denní dávka 51,7 J


Celkový bazál 33 % | 17,1 J

Celkový bolus 67 % | 34,6 J

{ Bolus 93% | 32,2 J

+ Automat. korekce 7% | 2,4 J }

Čas v cíl. rozs.

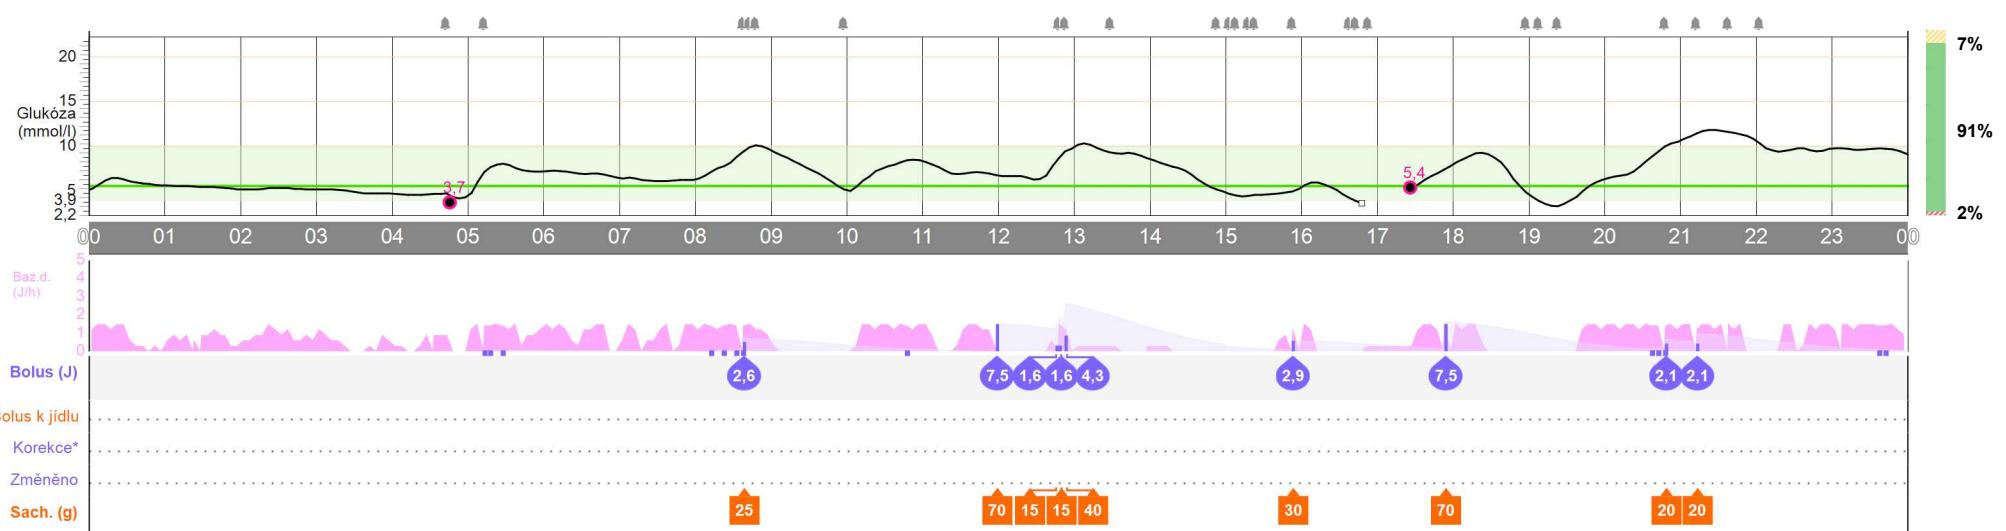

## Pondělí 28.08

Celk. denní dávka 60,0 J


Celkový bazál 32 % | 19,3 J

Celkový bolus 68 % | 40,7 J

{ Bolus 98% | 40,0 J

+ Automat. korekce 2% | 0,7 J }

Čas v cíl. rozs.

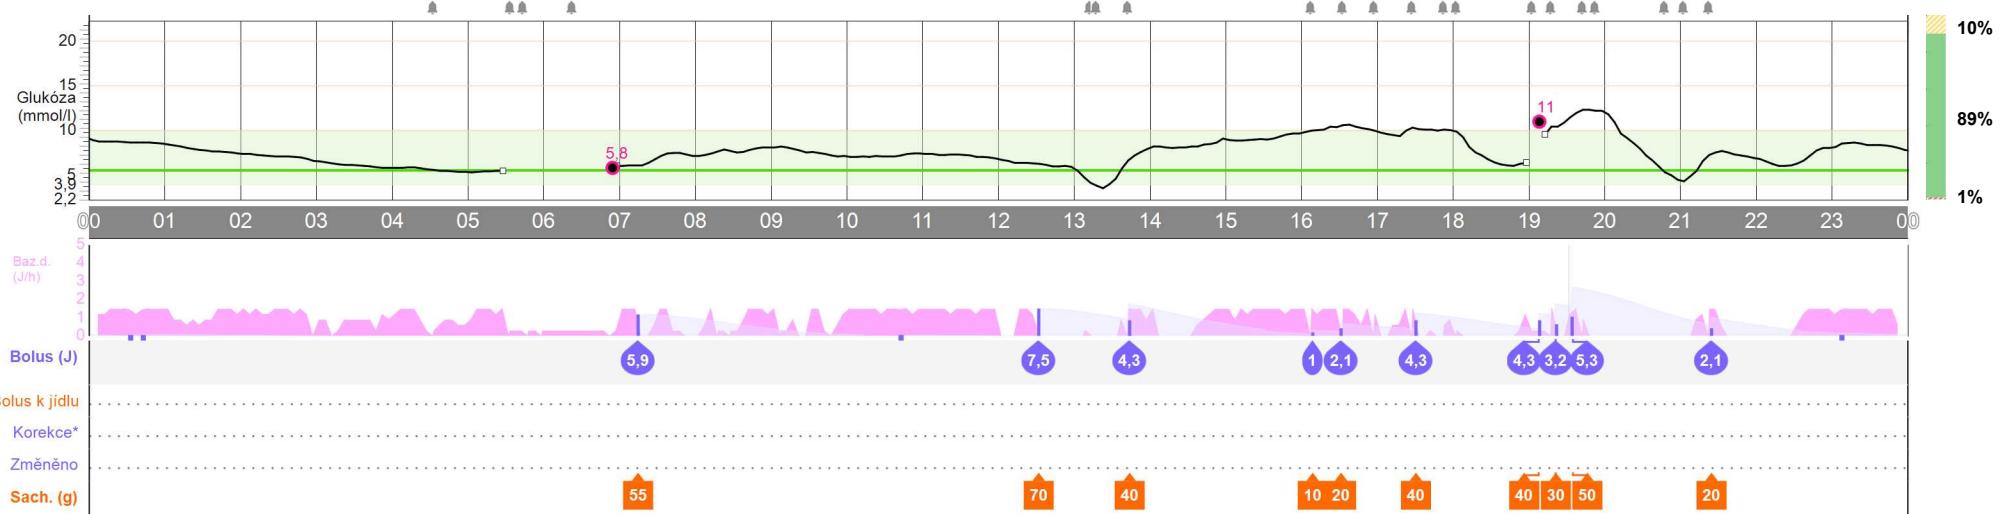

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat.

korekce + Aktivní inzulin

Bolus

+ Aktivní inzulin

Cíl

+ dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Úterý 29.08

Celk. denní dávka 40,5 J

Celkový bazál 45 % | 18,4 J

Celkový bolus 55 % | 22,1 J

Bolus 83% | 18,3 J

Automat. korekce 17% | 3,8 J

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.



Středa 30.08

Celk. denní dávka 47,6 J


Celkový bazál 39 % | 18,7 J

Celkový bolus 61 % | 28,9 J

Bolus 87% | 25,2 J

Automat. korekce 13% | 3,7 J

Čas v cíl. rozs.

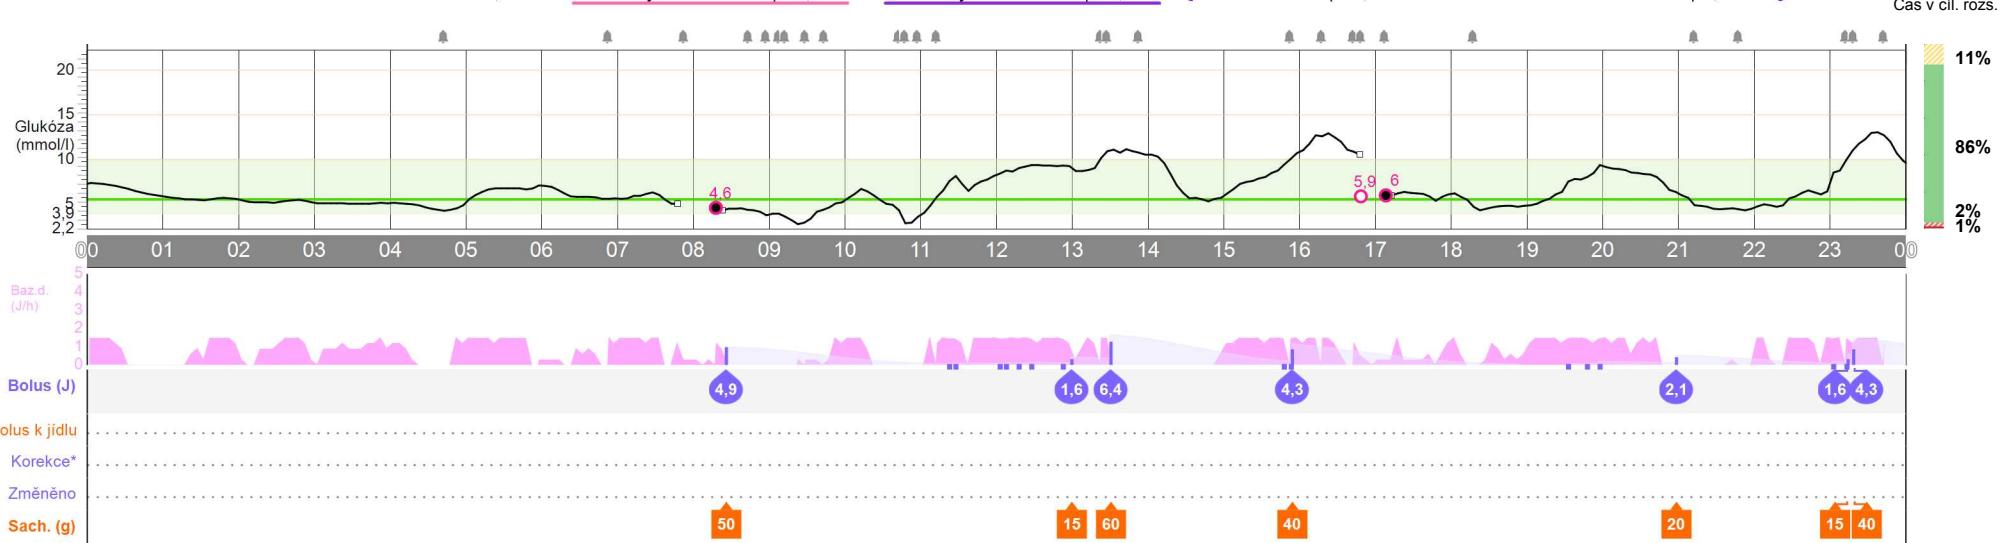

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat.

korekce + Aktivní inzulin

Bolus

+ Aktivní inzulin

Cíl

+ dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Čtvrtek 31.08

Celk. denní dávka 73,9 J


Celkový bazál 20 % | 14,7 J

Celkový bolus 80 % | 59,2 J

{ Bolus 99% | 58,5 J }

+ Automat. korekce 1% | 0,7 J }

Čas v cíl. rozs.

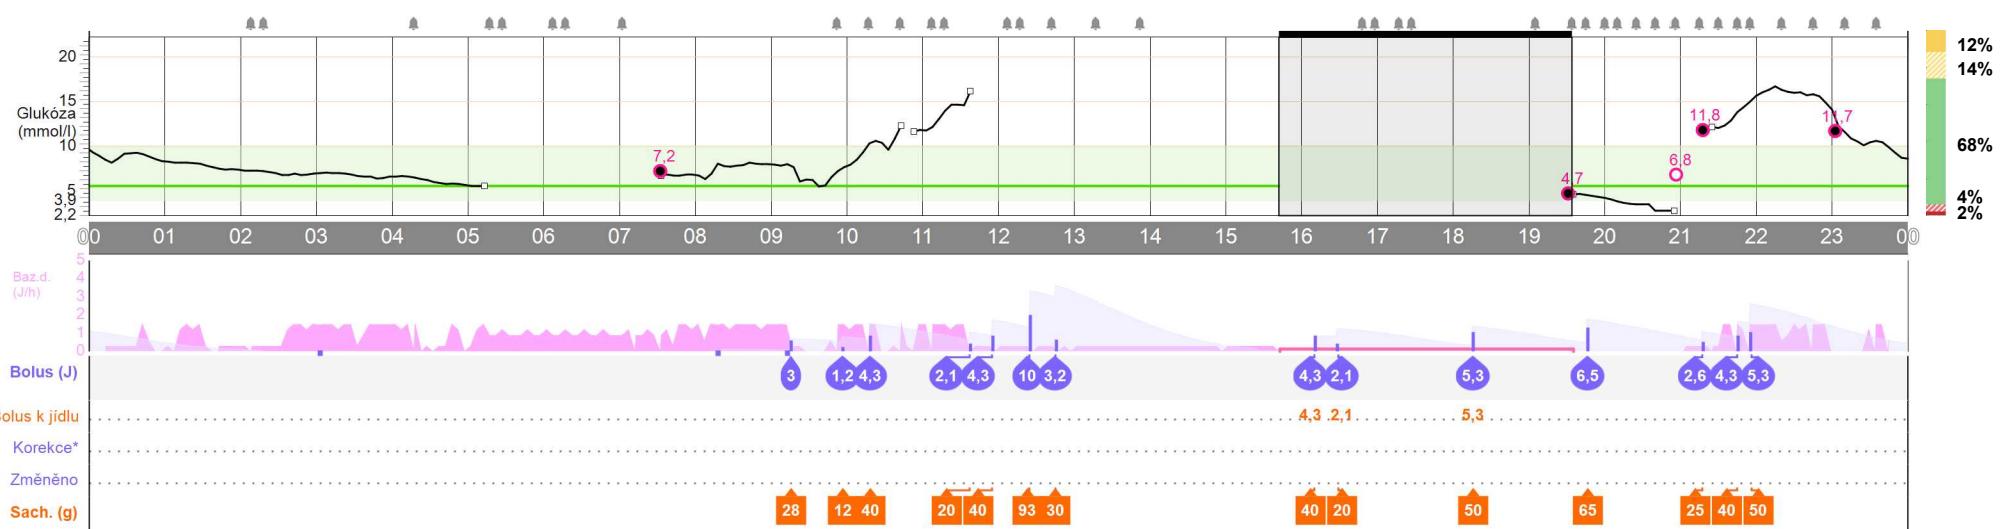

Pátek 01.09

Celk. denní dávka 53,8 J

Celkový bazál 38 % | 20,7 J

Celkový bolus 62 % | 33,1 J

{ Bolus 91% | 30,1 J }

+ Automat. korekce 9% | 3,0 J }

Čas v cíl. rozs.



\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Sobota 02.09

Celk. denní dávka 78,4 J


Celkový bazál 23 % | 17,8 J

Celkový bolus 77 % | 60,6 J

{ Bolus 98% | 59,3 J }

+ Automat. korekce 2% | 1,3 J }

Čas v cíl. rozs.

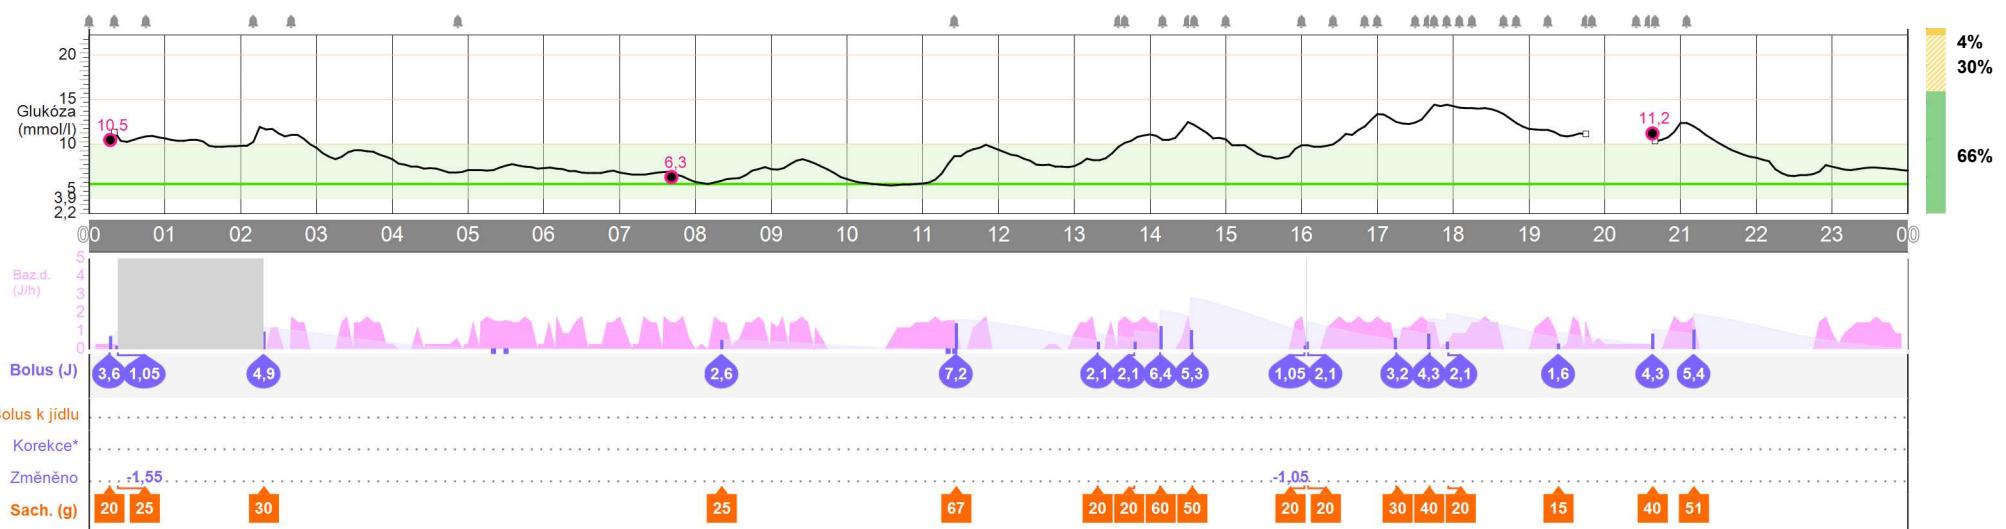

## Neděle 03.09

Celk. denní dávka 63,5 J


Celkový bazál 38 % | 23,9 J

Celkový bolus 62 % | 39,6 J

{ Bolus 98% | 39,0 J }

+ Automat. korekce 2% | 0,6 J }

Čas v cíl. rozs.

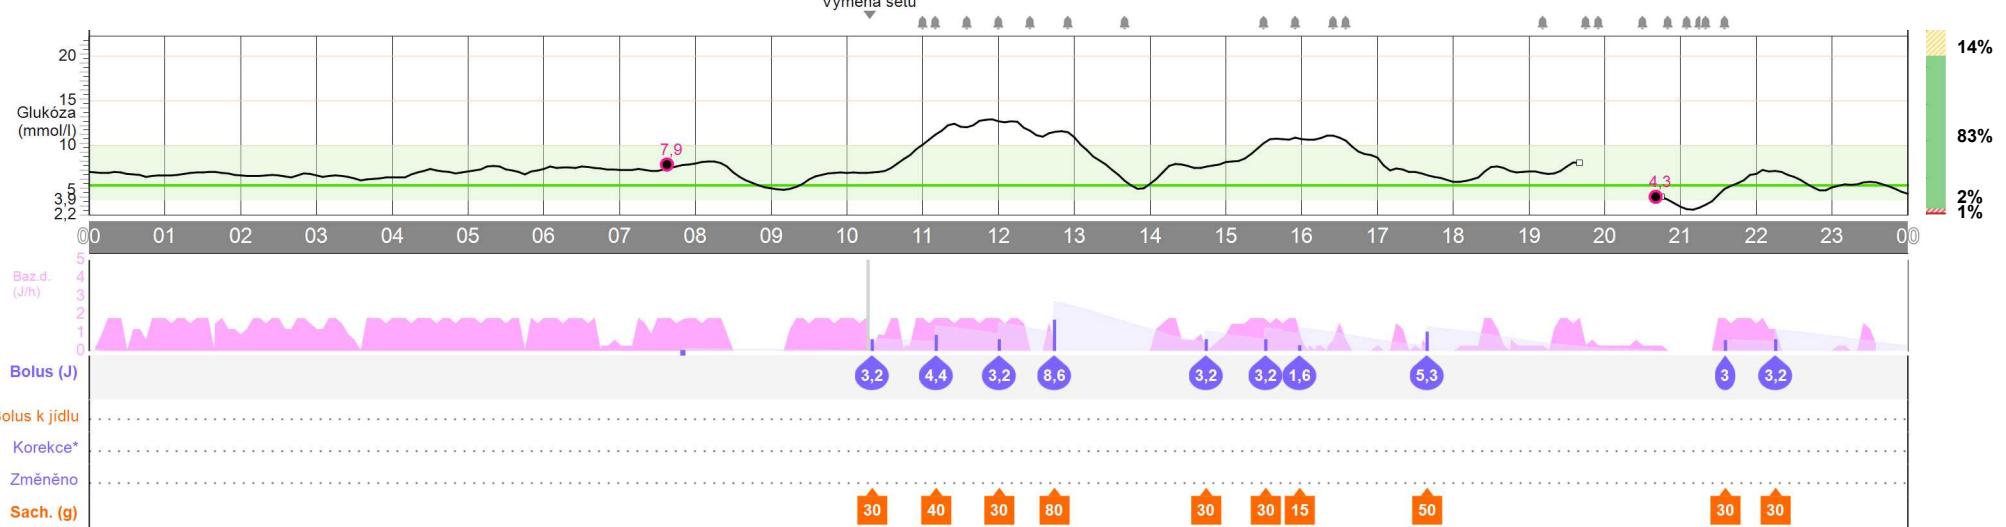


\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS



## Pondělí 04.09

Celk. denní dávka 52,5 J


Celkový bazál 26 % | 13,5 J

Celkový bolus 74 % | 39,0 J

{ Bolus 95% | 36,9 J

+ Automat. korekce 5% | 2,1 J }

Čas v cíl. rozs.

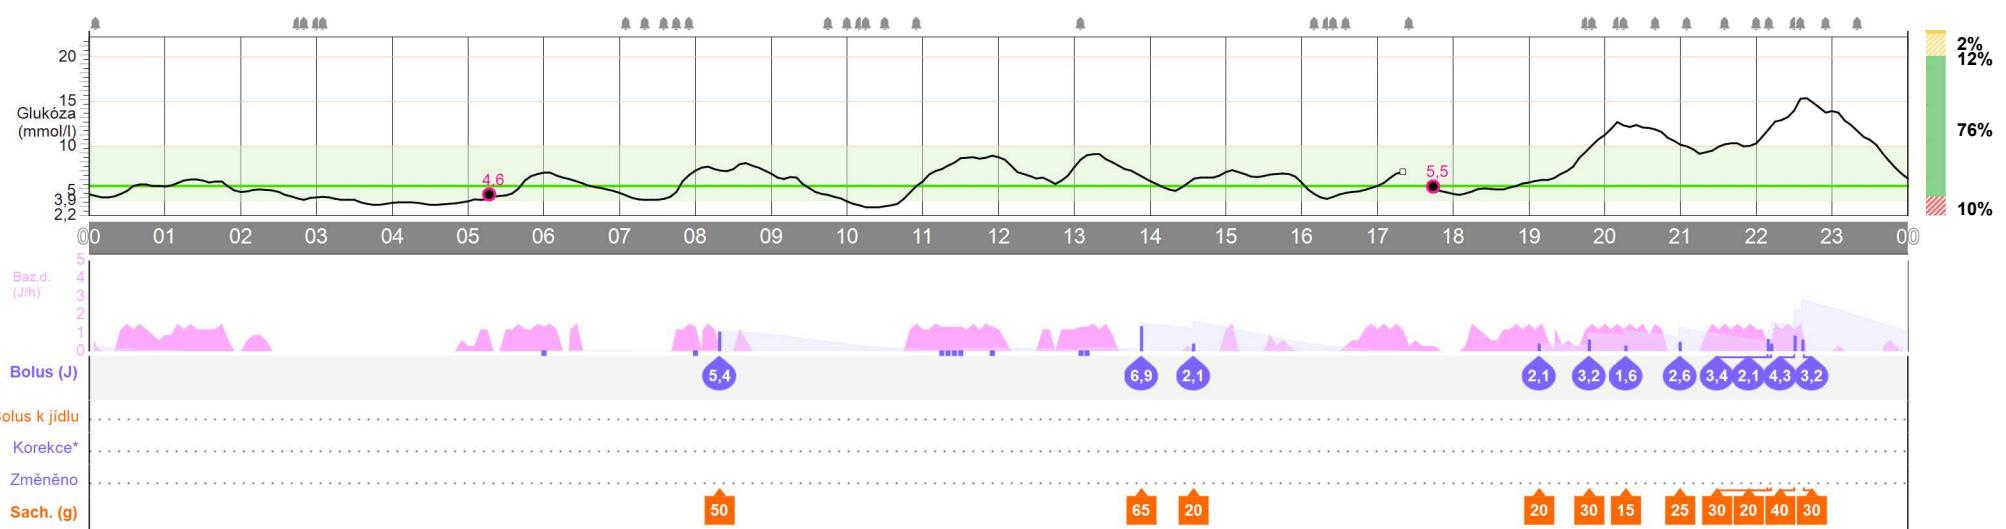

## Úterý 05.09

Celk. denní dávka -- J


Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | 18,2 J

{ Bolus --% | 13,8 J

+ Automat. korekce --% | 4,4 J }

Čas v cíl. rozs.

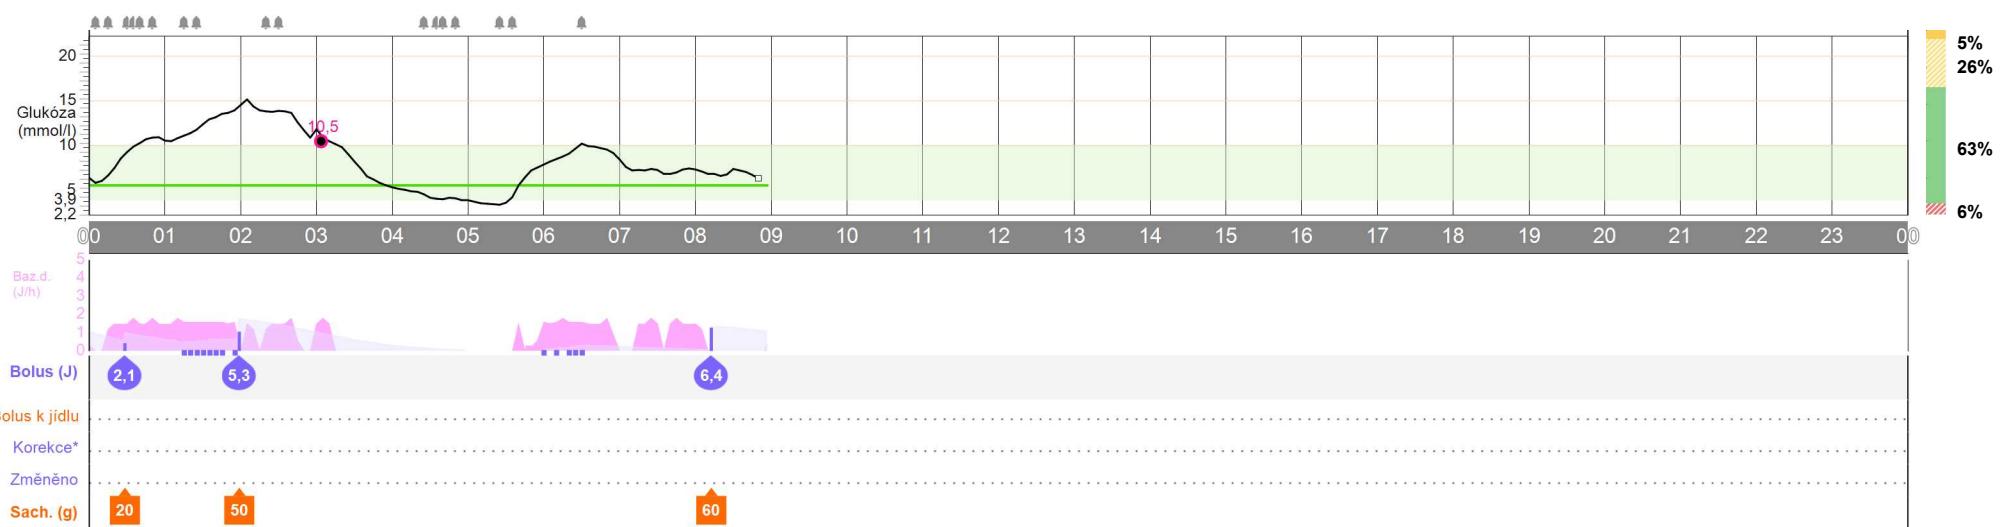

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim  
Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2