



### Podrobnosti o důvodu ukončení

#### 1 - Žádné hodnoty GS

Hodnoty GS nebyly k dispozici (např. Ztracen signál senzoru, Vyměnit senzor, Zkontrolujte spojení, Vybitý vysílač, Žádný signál senzoru, Chyba kalibrace GS 2, atd.)

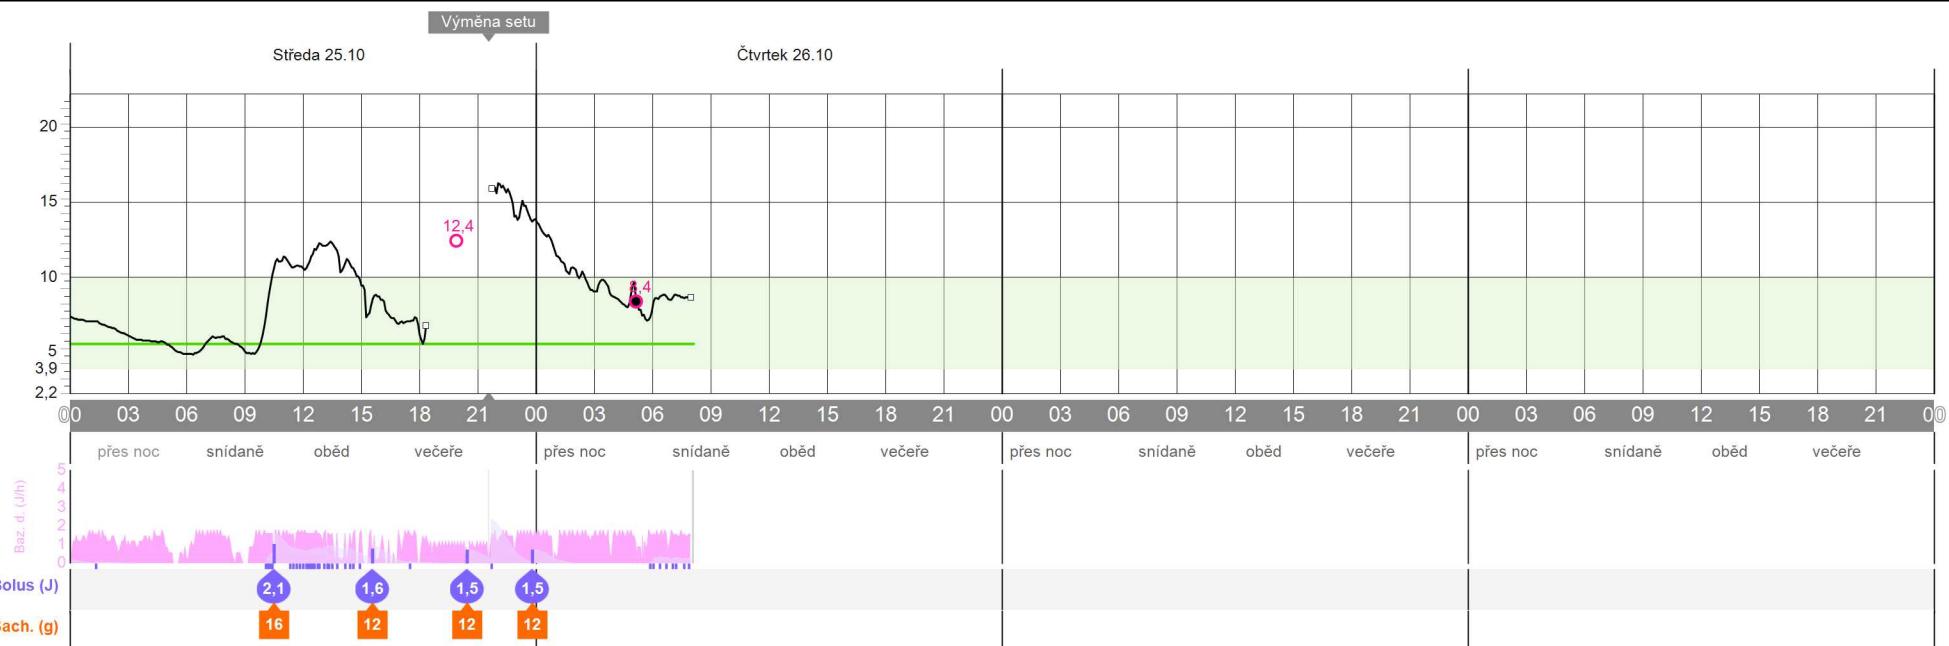

### Podrobnosti o důvodu ukončení

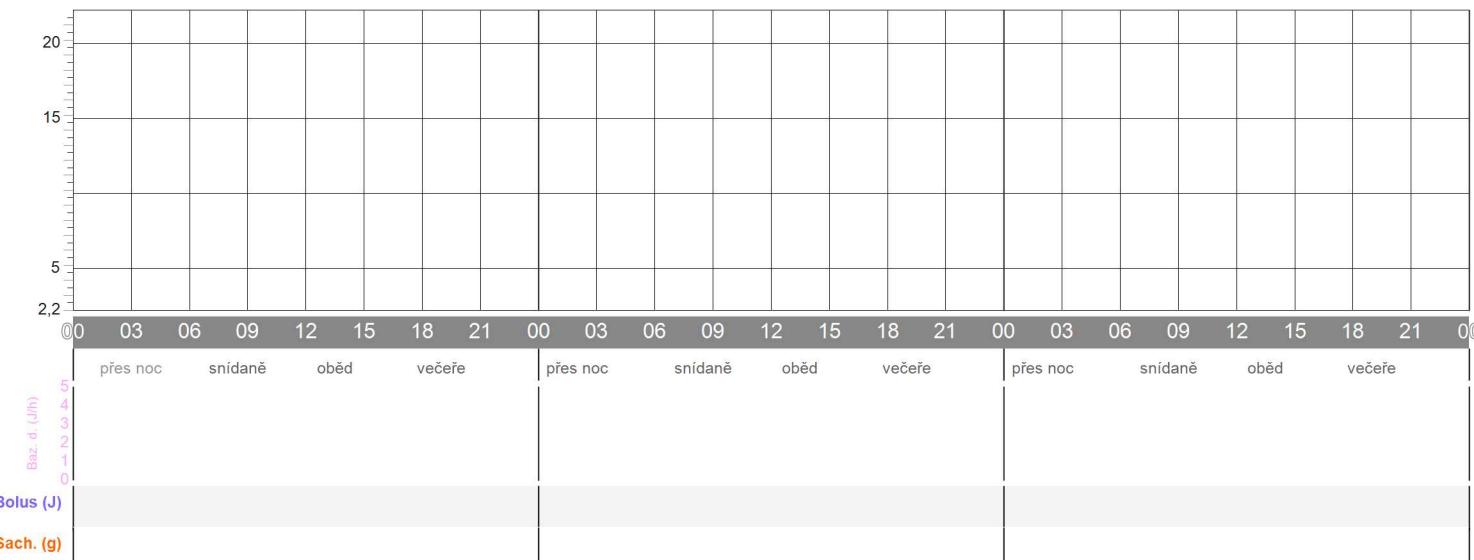

○

Glykémie

● Kalibrace



Autom.

bazál




Zastavit

při níz. GS



Zastavit

před níz. GS



Automat.

korekce

+

Aktivní

inzulin




Bolus

+

aktivní

inzulin



Ruční

režim




Cíl

+

dočasný

cíl




Ruční

zastavení

Změna

času


## Všechny bolusy k jídlu

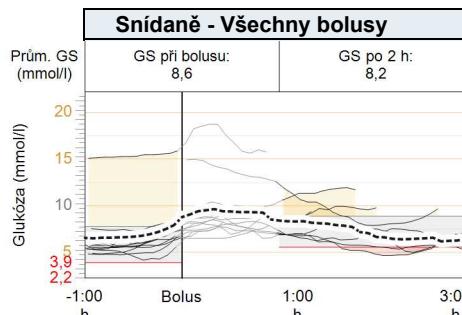

Statist.	
Čas	06:00 - 10:00
Počet bolusů	16
Sachar. poměr (g/J)	7,7
Prům. sacharidy (g)	11 ± 4
Prům. bolus (J)	1,4 ± 0,5

## Snídaně - Analyzovaná jídla


Poznámky	

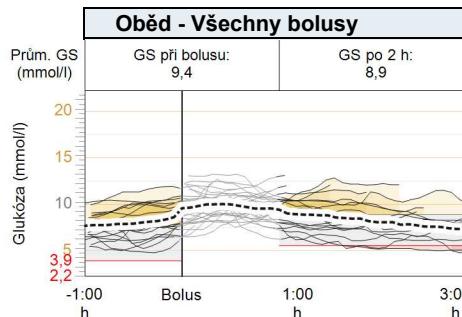

Statist.	
Čas	11:00 - 15:00
Počet bolusů	36
Sachar. poměr (g/J)	7,7
Prům. sacharidy (g)	12 ± 4
Prům. bolus (J)	1,5 ± 0,5

## Oběd - Analyzovaná jídla


Poznámky	

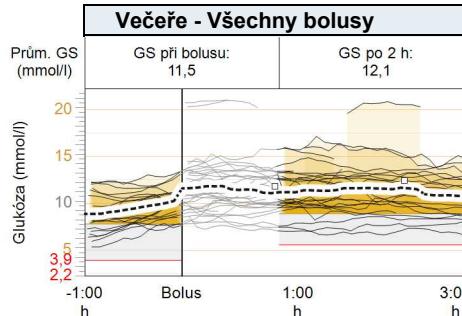

Statist.	
Čas	16:00 - 22:00
Počet bolusů	42
Sachar. poměr (g/J)	7,7
Prům. sacharidy (g)	11 ± 5
Prům. bolus (J)	1,4 ± 0,6

## Večeře - Analyzovaná jídla

Poznámky	

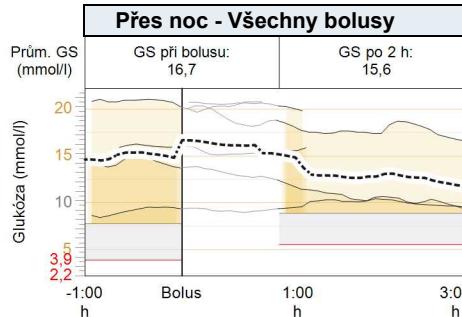

Statist.	
Čas	22:00 - 06:00
Počet bolusů	6
Sachar. poměr (g/J)	7,7
Prům. sacharidy (g)	11 ± 2
Prům. bolus (J)	1,3 ± 0,3


## Přes noc - Analyzovaná jídla

Poznámky	

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Středa 27.09.2023	2	19:55	47	4	4	2							
Čtvrtok 28.09.2023	2	23:20	49	3	3			1	1	0,5	1	7,7	0:02 
Pátek 29.09.2023	1	24:00	56	8	8	2							
Sobota 30.09.2023		24:00	65	4	4	2		1	1	0,5	1	10,1	0:02 
Neděle 01.10.2023		24:00	56	1	1								0:01 
Pondělí 02.10.2023		24:00	51										
Úterý 03.10.2023		24:00	6	4	4	3		1	1	0,5	1	8,2	0:02 
Středa 04.10.2023	3	20:10	17	1	1								
Čtvrtok 05.10.2023		24:00	53	1	1								
Pátek 06.10.2023		24:00	31	2	2	1		1	1	0,5	1	9,9	0:03 
Sobota 07.10.2023		24:00	24	6	6	1							
Neděle 08.10.2023	2	24:00	31	7	7	1							
Pondělí 09.10.2023	1	24:00	33	1	1			1	1	0,5	1	9,1	0:02 
Úterý 10.10.2023	1	24:00	19	4	4	1							
Shrnutí	0,9/den	13d 15h 25m	38,4/den	3,3/den	100,0%	28,3%	0%	5	5	0,5J /naplnění	5	9,0J /naplnění	12m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Středa 11.10.2023	1	20:35	41	3	2	2							
Čtvrtok 12.10.2023		24:00	39	4	4	1		1	1	0,5	1	10,2	0:03 
Pátek 13.10.2023		24:00	33	3	3		1						0:01 
Sobota 14.10.2023		24:00	41	4	4	3							
Neděle 15.10.2023		24:00	27	4	4		1	2	2	1	2	20,7	0:05 
Pondělí 16.10.2023	1	24:00	38	6	6	4							
Úterý 17.10.2023		24:00	41	6	6	3							
Středa 18.10.2023	5	19:15	23	8	7	3		1	1	0,5	1	9,8	0:03 
Čtvrtok 19.10.2023	3	24:00	47	11	11	2		1	1	0,5	1	9,2	0:03 
Pátek 20.10.2023	1	24:00	76	2	2								
Sobota 21.10.2023		24:00	59	3	3	2		1	1	0,5	1	9,3	0:03 
Neděle 22.10.2023	1	24:00	40	6	6	4							
Pondělí 23.10.2023	1	24:00	42	8	8	3							
Úterý 24.10.2023	1	24:00	58	7	7			1	1	0,5	1	10,3	0:02 
Shrnutí	1,0/den	13d 15h 50m	43,2/den	5,4/den	97,3%	36,0%	2,7%	7	7	0,5J /naplnění	7	9,9J /naplnění	20m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Středa 25.10.2023	1	20:40	30	4	4	2		1	1	0,5	1	9,3	0:02 
● Čtvrttek 26.10.2023	1	8:00	8										0:00 
Shrnutí	1,0/den	1d 04h 40m	19,0/den	2,0/den	100,0%	50,0%	0%	1	1	0,5J /naplnění	1	9,3J /naplnění	2m

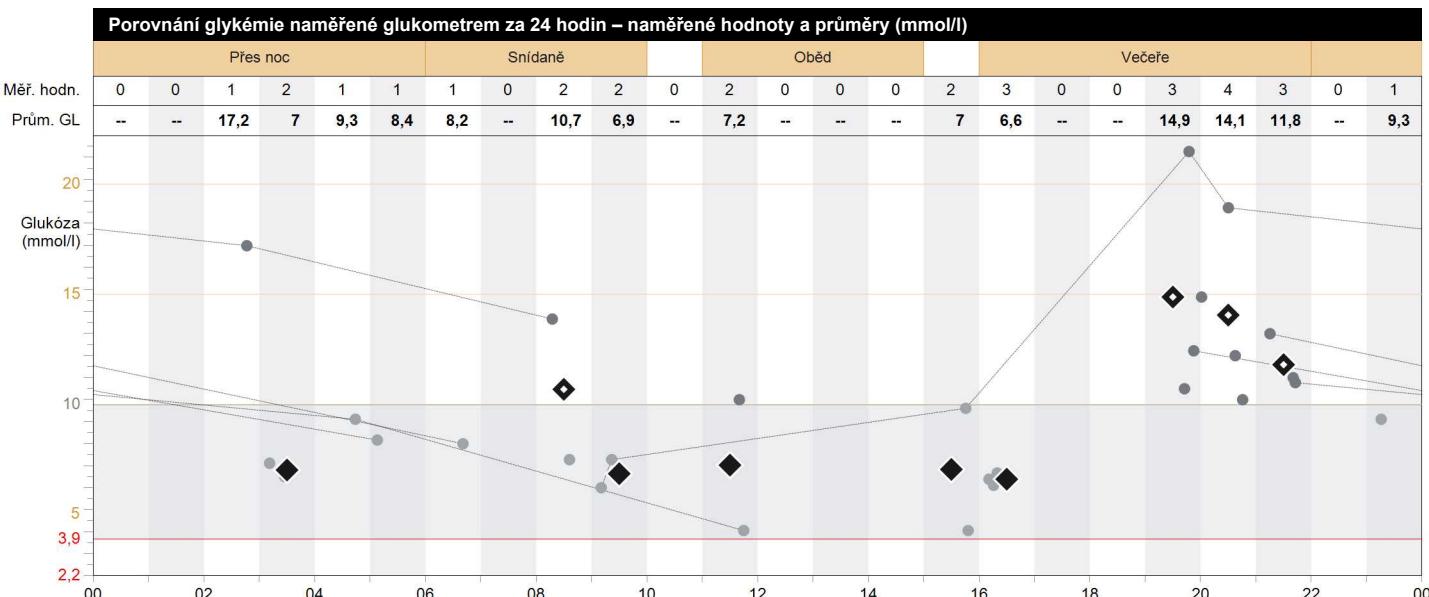

	Přes noc						Snídaně				Oběd				Večeře						Přes noc		Celk. denní dávky			
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Sředa 27.09.2023										10					10		20					11,2				Průměr (2): 11,1mmol/l Sacharidy: 62g Inzulin: 55,0J Bolus: 45%
Čtvrtek 28.09.2023					9,3						20		4,3			2,58	1,78	2,50								Průměr (2): 6,8mmol/l Sacharidy: 28g Inzulin: 49,1J Bolus: 41%
Pátek 29.09.2023			6,7								2,50			0,146	1,03	1,48	1,91	3,72	1,98						Průměr (1): 6,7mmol/l Sacharidy: 104g Inzulin: 72,2J Bolus: 50%	
Sobota 30.09.2023												27	8	31		13	16	9							Průměr (0): -- Sacharidy: 60g Inzulin: 69,7J Bolus: 43%	
Neděle 01.10.2023											3,40	1,00	0,479	1,44	4,64	0,679	2,90	4,06	3,96	2,40	1,64	3,50	2,78	1,02	1,76	Průměr (0): -- Sacharidy: 8g Inzulin: 54,7J Bolus: 35%
Pondělí 02.10.2023													15			21	12	12							Průměr (0): -- Sacharidy: -- Inzulin: 48,0J Bolus: 31%	
Úterý 03.10.2023													0,128	2,10		3,36	2,18	1,31	3,79	2,27	2,37	1,94	2,27	0,728	1,13	Průměr (0): -- Sacharidy: 52g Inzulin: 41,1J Bolus: 18%
Sředa 04.10.2023															8		2,68	0,677	1,25						Průměr (3): 6,6mmol/l Sacharidy: 31g Inzulin: 42,2J Bolus: 28%	
Čtvrtek 05.10.2023																									Průměr (0): -- Sacharidy: 12g Inzulin: 48,8J Bolus: 38%	
Pátek 06.10.2023																1,24	0,137								Průměr (0): -- Sacharidy: 15g Inzulin: 43,5J Bolus: 21%	
Sobota 07.10.2023																									Průměr (0): -- Sacharidy: 75g Inzulin: 46,6J Bolus: 32%	
Neděle 08.10.2023					7,3																				Průměr (2): 5,8mmol/l Sacharidy: 73g Inzulin: 51,2J Bolus: 31%	
Pondělí 09.10.2023																									Průměr (1): 10,2mmol/l Sacharidy: 11g Inzulin: 45,3J Bolus: 22%	
Úterý 10.10.2023																									Průměr (1): 9,3mmol/l Sacharidy: 55g Inzulin: 43,8J Bolus: 26%	

&gt; 10,0mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

Zastavení

Částečný den

Změna času

&lt; 3,9mmol/l

Ruční bolus nebo bolus s korekcí

Zastavit pomocí senzoru

Přetočení pumpy

Vynechaný jídlo

	Přes noc						Snídaně				Oběd				Večeře						Přes noc		Celk. denní dávky			
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Sředa 11.10.2023											11				12						14,9				Průměr (1): 14,9mmol/l Sacharidy: 23g Inzulin: 51,3J Bolus: 38%	
Čtvrtek 12.10.2023	↔	0,540	0,540		0,240						21	1,50	0,140	0,240	1,34	0,959	1,74					5,66	1,90	1,22	1,52	Průměr (0): -- Sacharidy: 45g Inzulin: 54,3J Bolus: 34%
Pátek 13.10.2023	↔	0,843									16	2,00	0,343		23	2,49	0,587	1,67	0,930	0,974	0,387	0,387	0,730	0,674	1,02	Průměr (0): -- Sacharidy: 39g Inzulin: 47,7J Bolus: 27%
Sobota 14.10.2023											11	8			13										Průměr (0): -- Sacharidy: 43g Inzulin: 45,6J Bolus: 38%	
Neděle 15.10.2023	↔	0,682	0,482	0,421	0,161						1,86	1,00	0,882	2,18	2,02	0,521		0,161	1,24	2,12	1,02	1,70	0,361	0,361	Průměr (0): -- Sacharidy: 36g Inzulin: 39,7J Bolus: 24%	
Pondělí 16.10.2023											7,5	15			14										Průměr (1): 7,5mmol/l Sacharidy: 63g Inzulin: 43,2J Bolus: 36%	
Úterý 17.10.2023		0,165	0,165	0,165							8	12	11	11	11	11	11	12							Průměr (0): -- Sacharidy: 55g Inzulin: 44,5J Bolus: 39%	
Sředa 18.10.2023	↔				0,321	0,321	0,321	0,160	1,82		6,2		1,22	1,40	0,821	0,260	2,62	1,76	9,8	21,5	18,9	1,80	1,50	1,00	Průměr (5): 12,8mmol/l Sacharidy: 79g Inzulin: 52,7J Bolus: 50%	
Čtvrtek 19.10.2023	↔	1,50			17,2						12	8	12					13	8	8	11	13,2			Průměr (3): 14,8mmol/l Sacharidy: 122g Inzulin: 59,0J Bolus: 46%	
Pátek 20.10.2023	↔	0,815	1,16	0,687	0,915	0,587	0,515	0,515	0,172	2,44	2,72	1,99	1,84		0,572	0,515	0,344	0,859	2,79	2,16	2,27	2,22	0,915	1,59	Průměr (1): 8,2mmol/l Sacharidy: 16g Inzulin: 47,9J Bolus: 35%	
Sobota 21.10.2023	↔	0,514	0,171	0,171	0,071						0,957	0,999	2,01	0,714	0,271	1,24	1,30	1,23	1,36	2,14	2,11	0,885	0,743	0,614	Průměr (0): -- Sacharidy: 36g Inzulin: 47,7J Bolus: 37%	
Neděle 22.10.2023		0,314									19	12	10,2		0,414	2,84	1,77	1,19	0,443	0,271	10	18	1,40	0,371	1,54	Průměr (1): 10,2mmol/l Sacharidy: 59g Inzulin: 45,8J Bolus: 39%
Pondělí 23.10.2023											24	3,00	0,843	3,14	1,50	1,31	2,51				10,7				Průměr (1): 10,7mmol/l Sacharidy: 93g Inzulin: 52,3J Bolus: 43%	
Úterý 24.10.2023	↔	0,755	0,627	0,227							20	12	5	11	11	8	8	8	1,03	1,82	1,84	2,25	1,84	0,664	Průměr (1): 12,2mmol/l Sacharidy: 64g Inzulin: 52,6J Bolus: 45%	

&gt; 10,0mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

Zastavení

Částečný den

Změna času


&lt; 3,9mmol/l

Ruční bolus nebo bolus s korekcí

Zastavit pomocí senzoru

Přetočení pumpy

Vynechaný jídlo

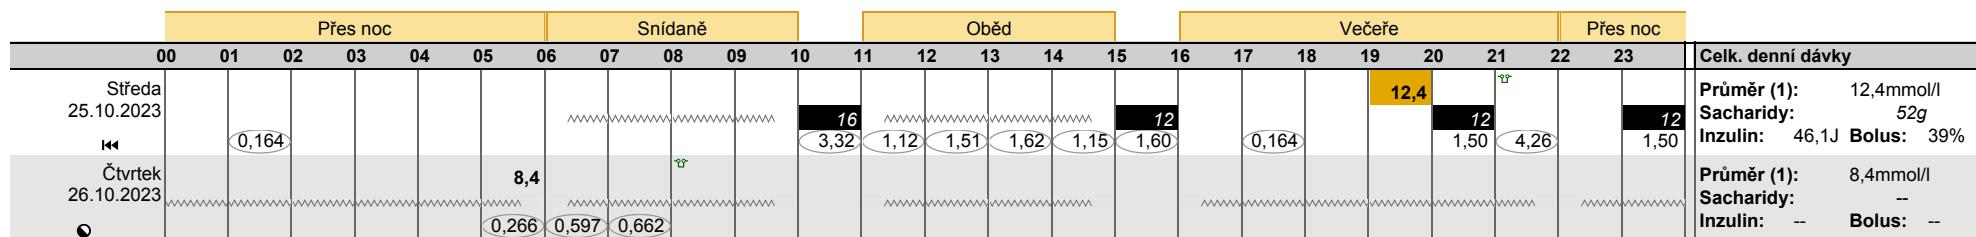

■ &gt; 10,0mmol/l

■ &lt; 3,9mmol/l

00\* Více naměř. hodnot (zobrazeny nejextrémnější)

○ Ruční bolus nebo bolus s korekcí

↑ Zastavení

✖ Zastavit pomocí senzoru

● Částečný den

!&lt; Přetočení pumpy

⌚ Změna času

~~~~~ Vynechané jídlo

Bazál

|                                |            |  |                |
|--------------------------------|------------|--|----------------|
| <b>Maximální bazální dávka</b> | 4,00 J/hod |  | <b>Aktual.</b> |
|--------------------------------|------------|--|----------------|

## Bazál 1 (aktivní)

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| 24 hod celkem | 35,800 J |  |
|---------------|----------|--|

## Bazál 2

24 hod celkem --

Bazál 3

**24 hod celkem** -- 

## Bolus

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Bolus Wizard</b>                       | Zap.      |
| <b>Jednotky</b>                           | g, mmol/l |
| <b>Doba aktivního inzulinu<br/>(h:mm)</b> | 2:00      |
| <b>Maximální bolus</b>                    | 10,0 J    |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Snadný bolus</b>     | Vyp        |
| <b>Přírůstek bolusu</b> | 0,1 J      |
| <b>Rychlosť bolusu</b>  | Standardná |
| <b>Komb./Rozl.</b>      | Vyp/Vyp    |

**Sacharidový por  
(g/J)**

**Sacharidový poměr (g/J) Citl. na inzulin (mmol/l na J)**

**Cílová glykémie  
(mmol/l)**

**Cílová glykémie  
(mmol/l)**

Přednastav. bolus

| Název   | Normální | Rozložený |  | Aktuální |
|---------|----------|-----------|--|----------|
| Bolus 1 |          |           |  |          |
| Snídaně |          |           |  |          |
| Večeře  |          |           |  |          |
| Oběd    |          |           |  |          |
| Svačina |          |           |  |          |
| Bolus 2 |          |           |  |          |
| Bolus 3 |          |           |  |          |
| Bolus 4 |          |           |  |          |

Přednast. doč. b

| Název        | Rychl. | Trvání |  | Název       | Rychl. | Trvání |  |
|--------------|--------|--------|--|-------------|--------|--------|--|
| Vys. zátěž   |        |        |  | Doč. baz. 1 |        |        |  |
| Střed. zátěž |        |        |  | Doč. baz. 2 |        |        |  |
| Nízká zátěž  |        |        |  | Doč. baz. 3 |        |        |  |
| Nemoc        |        |        |  | Doč. baz. 4 |        |        |  |

| Připomínky                  |                 |       |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| Varov. při nízk. stavu zás. | Jednotky inzul. |       |
| Množství                    | 20 J            |       |
| Kontrola GL po bolusu       | Vyp             |       |
| Výměna setu                 | Vyp             |       |
| Zmeškaný bolus k jídлу      |                 |       |
| Název                       | Počátek         | Konec |
| Jídlo 1                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 2                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 3                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 4                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 5                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 6                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 7                     | Vyp             | Vyp   |
| Jídlo 8                     | Vyp             | Vyp   |
| Osobní připomínky           |                 |       |
| Název                       | Čas             |       |
| Připominka 1                | Vyp             |       |
| Připominka 2                | Vyp             |       |
| Připominka 3                | Vyp             |       |
| Připominka 4                | Vyp             |       |
| Připominka 5                | Vyp             |       |
| Připominka 6                | Vyp             |       |
| Změřte GL                   | Vyp             |       |
| Léky                        | Vyp             |       |
| Příslušenství               |                 |       |
| Režim blokování             | Vyp             |       |
| Formát času                 | 24 hod          |       |
| Jas                         | Autom.          |       |
| Doba podsvícení             | 60 s            |       |
| Možnosti zvuku              | Zvuk            |       |
| Hlasitost alarmu            | 3               |       |
| Automat. zastavení          | Vyp             |       |

Pátek 13.10

Celk. denní dávka 47,7 J

Celkový bazál 73 % | 34,7 J

Celkový bolus 27 % | 13,0 J

{

Bolus 30% | 3,9 J

+

Automat. korekce 70% | 9,1 J

}

Čas v cíl. rozs.



Sobota 14.10

Celk. denní dávka 45,6 J

Celkový bazál 62 % | 28,4 J

Celkový bolus 38 % | 17,2 J

{


Bolus 33% | 5,7 J

+

Automat. korekce 67% | 11,5 J

}

Čas v cíl. rozs.

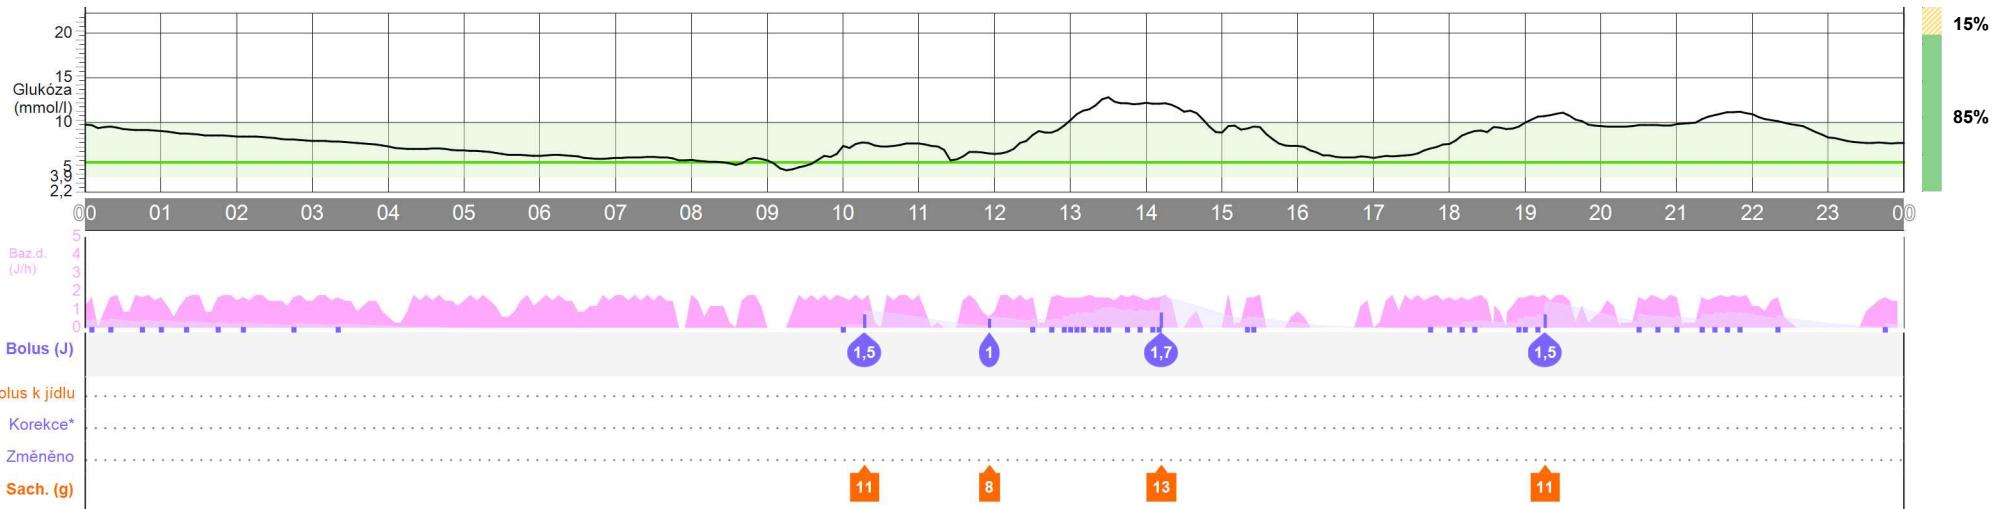

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Neděle 15.10

Celk. denní dávka 39,7 J

Celkový bazál 76 % | 30,0 J

Celkový bolus 24 % | 9,7 J

{ Bolus 39% | 3,8 J

+ Automat. korekce 61% | 5,9 J

Wykonane sety

Čas v cíl. rozs.



## Pondělí 16.10

Celk. denní dávka 43,2 J

Celkový bazál 64 % | 27,8 J


Celkový bolus 36 % | 15,4 J

{ Bolus 55% | 8,5 J

+ Automat. korekce 45% | 6,9 J

Wykonane sety

Čas v cíl. rozs.

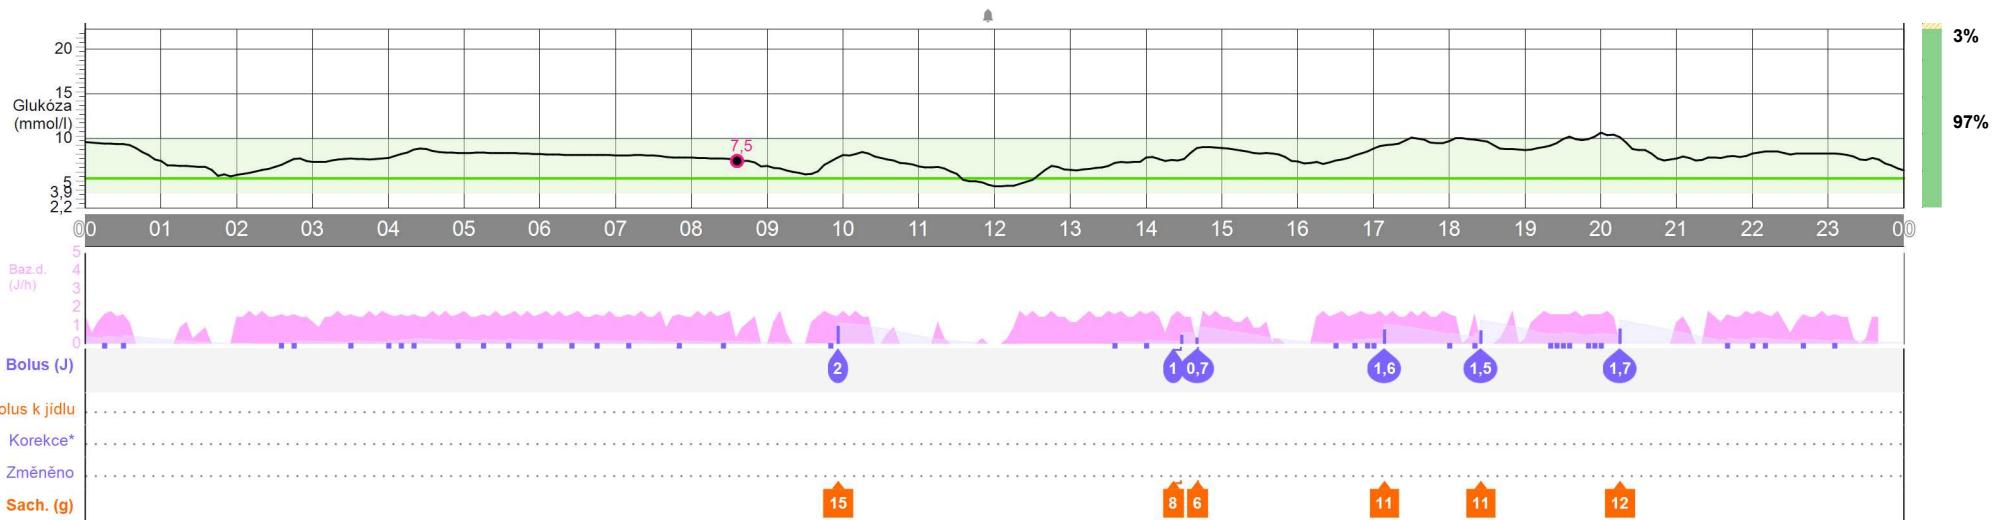

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat.

korekce + Aktivní inzulin

Bolus

+ Aktivní inzulin

Cíl

+ dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Úterý 17.10

Celk. denní dávka 44,5 J

Celkový bazál 61 % | 27,2 J

Celkový bolus 39 % | 17,3 J

{ Bolus 42% | 7,3 J

+ Automat. korekce 58% | 10,0 J }

Čas v cíl. rozs.



Středa 18.10

Celk. denní dávka 52,7 J

Celkový bazál 50 % | 26,2 J


Celkový bolus 50 % | 26,5 J

{ Bolus 56% | 14,9 J

+ Automat. korekce 44% | 11,6 J }

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.

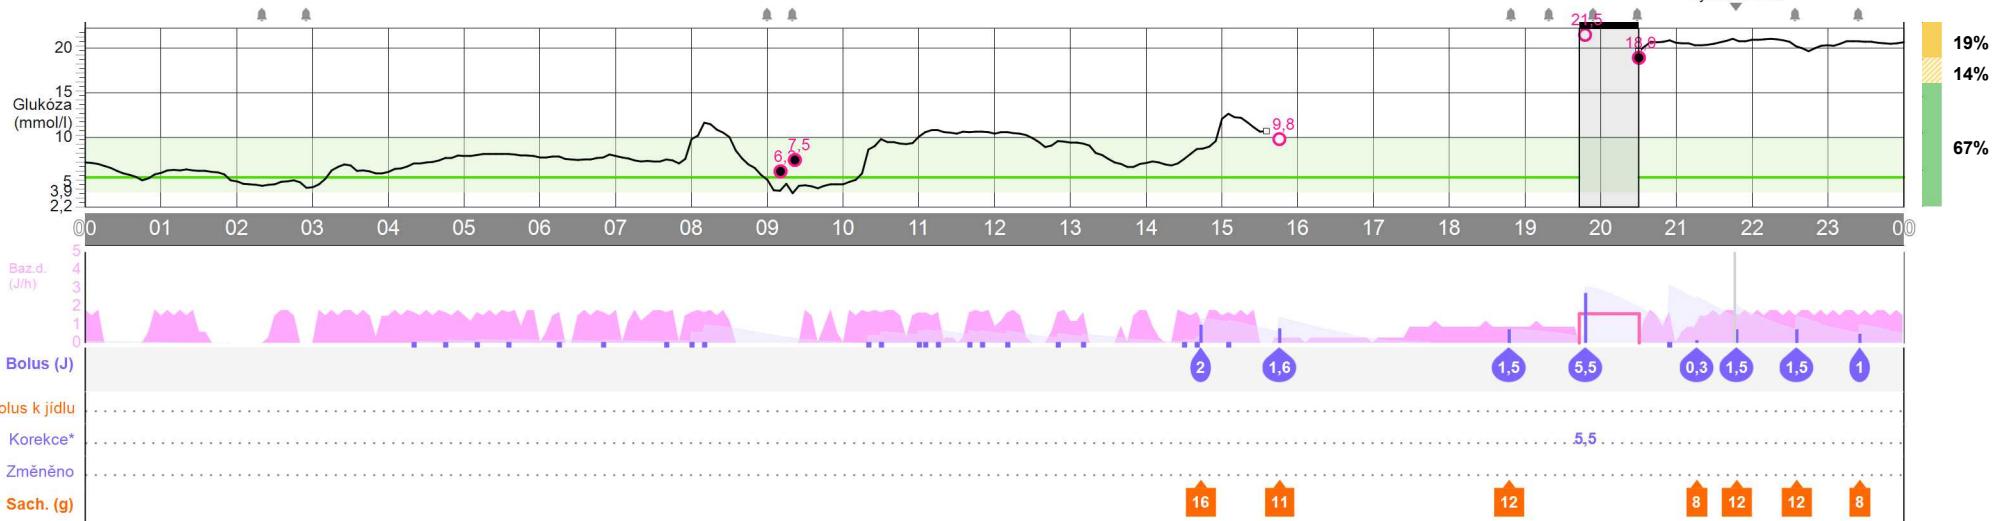

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Čtvrtek 19.10

Celk. denní dávka 59,0 J

Celkový bazál 54 % | 31,9 J


Výměna setu

Celkový bolus 46 % | 27,1 J

Bolus 58% | 15,7 J

Automat. korekce 42% | 11,4 J

Čas v cíl. rozs.

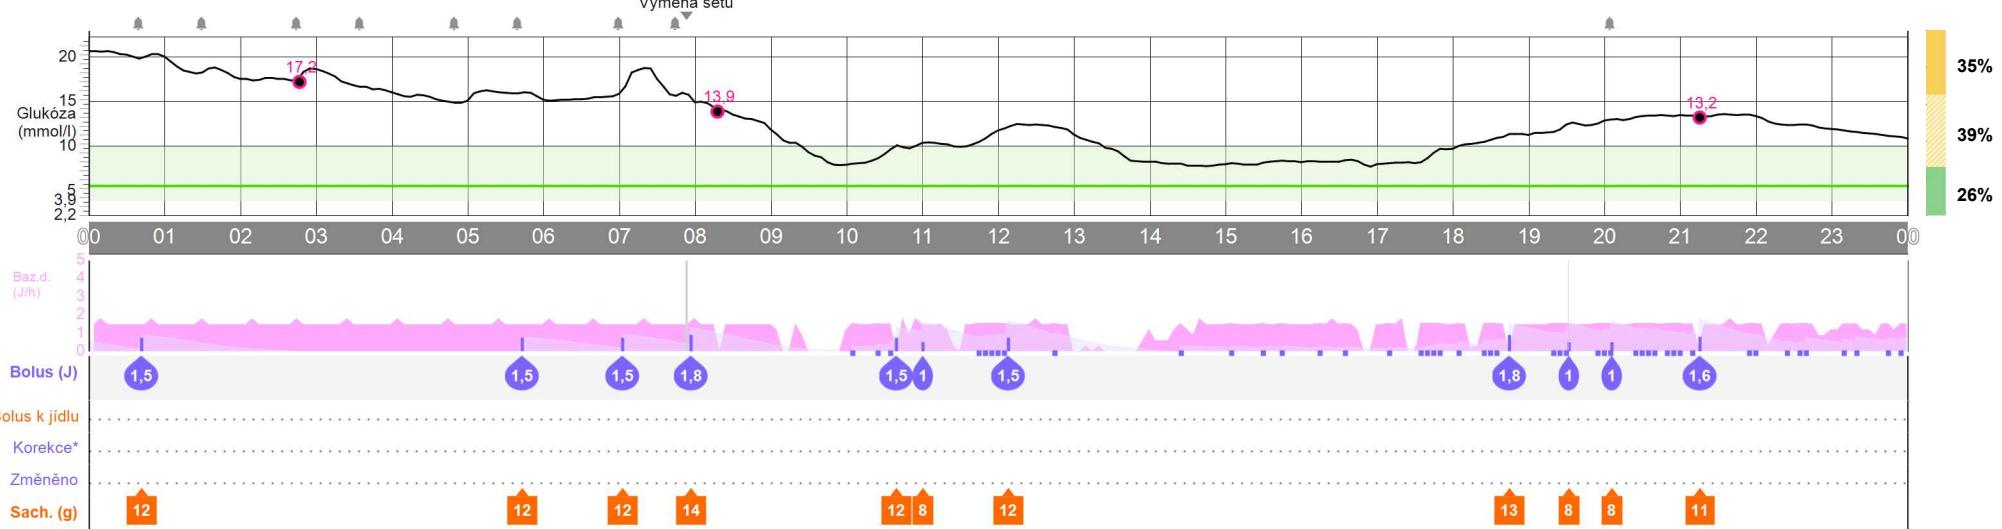

## Pátek 20.10

Celk. denní dávka 47,9 J

Celkový bazál 65 % | 31,2 J

Celkový bolus 35 % | 16,7 J

Bolus 12% | 2,0 J

Automat. korekce 88% | 14,7 J

Čas v cíl. rozs.



\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Sobota 21.10

Celk. denní dávka 47,7 J

Celkový bazál 63 % | 30,2 J


Celkový bolus 37 % | 17,5 J

Bolus 27% | 4,7 J

Automat. korekce 73% | 12,8 J

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.

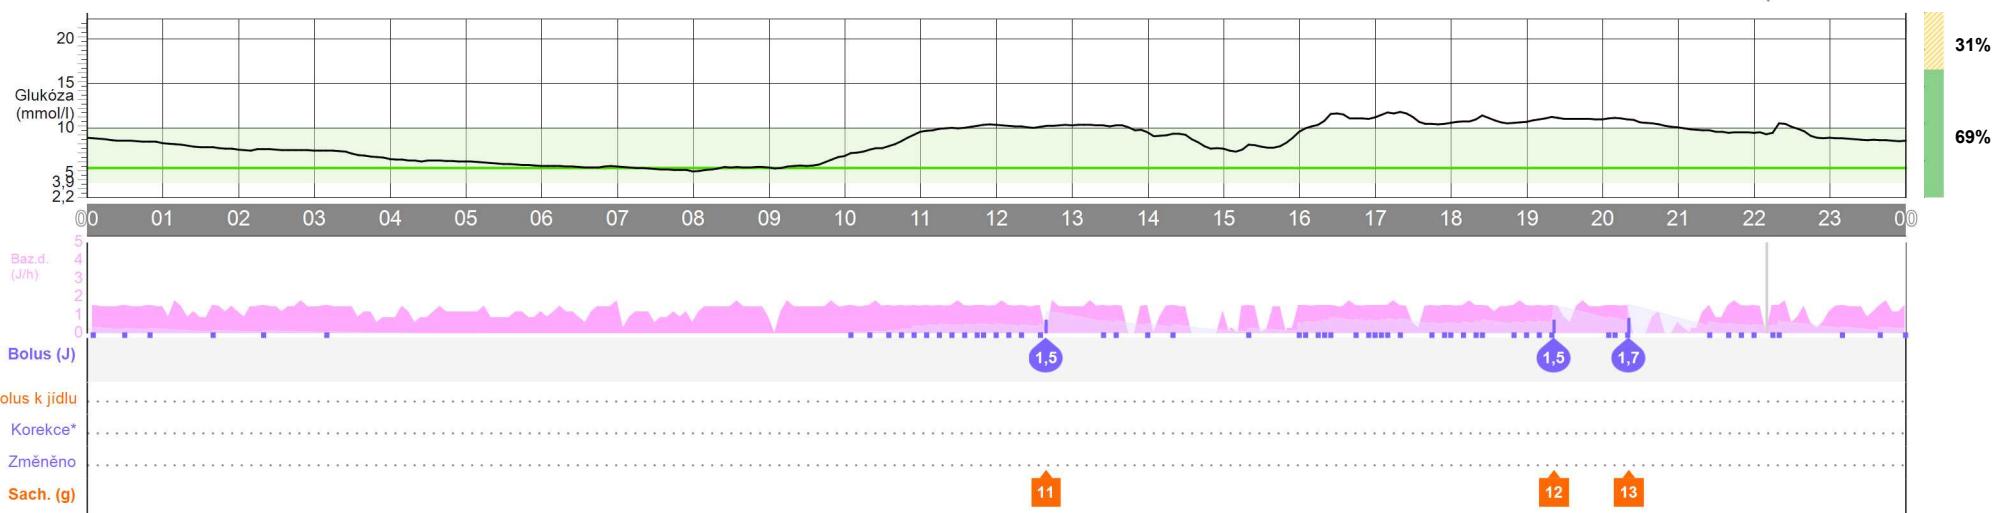

## Neděle 22.10

Celk. denní dávka 45,8 J

Celkový bazál 61 % | 27,9 J


Celkový bolus 39 % | 17,9 J

Bolus 44% | 7,8 J

Automat. korekce 56% | 10,1 J

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.

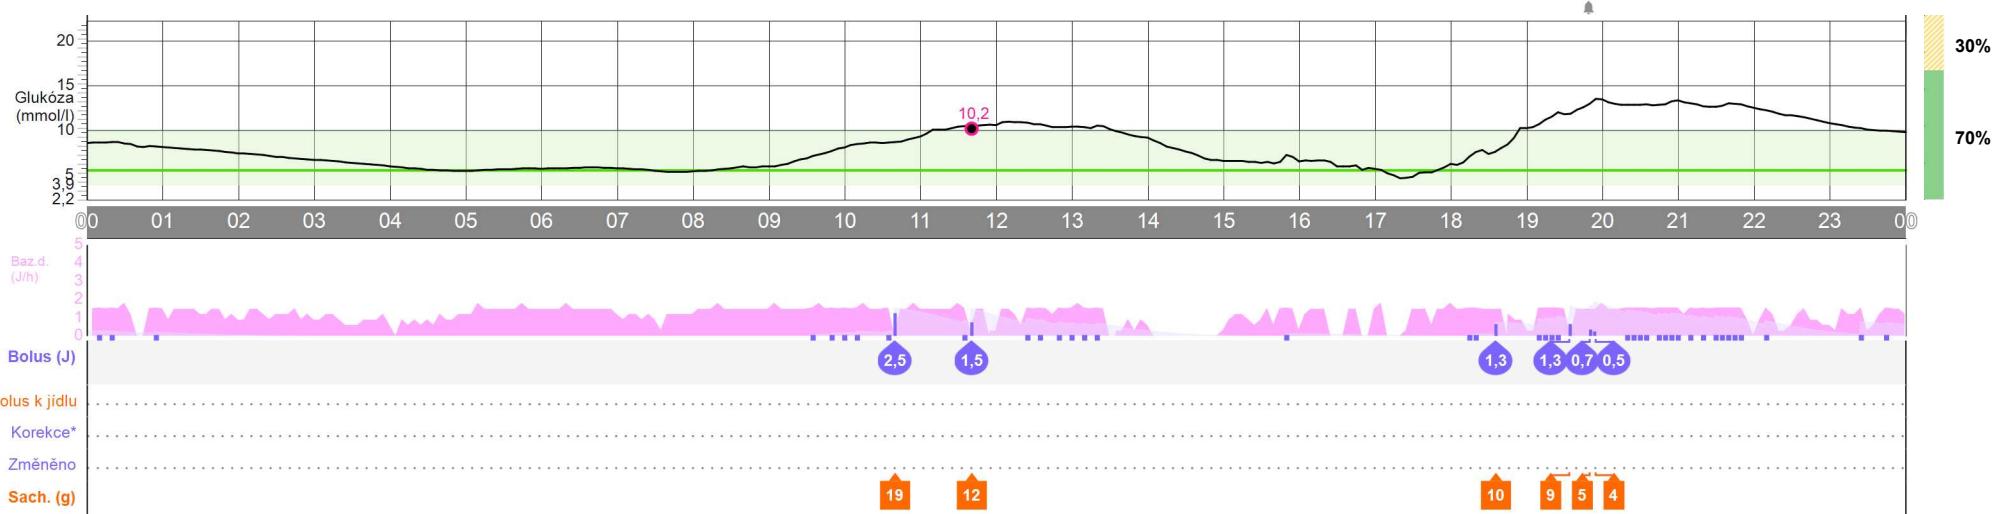

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat.

korekce + Aktivní inzulin

Bolus

+ Aktivní inzulin

Cíl

+ dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Pondělí 23.10

Celk. denní dávka 52,3 J

Celkový bazál 57 % | 29,6 J

Celkový bolus 43 % | 22,7 J

{ Bolus 54% | 12,3 J

+ Automat. korekce 46% | 10,4 J }

Čas v cíl. rozs.



Úterý 24.10

Celk. denní dávka 52,6 J

Celkový bazál 55 % | 29,1 J

Celkový bolus 45 % | 23,5 J

{ Bolus 34% | 8,0 J

+ Automat. korekce 66% | 15,5 J }

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.



\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Středa 25.10

Celk. denní dávka 46,1 J

Celkový bazál 61 % | 28,2 J

Celkový bolus 39 % | 17,9 J


{ Bolus 37% | 6,7 J

+ Automat. korekce 63% | 11,2 J

}

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.

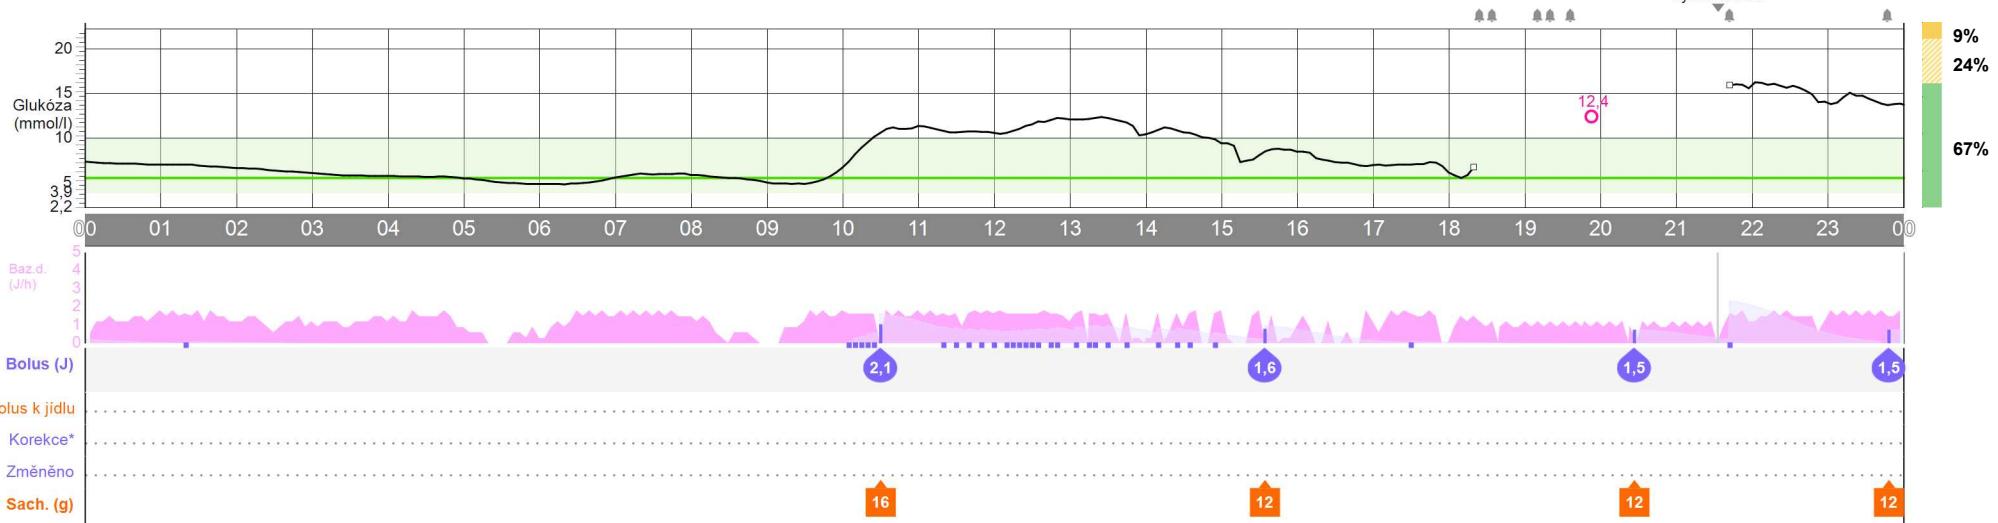

## Čtvrtek 26.10

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J


Celkový bolus -- % | 1,5 J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | 1,5 J

}

Čas v cíl. rozs.

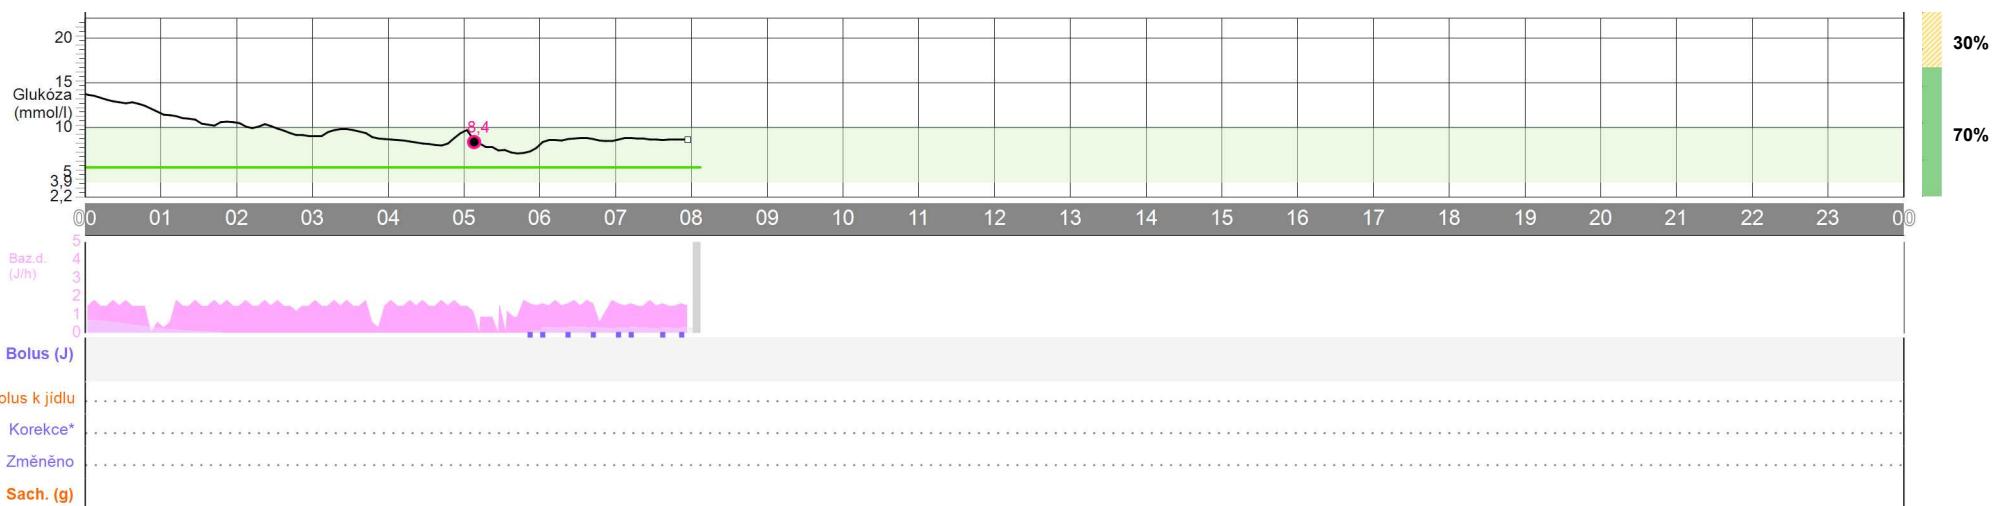

\*S ohledem na aktivnín inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivnín inzulin

Bolus + Aktivnín inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2