



Medtronic


A 19.09.2023 - 18.10.2023 (30 Dny) 20.08.2023 - 18.09.2023 (30 Dnv)

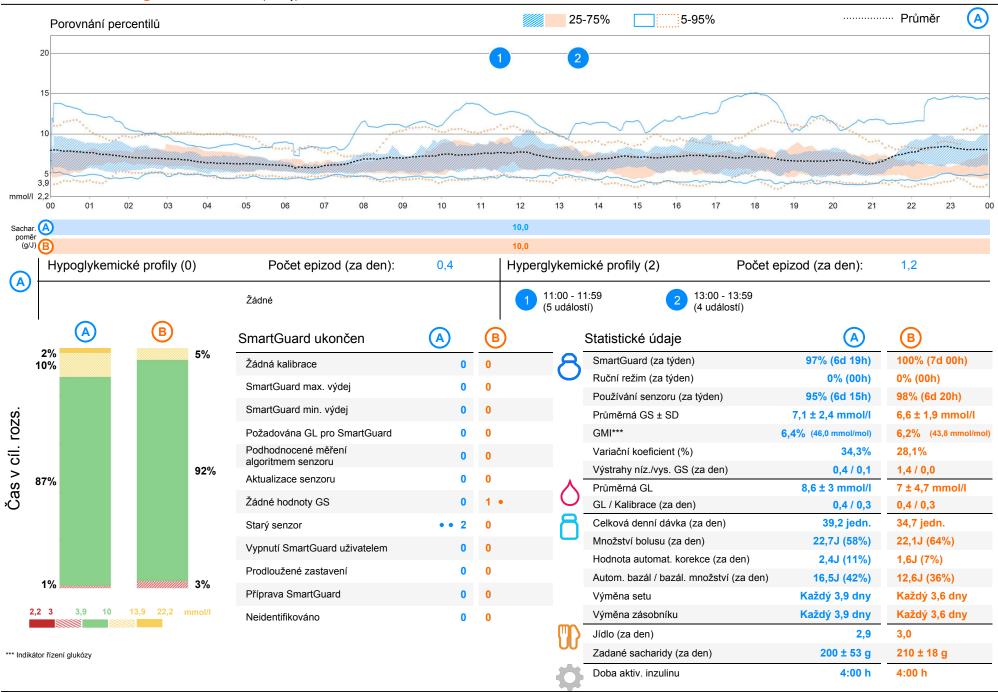


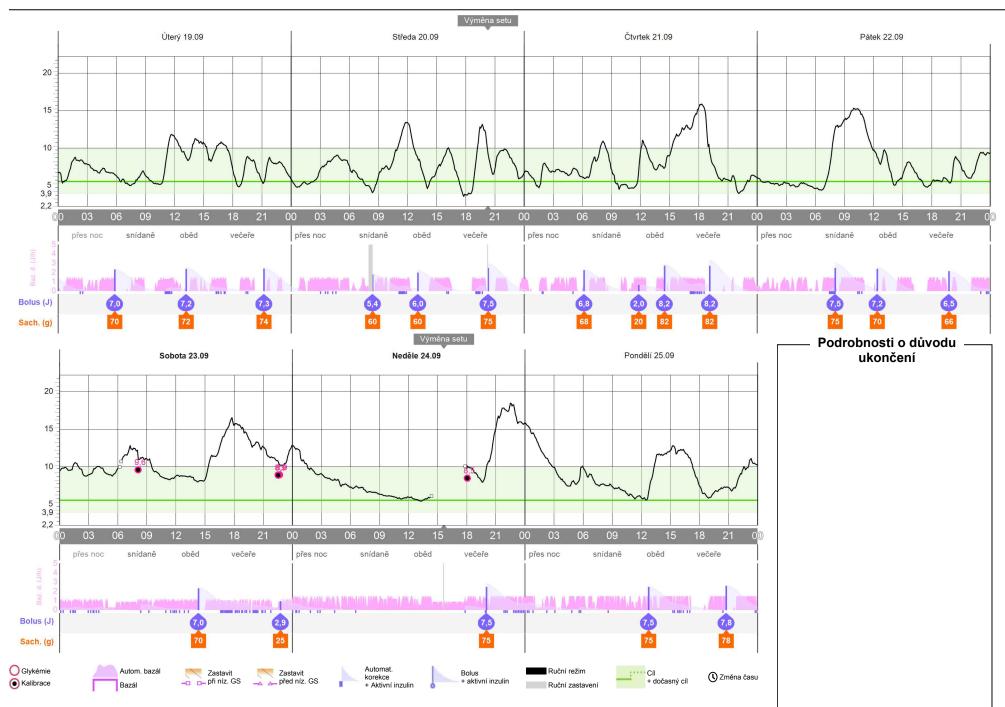


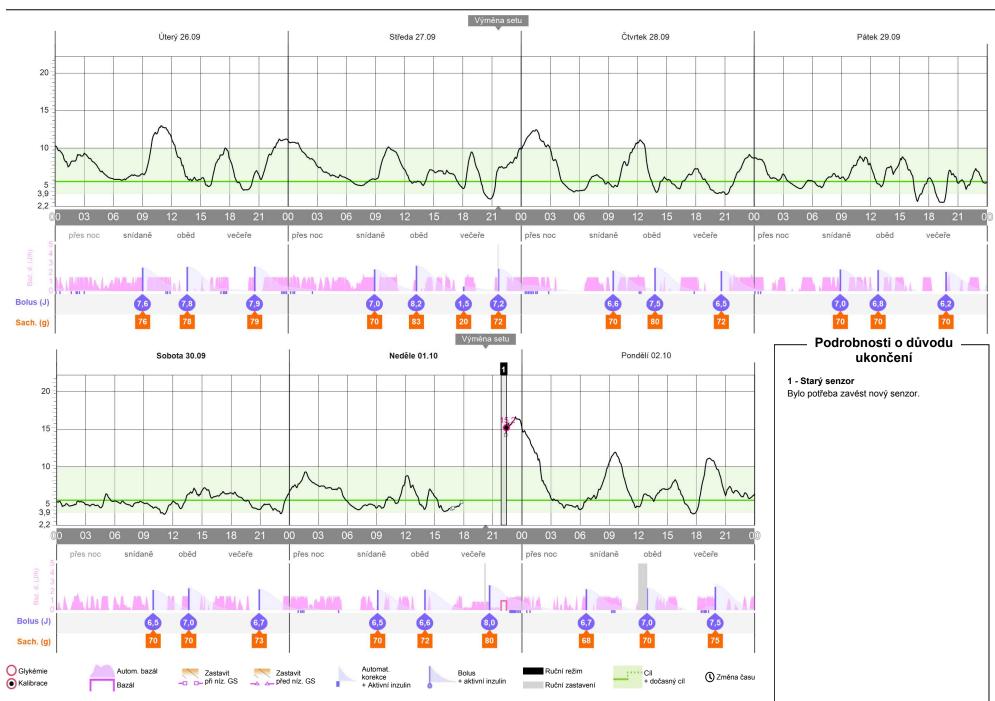

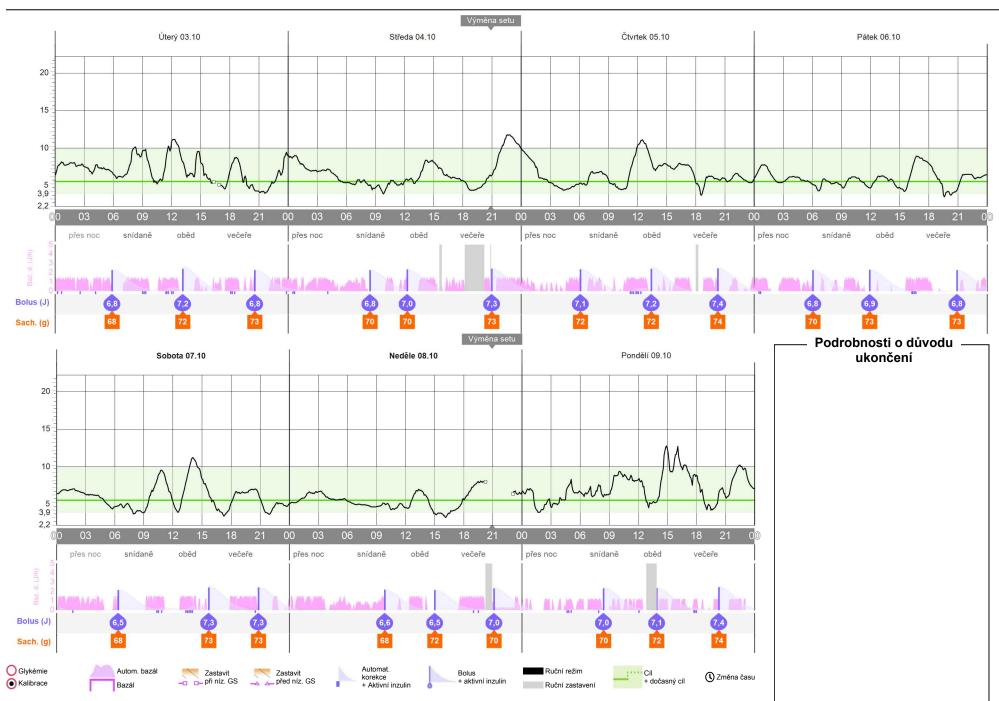

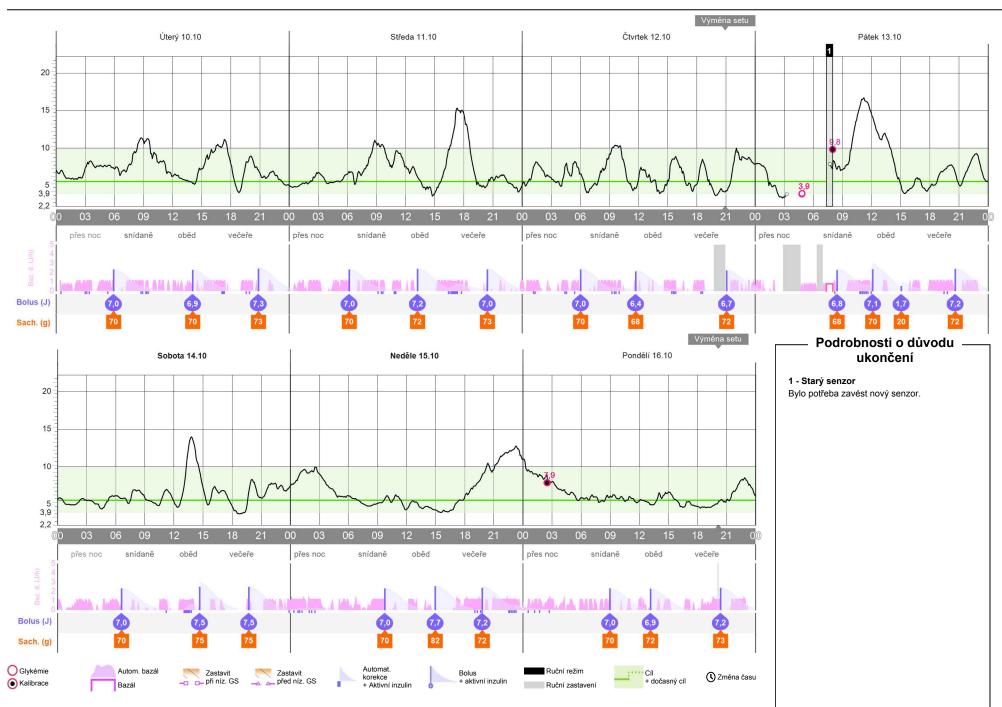

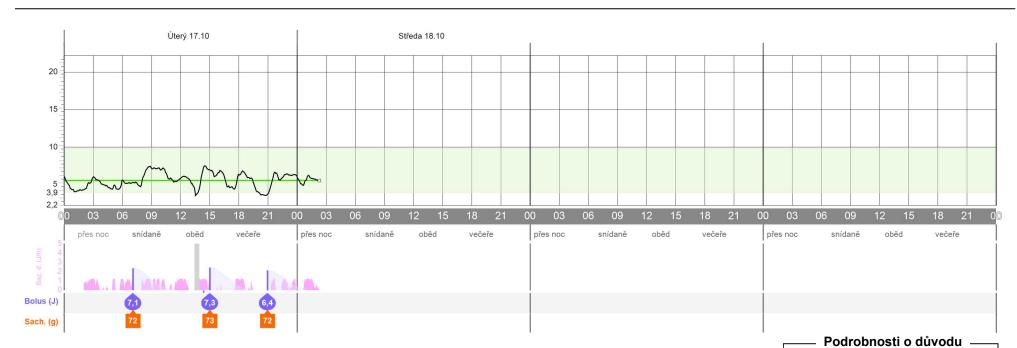

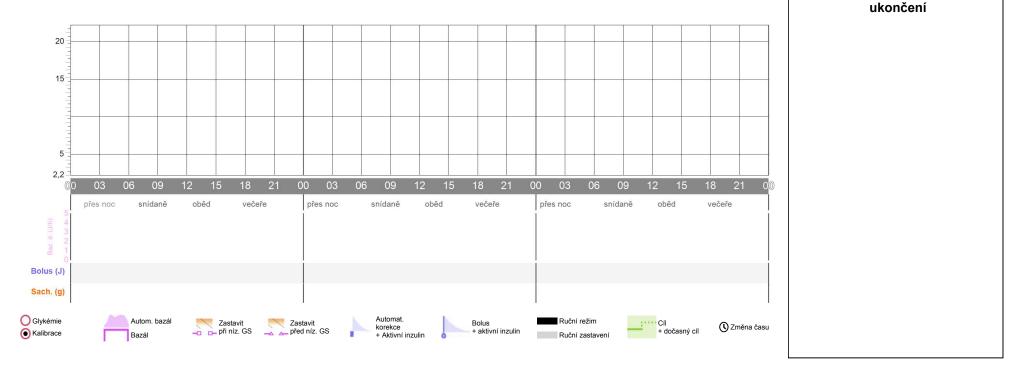

Generováno: 18.10.2023, 17:23

Zdroje dat: MiniMed 780G, MMT-1885 (NG3089088H)

Medtronic

Dodržování léčby (1 z 3) 19.09.2023 - 02.10.2023

	Měření glykémie Události bolu			u				Události plnění	í				
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	Trvání zastavení (h:mm)
Úterý 19.09.2023		24:00	18	3	3	1							
Středa 20.09.2023		24:00	23	3	3	1		1	1	0,3	1	8,1	បៈ31
Čtvrtek 21.09.2023		24:00	15	4	4								
Pátek 22.09.2023		24:00	15	3	3	2							
Sobota 23.09.2023	3	23:55	56	2	2	1							
Neděle 24.09.2023	1	20:40	23	1	1			1	1	0,3	1	9,0	0:06
Pondělí 25.09.2023		24:00	20	2	2								
Úterý 26.09.2023		24:00	19	3	3								
Středa 27.09.2023		24:00	4	4	4	2		1	1	0,3	1	5,1	0:05
Čtvrtek 28.09.2023		24:00	12	3	3	3							
Pátek 29.09.2023		24:00	3	3	3	2							
Sobota 30.09.2023		24:00		3	3	2							
Neděle 01.10.2023	1	19:25	16	3	3	2		1	1	0,3	1	8,2	0:09
Pondělí 02.10.2023		24:00	11	3	3	1							បៈ56
Shrnutí	0,4/den	13d 16h 00m	16,8/den	2,9/den	100,0%	42,5%	0%	4	4	0,3J /naplnění	4	7,6J /naplnění	1h 47m

Medtronic

Dodržování léčby (2 z 3) 03.10.2023 - 16.10.2023

	Měření glykém	ile	Události bolus	diosti bolusu				Události plnění					
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	Trvání zastavení (h:mm)
Úterý 03.10.2023		23:30	16	3	3	1							
Středa 04.10.2023		24:00	3	3	3	1		1	1	0,3	1	8,7	ម 2:22
Čtvrtek 05.10.2023		24:00	7	3	3	1							안 0:17
Pátek 06.10.2023		24:00	6	3	3	3							
Sobota 07.10.2023		24:00	10	3	3	1							
Neděle 08.10.2023		21:15	2	3	3	2		1	1	0,3	1	8,6	안 0:42
Pondělí 09.10.2023		24:00	8	3	3	1							압 1:05
Úterý 10.10.2023		24:00	16	3	3	1							
Středa 11.10.2023		24:00	17	3	3	1							
Čtvrtek 12.10.2023		24:00	15	3	3	2		1	1	0,3	1	8,0	ប 1:12
Pátek 13.10.2023	4	19:35	11	4	4	2							2:26
Sobota 14.10.2023		24:00	11	3	3								
Neděle 15.10.2023		24:00	17	3	3	1							
Pondělí 16.10.2023	2	24:00	4	3	3	2		1	1	0,3	1	8,4	압 0:06
Shrnutí	0,4/den	13d 16h 20m	10,2/den	3,1/den	100,0%	44,2%	0%	4	4	0,3J /naplnění	4	8,4J /naplnění	8h 10m

Medtronic

Generováno: 18.10.2023, 17:23

Strana 9 z 11


Zdroje dat: MiniMed 780G, MMT-1885 (NG3089088H)

	Měření glykém	ie	Události bolus	olosti bolusu			Události plnění						
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	Trvání zastavení (h:mm)
Úter 17.10.202		24:00	1	3	3	2							රු 0:31
Středa 18.10.2023		2:20											
Shrnu	í 0,0/den	1d 02h 20m	0,5/den	1,5/den	100,0%	66,7%	0%	0	0		0		31m

Medtronic 18.10.2023

Nastavení zařízení (1 z 2)

Generováno: 18.10.2023, 17:23 Zdroj dat: MiniMed 780G, MMT-1885 (NG3089088H)

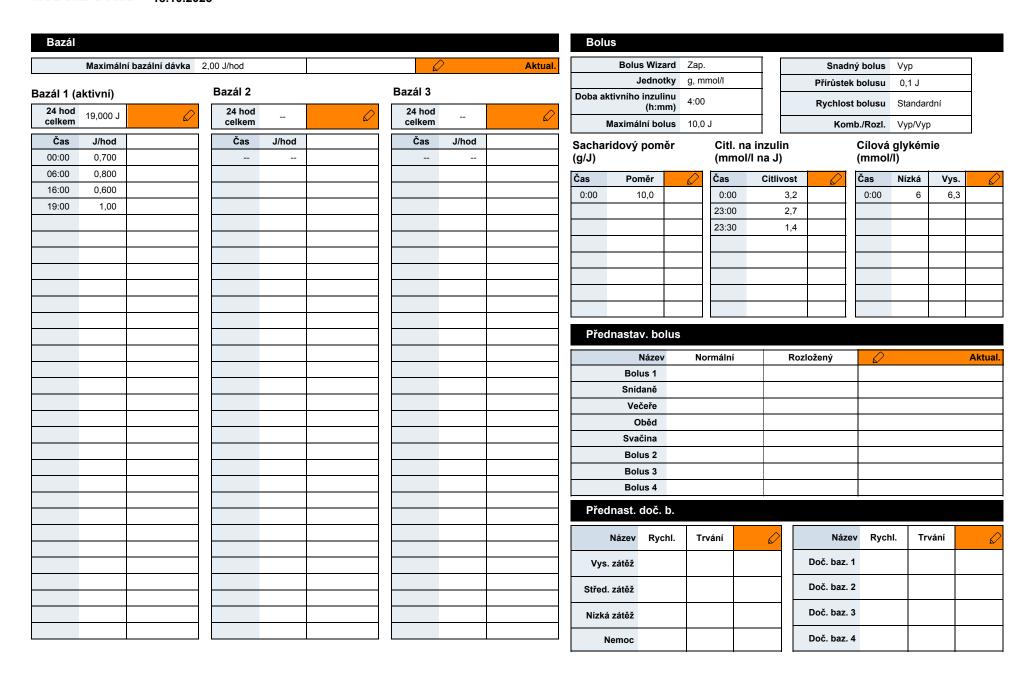

Nastavení zařízení (2 z 2) Medtronic 18.10.2023

Bazál (pokračování)

Generováno: 18.10.2023, 17:23 Strana 11 z 11 Šmída, Jaromír Zdroj dat: MiniMed 780G, MMT-1885 (NG3089088H)

SmartGuard	
SmartGuard	Zap
Cílová hodnota	5,5 mmol/l
Automat. korekce	Zap

Výstr	ahy vys. G	Vyp (Odložení 1:00)			
Počátek v	Vysoká (mmol/l)	Výstraha při vys. GS	Výstrah a před vys. GS	Limit výstr. vzest. (mmol/l)	

Výstr	ahy níz.	GS	Zap (Odložení 0:20)				
Počátek v	Nízká (mmol/l)	Zastav.	Výstr. při níz. GS	Výstr. před níz. GS	Výstr. obnov. bazálu		
0:00	3,4	Před.nízG	Х				

Senzor	
Senzor	Zap
Připomínka kalibrace	Vyp
Čas připomínky kalibrace	Vyp

Připomínka kalibrace	Vyp
Čas připomínky kalibrace	
Poznámky	

	Bazál 4		Bazál 5		Prac. den		Den volna	1	Den nem	oci
	24 hod celkem		24 hod celkem		24 hod celkem		24 hod celkem		24 hod celkem	
	Čas	J/hod								
/I)										
r.										
v. lu										
u										
	•									
T										

1						
Ю		•	m	10	м	7
	ш	ν.			w	ı

Varov. při nízk. stavu zás.	Jednotky inzul.
Množství	20 J
Kontrola GL po bolusu	Vyp
Výměna setu	Vyp

Zmeškaný bolus k jídlu

Název	Počátek	Konec
Jídlo 1	Vyp	Vyp
Jídlo 2	Vyp	Vyp
Jídlo 3	Vyp	Vyp
Jídlo 4	Vyp	Vyp
Jídlo 5	Vyp	Vyp
Jídlo 6	Vyp	Vyp
Jídlo 7	Vyp	Vyp
Jídlo 8	Vyp	Vyp
Jídlo 3 Jídlo 4 Jídlo 5 Jídlo 6 Jídlo 7	Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp	Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp Vyp

Osobní připomínky

Název	Čas
Připomínka 1	Vyp
Připomínka 2	Vyp
Připomínka 3	Vyp
Připomínka 4	Vyp
Připomínka 5	Vyp
Připomínka 6	Vyp
Změřte GL	Vyp
Léky	Vyp

Příslušenství	
Režim blokování	Vyp
Formát času	24 hod
Jas	Autom.
Doba podsvícení	15 s
Možnosti zvuku	Zvuk
Hlasitost alarmu	3
Automat. zastavení	Vyp