


Porovnání percentilů

 25-75% 5-95%


..... Průměr

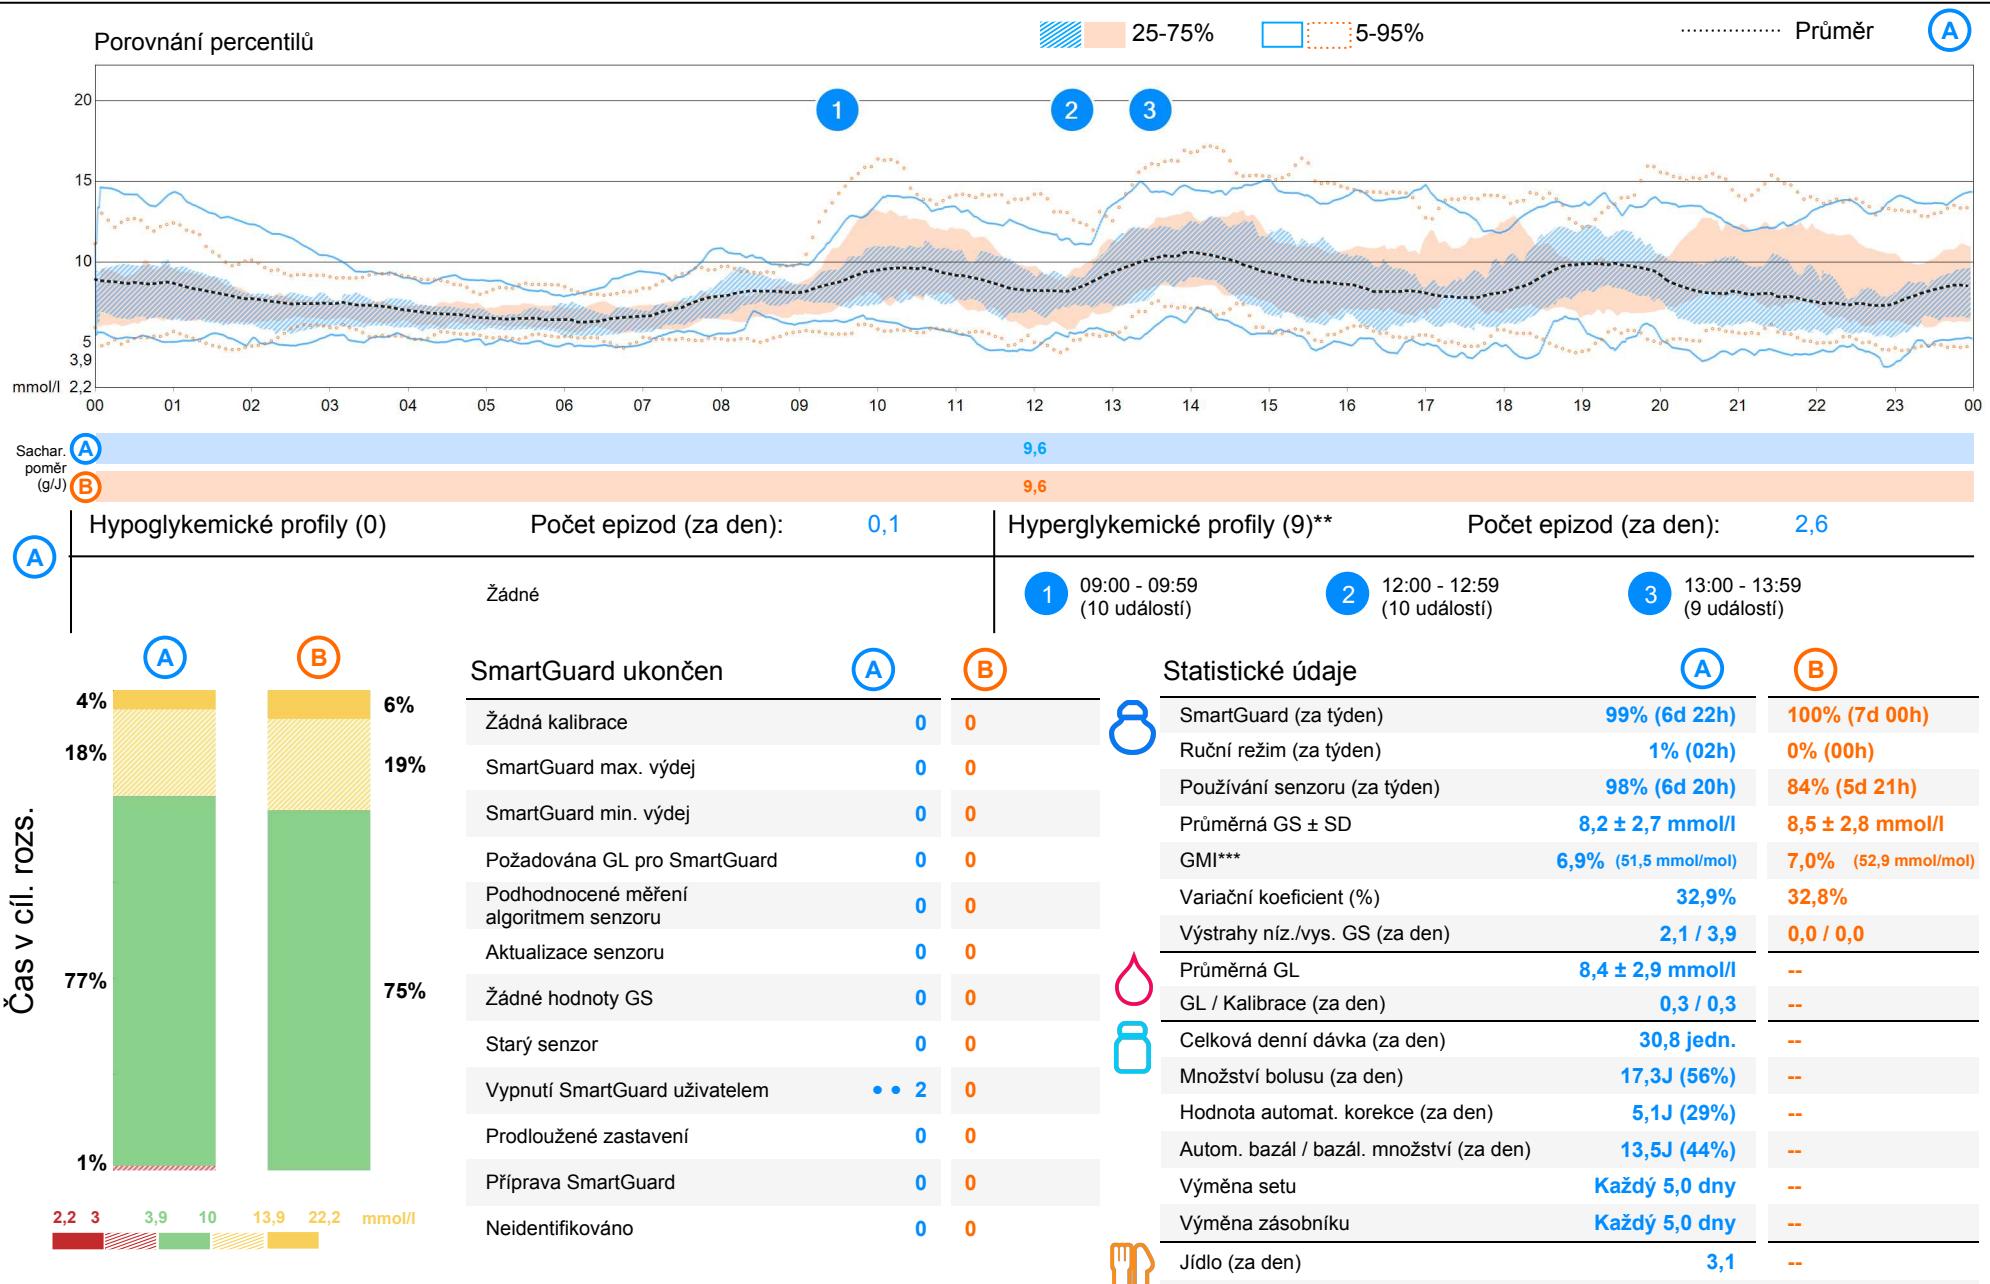


**** Je zobrazena pouze nejvyšší priorita**


*** Indikátor řízení glukózy



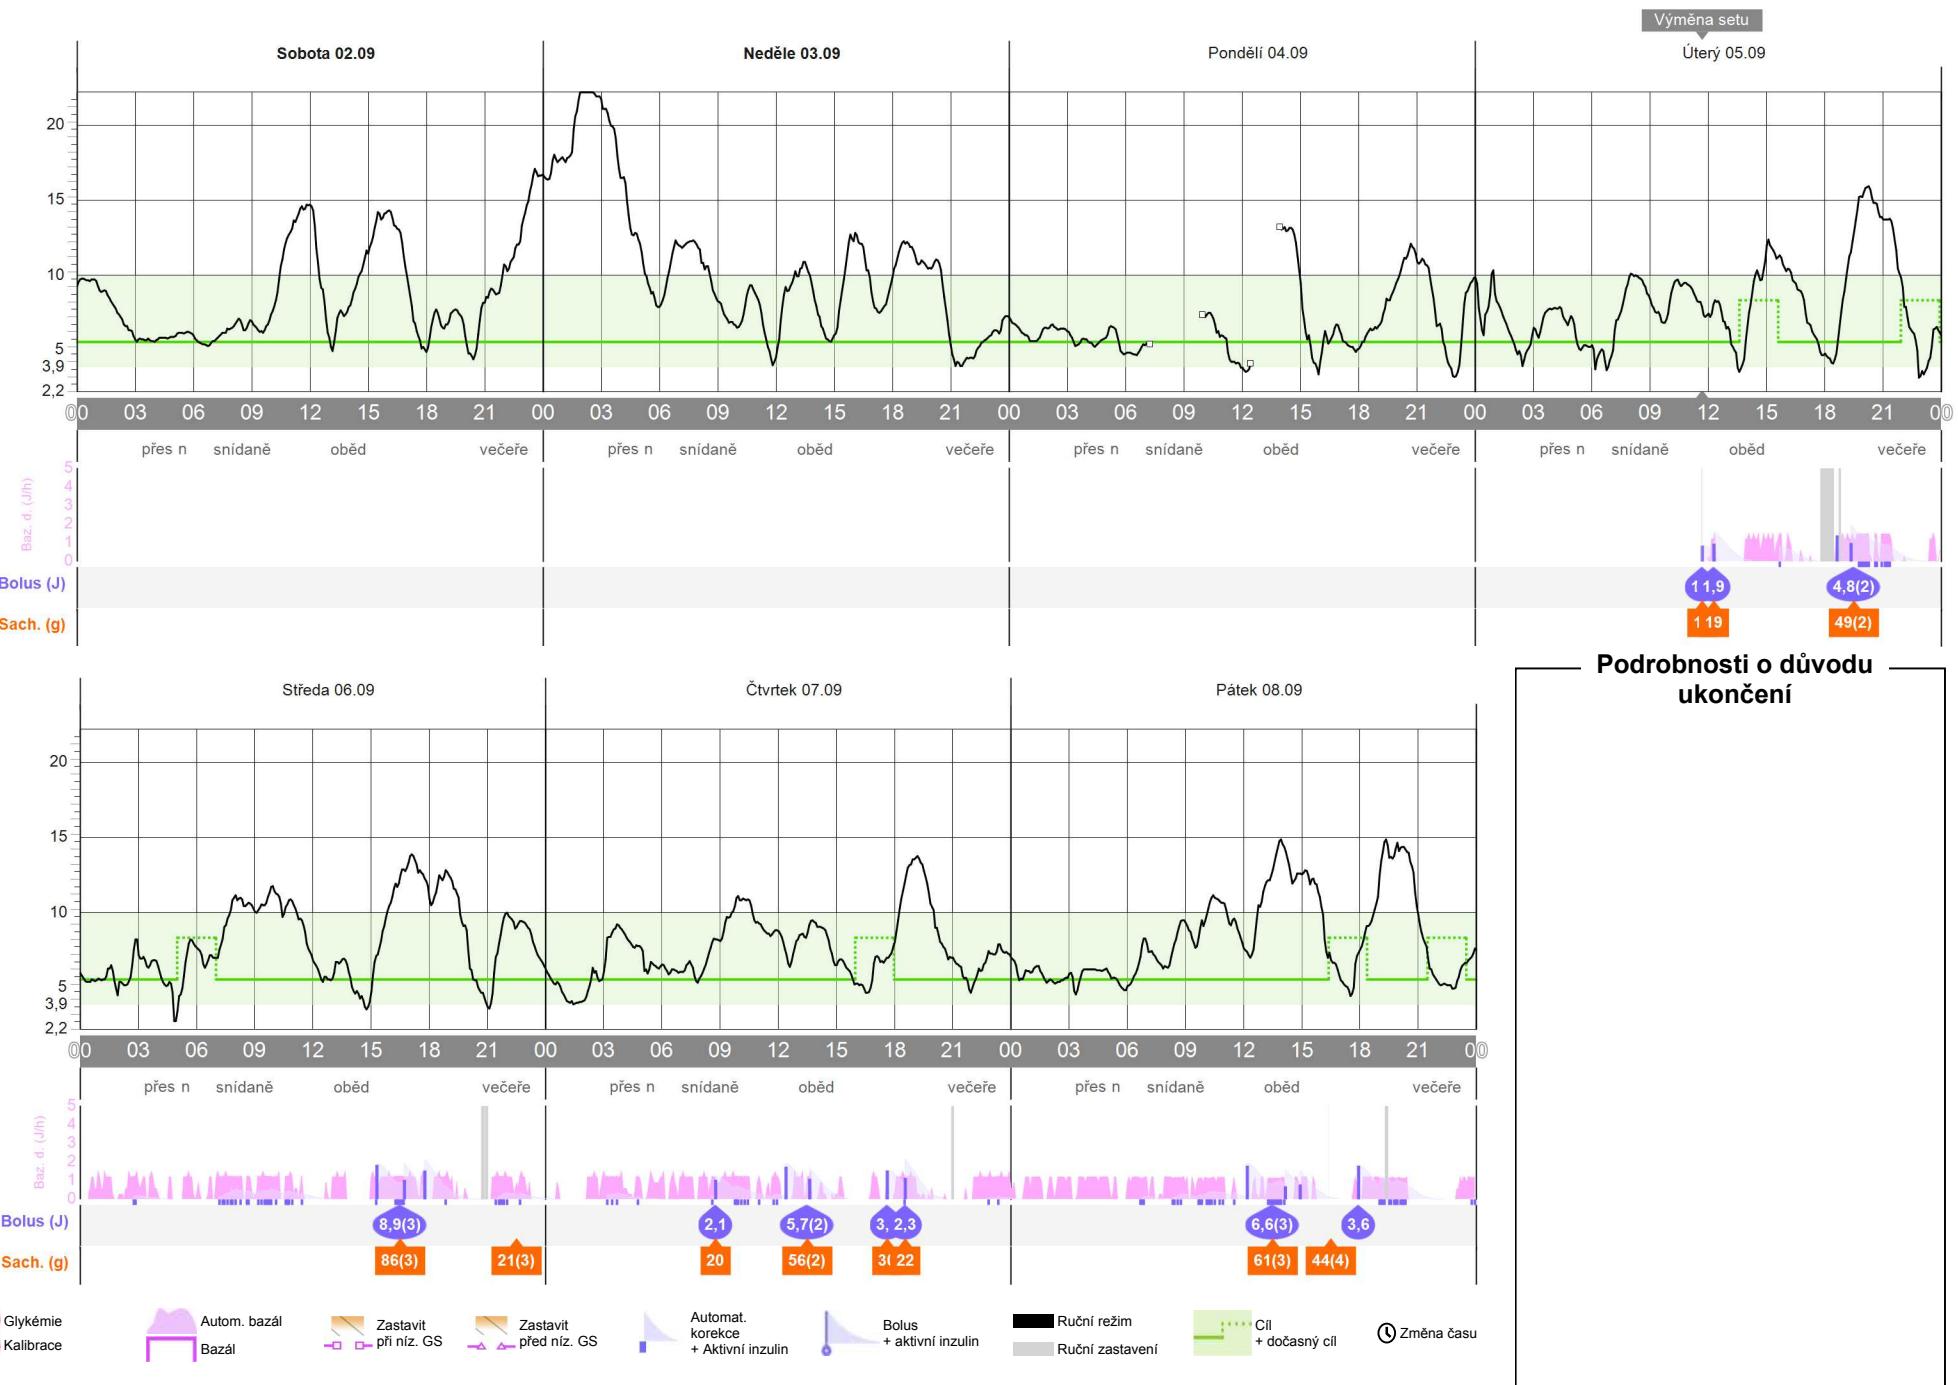


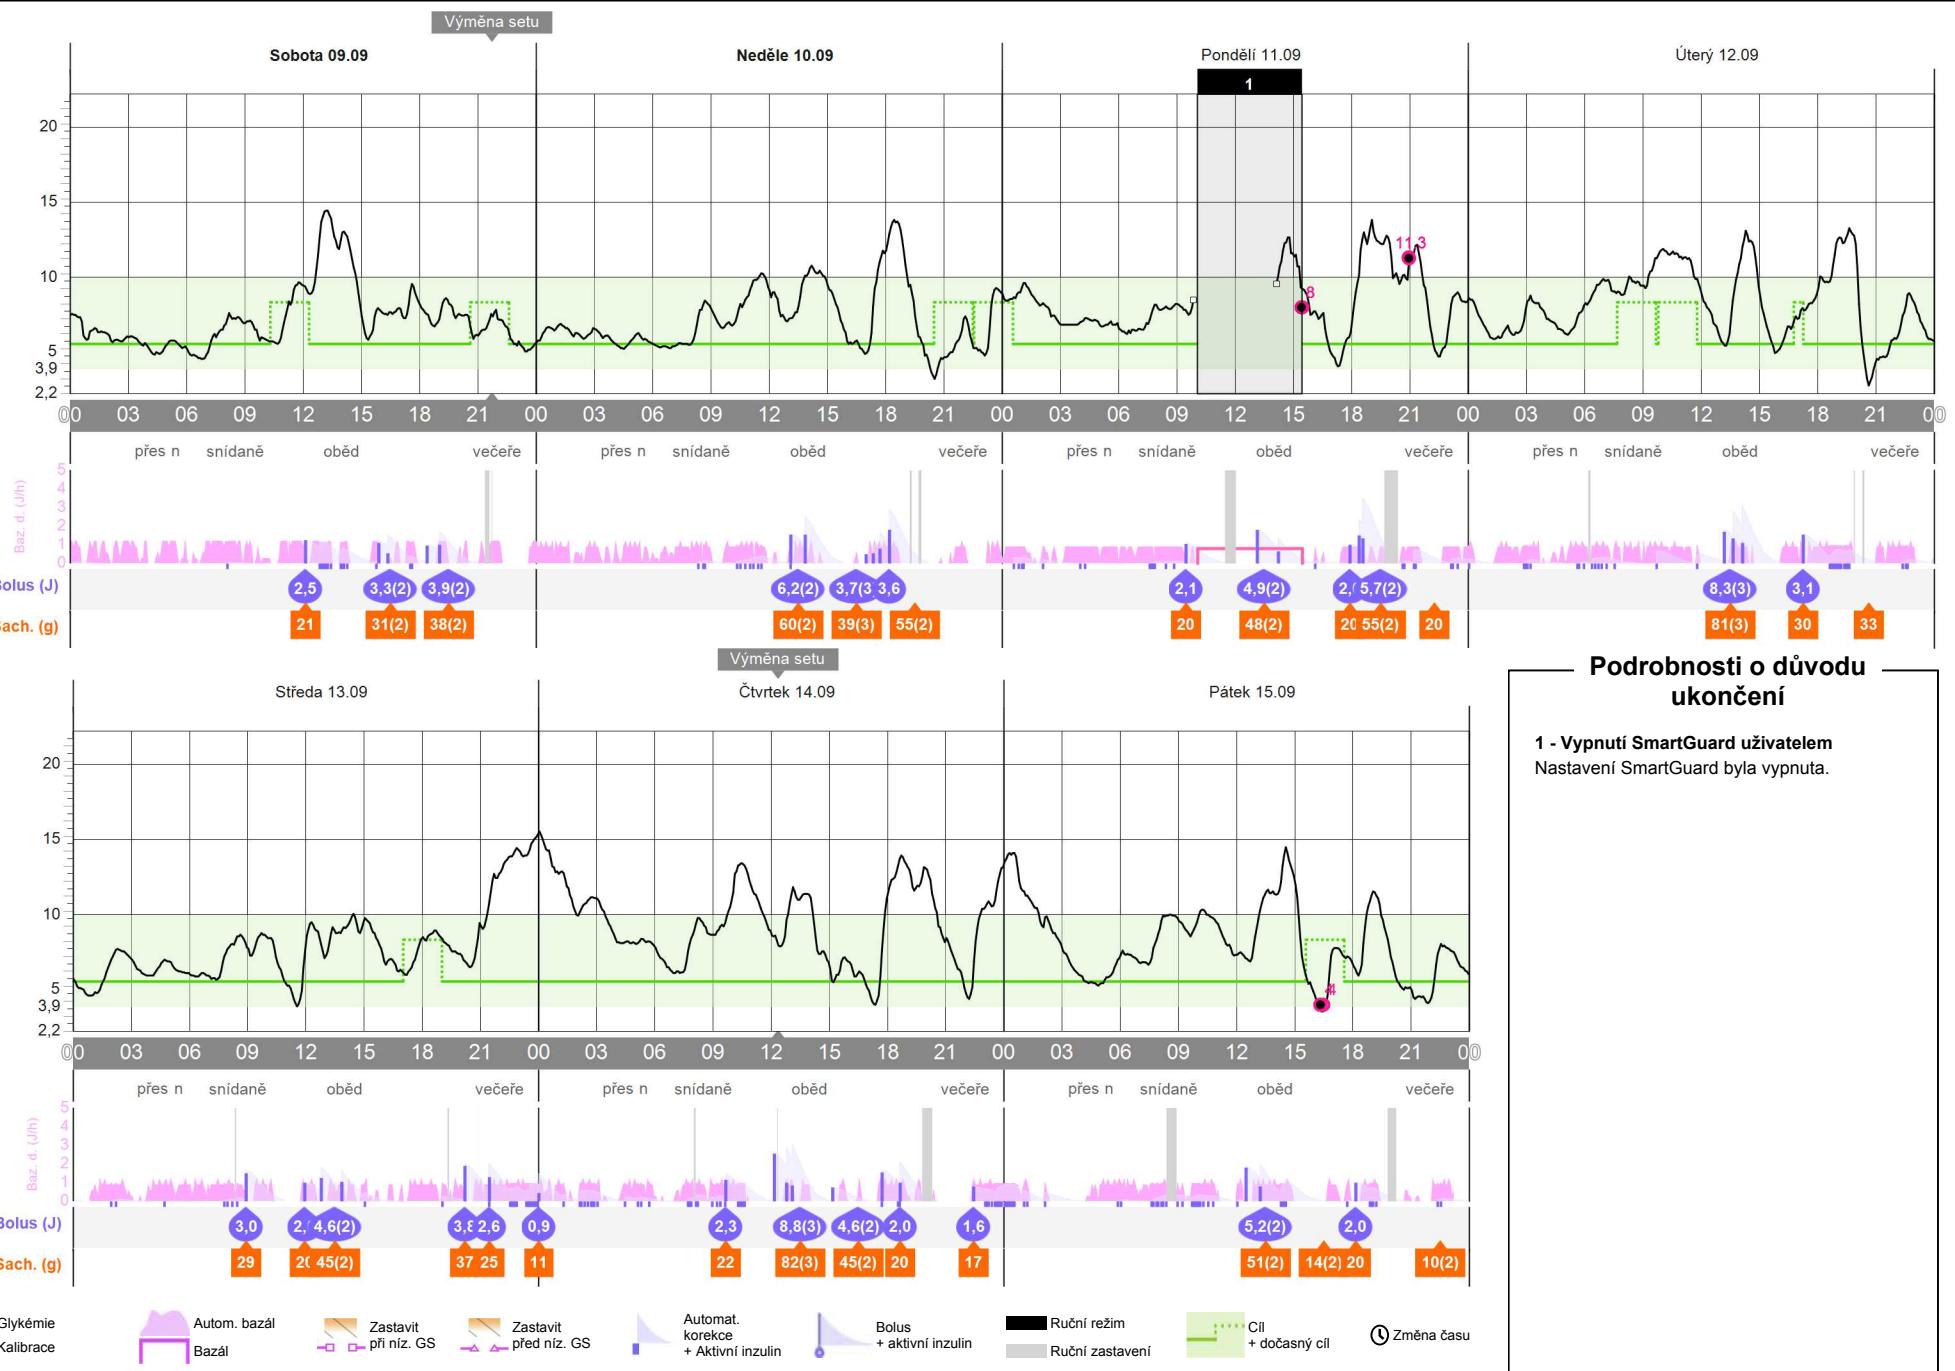



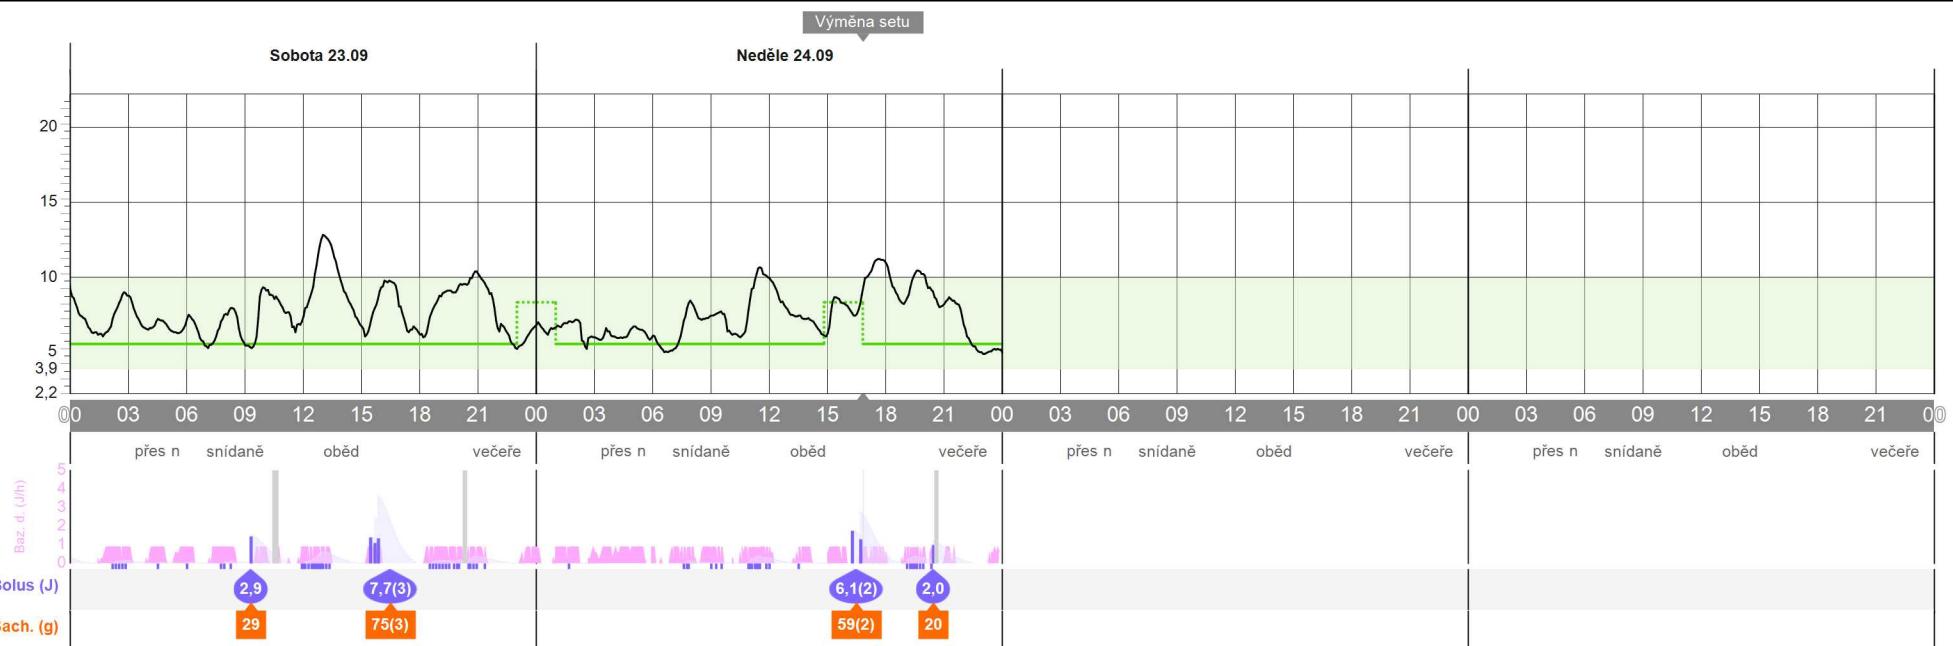

Podrobnosti o důvodu ukončení

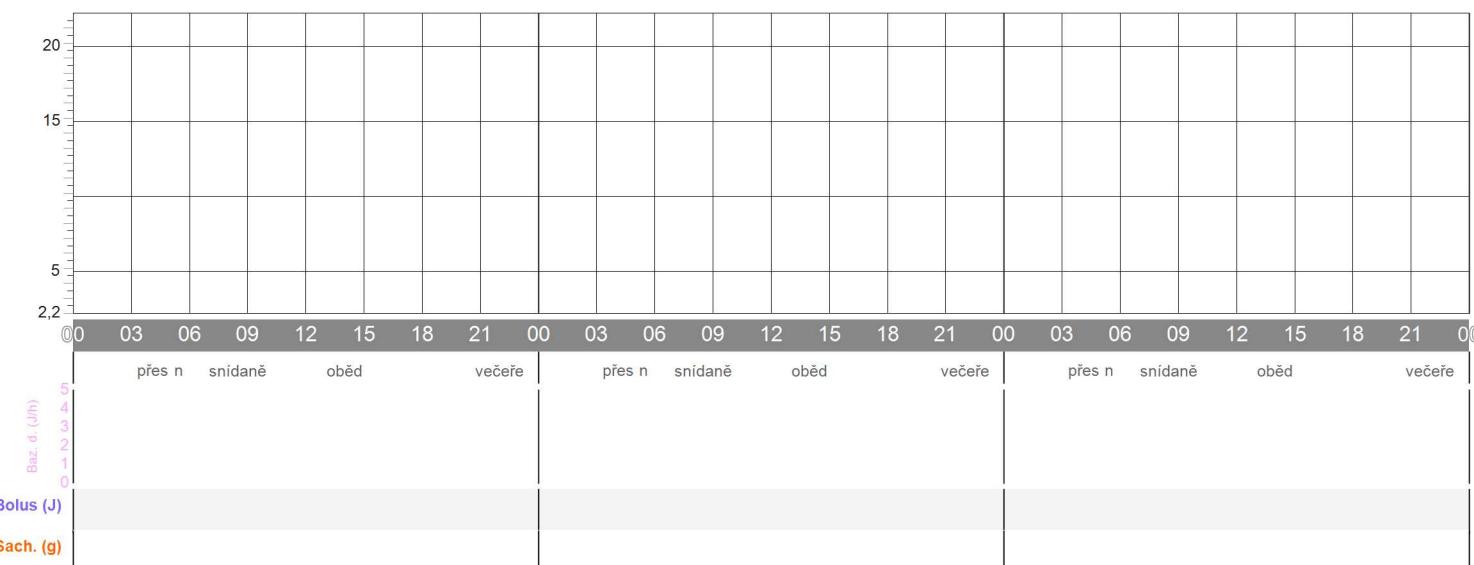

Glykémie
Kalibrace

Autom. bazál
Bazál

Zastavit
při níz. GS

Zastavit
před níz. GS

Automat.
korekce
+ Aktivní inzulin

Bolus
+ aktivní inzulin

Ruční režim
Ruční zastavení

Cíl
+ dočasný cíl
Změna času

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
⌚ Sobota 26.08.2023		24:00											
⌚ Neděle 27.08.2023		24:00											
⌚ Pondělí 28.08.2023		17:45											
⌚ Úterý 29.08.2023		24:00											
⌚ Středa 30.08.2023		24:00											
⌚ Čtvrtek 31.08.2023		23:30											
⌚ Pátek 01.09.2023		23:55											
⌚ Sobota 02.09.2023		24:00											
⌚ Neděle 03.09.2023		24:00											
⌚ Pondělí 04.09.2023		19:55											
⌚ Úterý 05.09.2023		24:00	15	4	4	3		1		1	7,1		0:51
⌚ Středa 06.09.2023		24:00	40	3	3	1							0:22
⌚ Čtvrtek 07.09.2023		24:00	17	5	5	2							0:09
⌚ Pátek 08.09.2023		24:00	43	4	4	2							0:11
Shrnutí	0,0/den	13d 13h 05m	8,2/den	1,1/den	100,0%	50,0%	0%	1	0	--	1	7,1J /naplnění	1h 33m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Sobota 09.09.2023		24:00	15	5	5	3		1			1	7,4	0:17
Neděle 10.09.2023		24:00	11	6	6	1							0:16
Pondělí 11.09.2023	4	19:50	21	6	6	1							1:16
Úterý 12.09.2023		24:00	31	4	4								0:18
Středa 13.09.2023		24:00	23	6	6								0:10
Čtvrtek 14.09.2023		24:00	39	9	9	4		1			1	6,6	0:39
Pátek 15.09.2023	2	24:00	42	3	3								0:57
Sobota 16.09.2023		24:00	28	4	4	1							0:59
Neděle 17.09.2023		24:00	25	8	8	3							1:18
Pondělí 18.09.2023	2	21:20	43	3	3								0:13
Úterý 19.09.2023	2	24:00	21	4	4	2		1			1	6,4	0:29
Středa 20.09.2023		24:00	24	5	5	1							0:46
Čtvrtek 21.09.2023		24:00	39	7	7	2							0:15
Pátek 22.09.2023		24:00	61	1	1								1:31
Shrnutí	0,7/den	13d 17h 10m	30,2/den	5,1/den	100,0%	25,4%	0%	3	0	--	3	6,8J /naplnění	9h 24m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Sobota 23.09.2023		24:00	39	4	4	1							0:35
Neděle 24.09.2023		24:00	26	3	3			1			1	6,5	0:15
Shrnutí	0,0/den	2d 00h 00m	32,5/den	3,5/den	100,0%	14,3%	0%	1	0	--	1	6,5J /naplnění	50m

Bazál

Maximální bazální dávka	3,00 J/hod		Aktual.
--------------------------------	------------	--	----------------

Bazál 1 (aktivní)

24 hod celkem	18,625 J	
---------------	----------	--

Bazál 2

24 hod celkem -- 

Bazál 3

24 hod celkem --

Bolus

Bolus Wizard	Zap.
Jednotky	g, mmol/l
Doba aktivního inzulinu (h:mm)	2:00
Maximální bolus	12,0 J

Snadný bolus	Vyp
Přírůstek bolusu	0,1 J
Rychlosť bolusu	Standardná
Komb./Rozl.	Zap./Zap.

Sacharidový pom (g/J)

Citl. na inzulin
(mmol/l na J)

Cílová glykémie (mmol/l)

Přednastav. bolus

Název	Normální	Rozložený		Aktuální
Bolus 1				
Snídaně				
Večeře				
Oběd				
Svačina				
Bolus 2				
Bolus 3				
Bolus 4				

Přednast. doč. b.

Název	Rychl.	Trvání		Název	Rychl.	Trvání	
Vys. zátěž				Doč. baz. 1			
Střed. zátěž				Doč. baz. 2			
Nízká zátěž				Doč. baz. 3			
Nemoc				Doč. baz. 4			

Připomínky		
Varov. při nízk. stavu zás.	Jednotky inzul.	
Množství	20 J	
Kontrola GL po bolusu	Vyp	
Výměna setu	Vyp	
Zmeškaný bolus k jídlu		
Název	Počátek	Konec
Jídlo 1	Vyp	Vyp
Jídlo 2	Vyp	Vyp
Jídlo 3	Vyp	Vyp
Jídlo 4	Vyp	Vyp
Jídlo 5	Vyp	Vyp
Jídlo 6	Vyp	Vyp
Jídlo 7	Vyp	Vyp
Jídlo 8	Vyp	Vyp
Osobní připomínky		
Název	Čas	
Připominka 1	Vyp	
Připominka 2	Vyp	
Připominka 3	Vyp	
Připominka 4	Vyp	
Připominka 5	Vyp	
Připominka 6	Vyp	
Změřte GL	Vyp	
Léky	Vyp	
Příslušenství		
Režim blokování	Vyp	
Formát času	24 hod	
Jas	3	
Doba podsvícení	60 s	
Možnosti zvuku	Zvuk	
Hlasitost alarmu	1	
Automat. zastavení	Vyp	

Sobota 26.08

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.



Neděle 27.08

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.



*S ohledem na aktivní insulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní insulin

Bolus + Aktivní insulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času
▼ Mimo grafRuční režim
Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Pondělí 28.08

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.



Úterý 29.08

Celk. denní dávka -- J


Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.

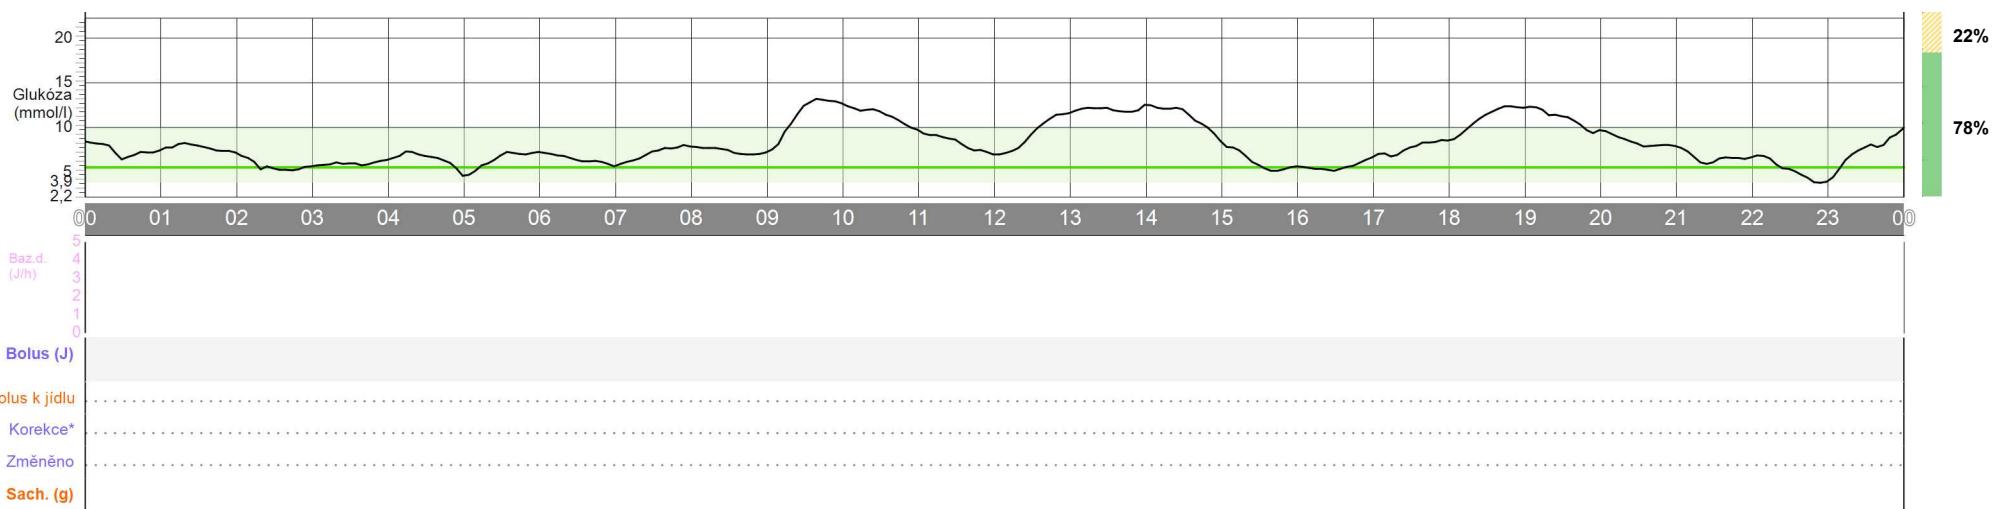

*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Středa 30.08

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J

}

Čas v cíl. rozs.



Čtvrtek 31.08

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J

}

Čas v cíl. rozs.



*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Pátek 01.09

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.



Sobota 02.09

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J }

Čas v cíl. rozs.



*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Neděle 03.09

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J

Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J

{

Čas v cíl. rozs.



Pondělí 04.09

Celk. denní dávka -- J

Celkový bazál -- % | -- J


Celkový bolus -- % | -- J

{ Bolus --% | -- J

+ Automat. korekce --% | -- J

{

Čas v cíl. rozs.

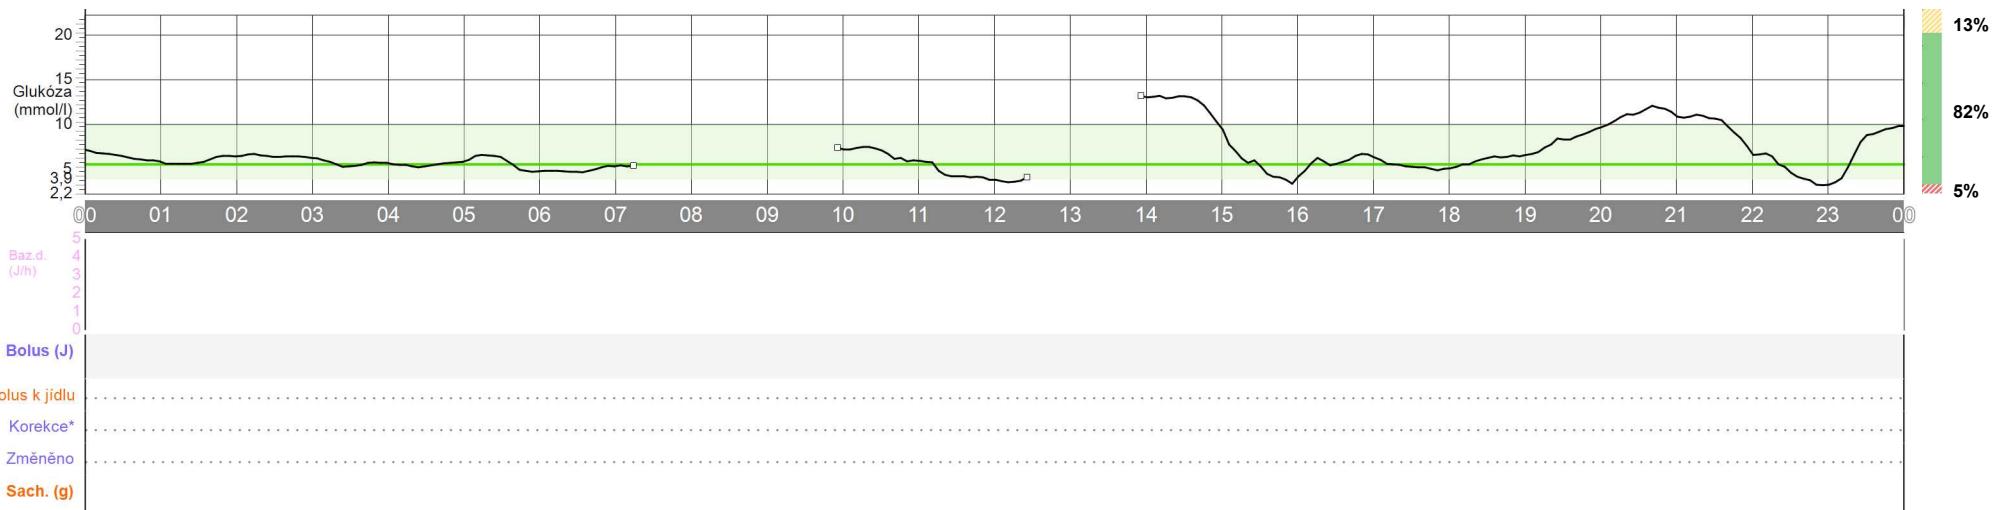

*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Úterý 05.09

Celk. denní dávka 32,9 J

Celkový bazál 60 % | 19,9 J

Celkový bolus 40 % | 13,0 J


Výměna setu

Bolus 65% | 8,4 J

+

Automat. korekce 35% | 4,6 J

Čas v cíl. rozs.

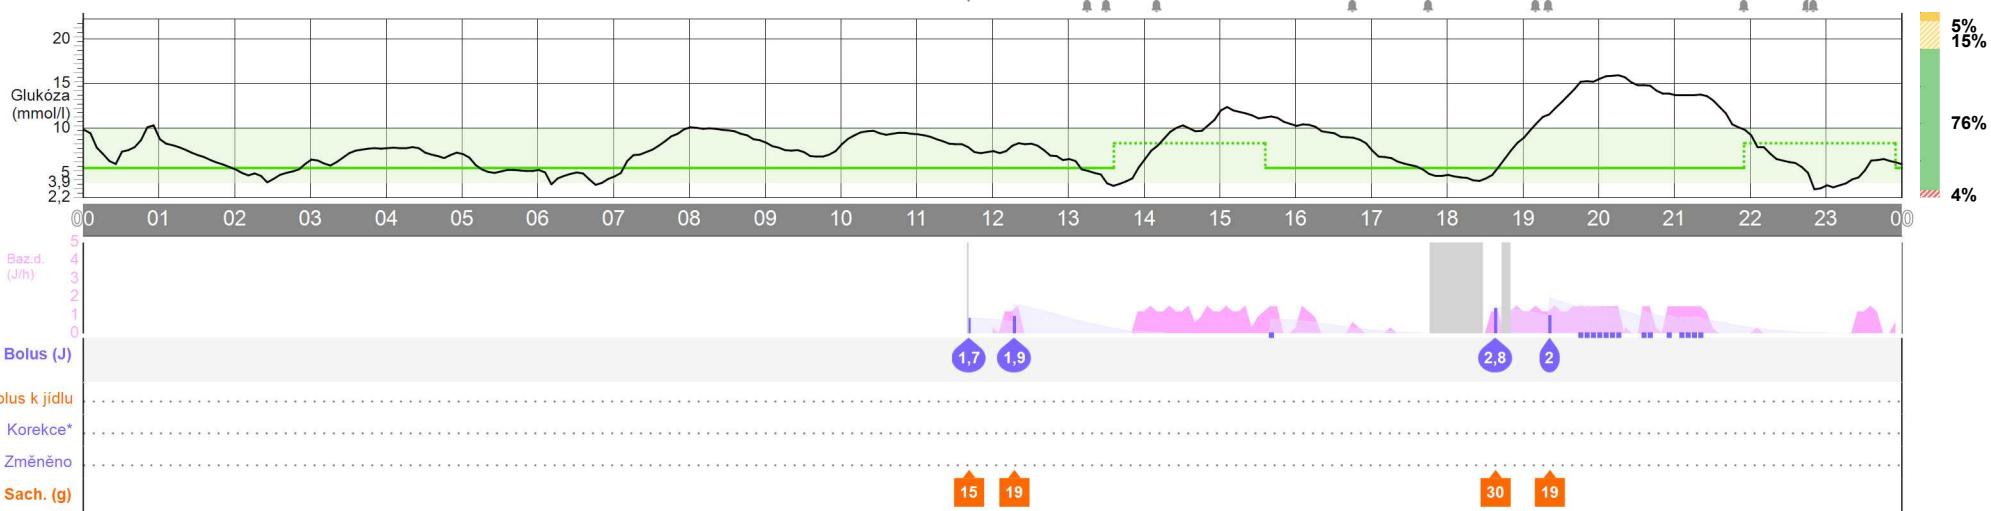

Středa 06.09

Celk. denní dávka 32,0 J

Celkový bazál 52 % | 16,6 J


Celkový bolus 48 % | 15,4 J

Bolus 58% | 8,9 J

+

Automat. korekce 42% | 6,5 J

Čas v cíl. rozs.

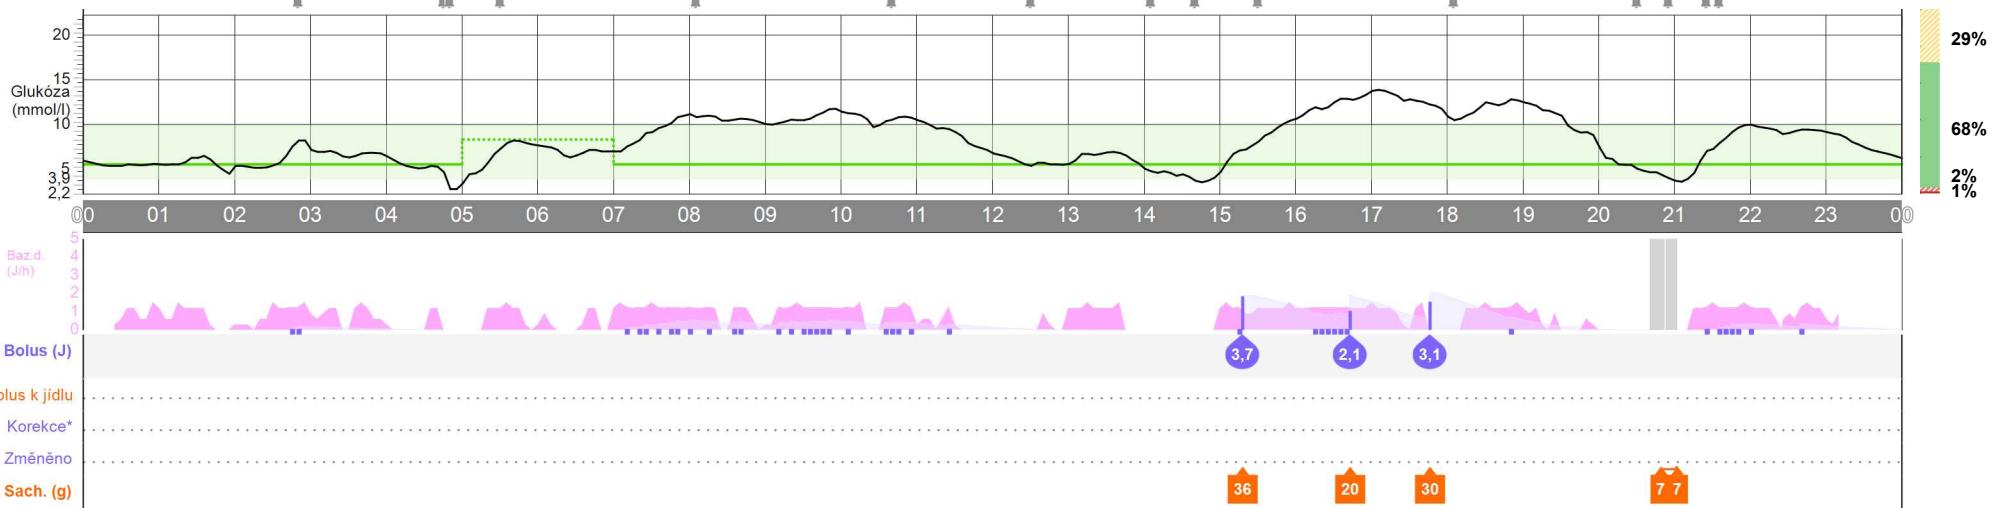

*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času
Mimo grafRuční režim
Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Čtvrtek 07.09

Celk. denní dávka 32,3 J


Celkový bazál 48 % | 15,6 J

Celkový bolus 52 % | 16,7 J

Bolus 79% | 13,2 J

Automat. korekce 21% | 3,5 J

Čas v cíl. rozs.

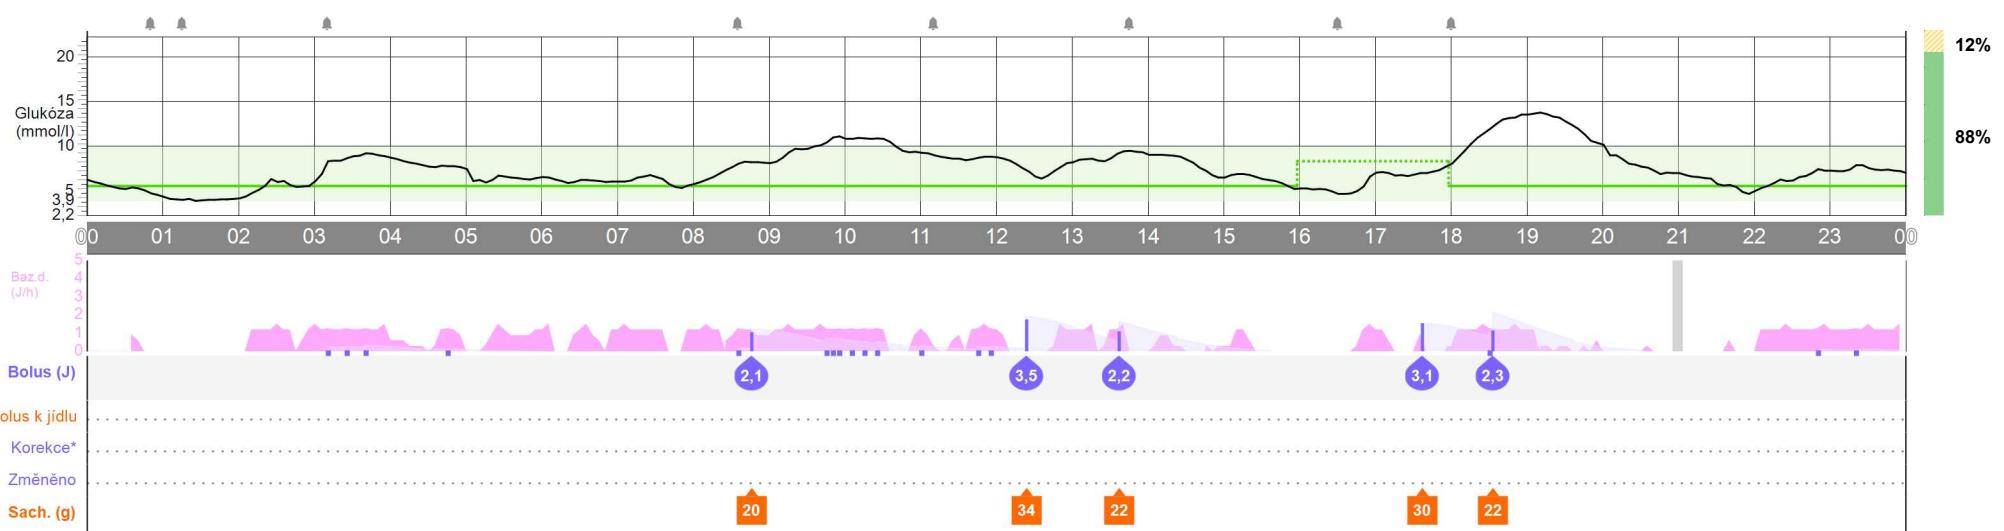

Pátek 08.09

Celk. denní dávka 34,0 J

Celkový bazál 47 % | 16,0 J

Celkový bolus 53 % | 18,0 J

Bolus 57% | 10,2 J

Automat. korekce 43% | 7,8 J

Čas v cíl. rozs.



*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat.

korekce + Aktivní inzulin

Bolus

+ Aktivní inzulin

Cíl

+ dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2