




Glykémie (Glykémie)

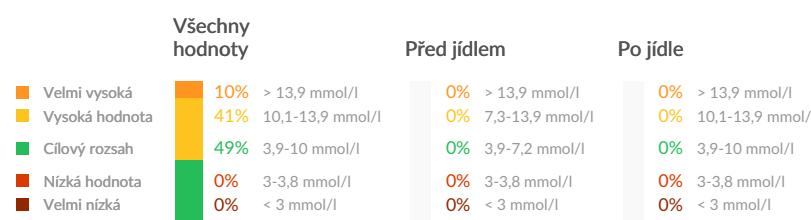


Průměr	9,9 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Směrodatná odchylka	2,7 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Hodnoty/den	7,2	-	-
Medián	10 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Nejvyšší	18,1 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Nejnižší	4,9 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l

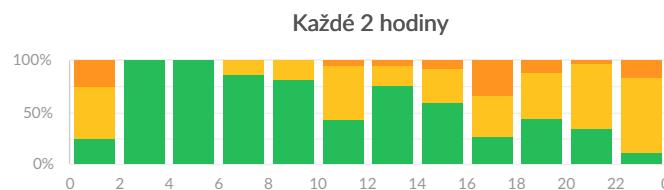

Hodnoty	4	2	8	8	16	23	21	27	30	27	32	19
Průměr (mmol/l)	12,3	8,9	6,6	6,6	8,1	9,8	8,6	9,6	11,9	10,4	10,1	11,9
Směrodatná odchylka (mmol/l)	2,5	1,3	1,2	1,6	1,9	2,1	2,4	2,3	3,1	2,5	2,3	1,9

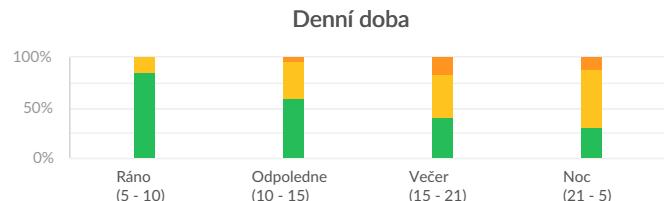

Hodnoty	27	57	87	46
Průměr (mmol/l)	7,5	9,2	10,7	10,7
Směrodatná odchylka (mmol/l)	1,8	2,2	2,8	2,7

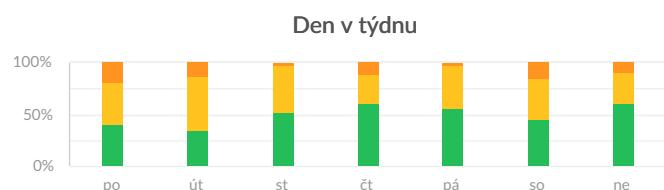

Hodnoty	34	43	29	28	34	26	23
Průměr (mmol/l)	10,5	10,3	9,6	9,7	9,8	9,9	9,2
Směrodatná odchylka (mmol/l)	3	2,9	2,5	2,6	2,1	3,2	2,7

Inzulin – zařízení

Z inzulinové pumpy




- 62% 33,1 jednotky
Bazál/den
- 38% 19,9 jednotky
Bolus/den

Inzulin/den
Přepisuje (%)
Bolus/den

53 jednotky
0% (0 bolusy)
12,2

Podrobnosti systému

Tandem t:slim X2 (29d 12h)

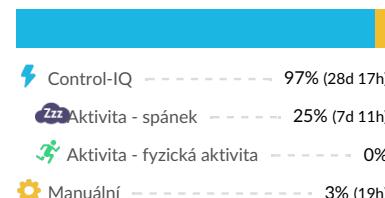

LGS/PLGS

Doba pozastavení/den	46m
Průměrné pozastavení/den	2,4
Průměrné pozastavení/denní doba	
Ráno - 33%	
Odpoledne - 33%	
Večer - 11%	
Noc - 23%	


Dieta

Sacharidy/Den	151 g
Zápis/y/Den	6,2

Fitness

Není připojeno žádné zařízení pro sledování fitness

Komentáře

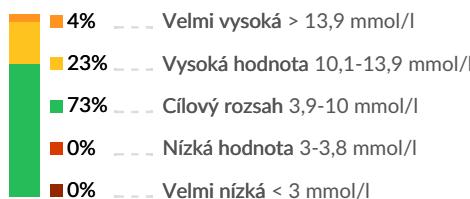
Glukóza - čas v rozmezí**Souhrn**

GMI
7% (53,2 mmol/mol)
Průměr
8,6 mmol/l
% čas CGM aktivní
96,3% (28,9 dny)

Směrodatná odchylka ... 2,6 mmol/l
CV ... 30,4%
Medián ... 8,1 mmol/l
Nejvyšší ... 18,5 mmol/l
Nejnižší ... 6,0 mmol/l

Ambulantorní Glykemický Profil (AGP)

Cílový rozsah (3,9 - 10 mmol/l) Medián
25 - 75 % 10 - 90 % Nejnižší - Nejvyšší

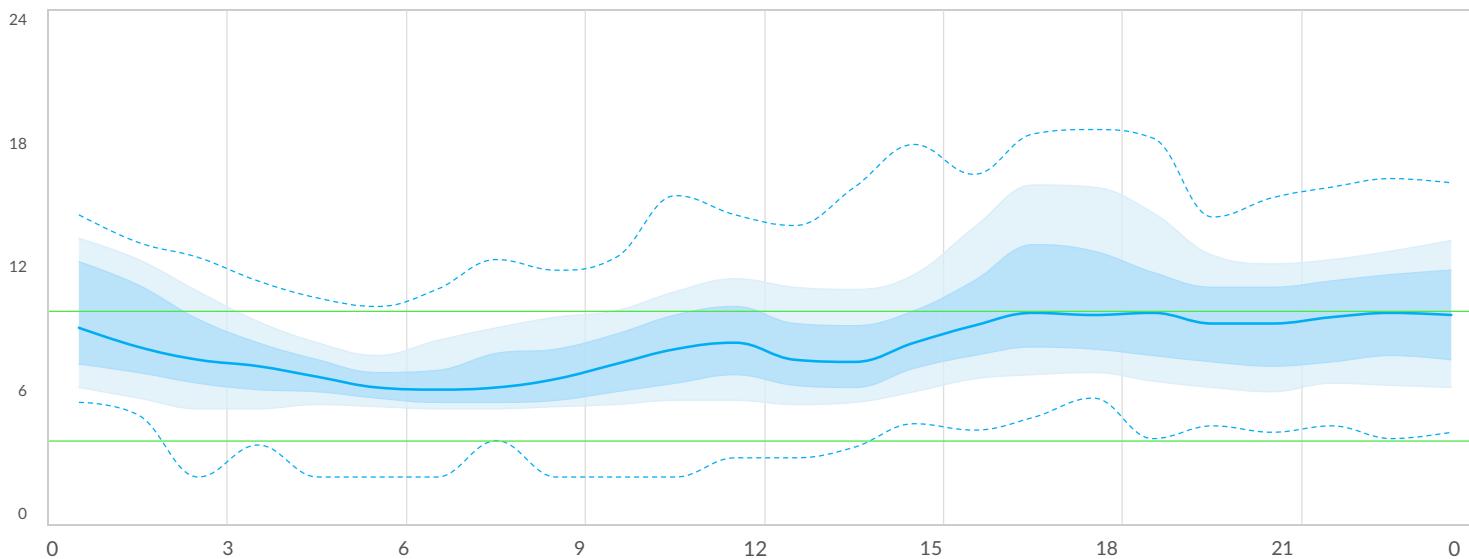**Inzulin - zařízení**

Z inzulinové pumpy



Inzulin/den ... 53 jednotky

Přepisuje (%) ... 0% (0 bolusy)

Bolus/den ... 12,2

Podrobnosti systému

Tandem t:slim X2 (29d 12h)

**LGS/PLGS**

Doba pozastavení/den	46m
Průměrné pozastavení/den	2,4
Průměrné pozastavení/denní doba	
Ráno	33%
Odpoledne	33%
Večer	11%
Noc	23%


Dieta

Sacharidy/Den ... 151g
Zápis/Den ... 6,2

Fitness

Není připojeno žádné zařízení pro sledování fitness

Komentáře

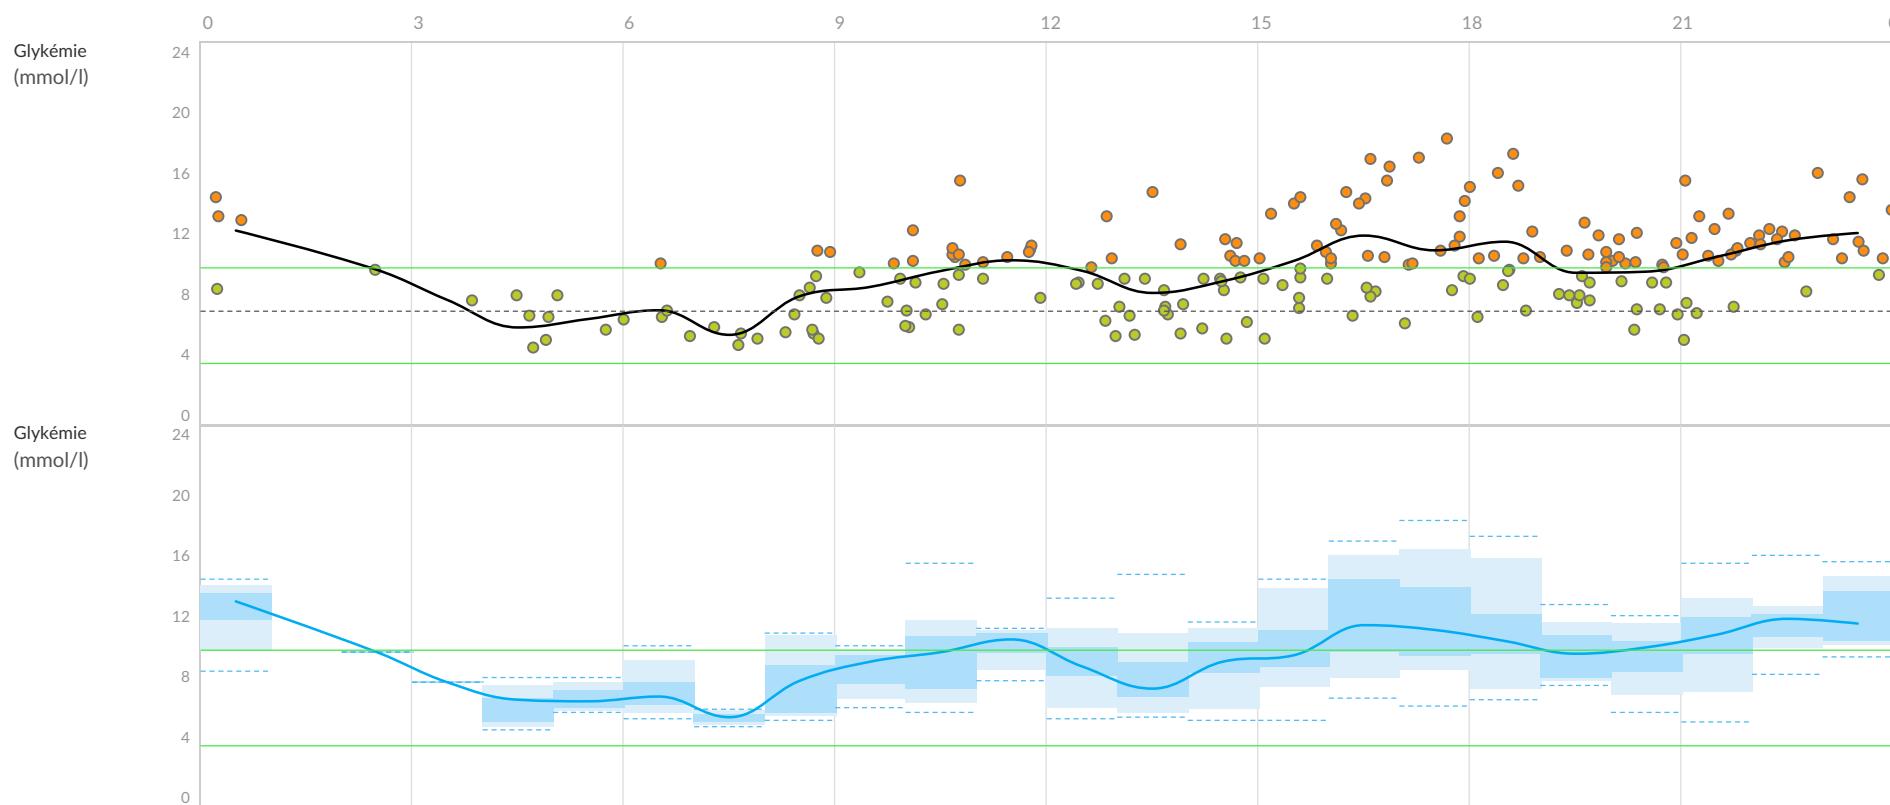

GLYKÉMIE (BG)		7,2 Hodnoty/den	0% Velmi nízká < 3 mmol/l		0% Nízká hodnota 3-3,8 mmol/l		49% V cílovém rozsahu 3,9-10 mmol/l		41% Vysoká hodnota 10,1-13,9 mmol/l		10% Velmi vysoká > 13,9 mmol/l	
9,9 mmol/l Průměr	2,7 mmol/l Směrodatná odchylka											

Glykémie
---- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

● Nad rozsahem

● V cílovém rozsahu

● Pod rozsahem

— Medián


Percentily

■ 25 - 75 %

■ 10 - 90 %

— Medián

... Nejnižší - Nejvyšší


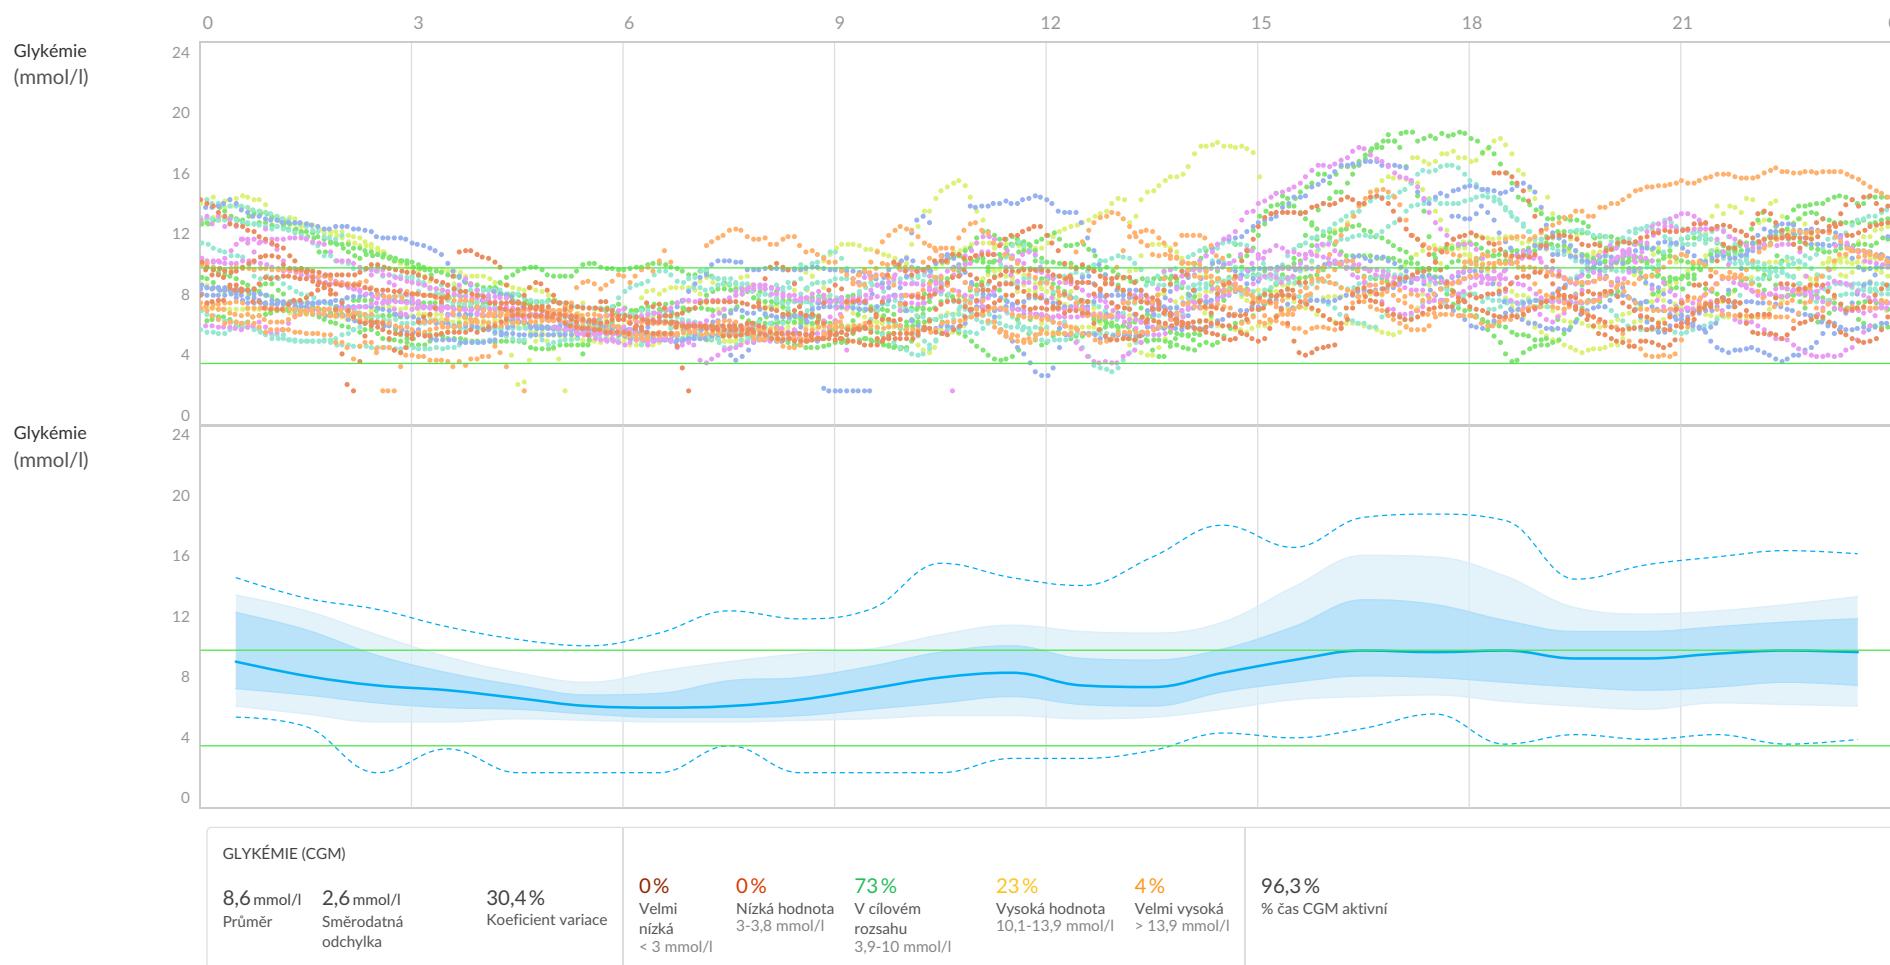


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Glykémie | Percentily |
| — Cílový rozsah (3,9 - 10 mmol/l) | ■ 25 - 75 % |
| ... Pondělí | ■ 10 - 90 % |
| ... Úterý | — Medián |
| ... Středa | ... Nejnižší - Nejvyšší |
| ... Čtvrtek | |
| ... Pátek | |
| ... Sobota | |
| ... Neděle | |

Datum narození: 2. 10. 1965

Diabetes: 1. typ

17. 10. 2023 - 15. 11. 2023 (30 dní)

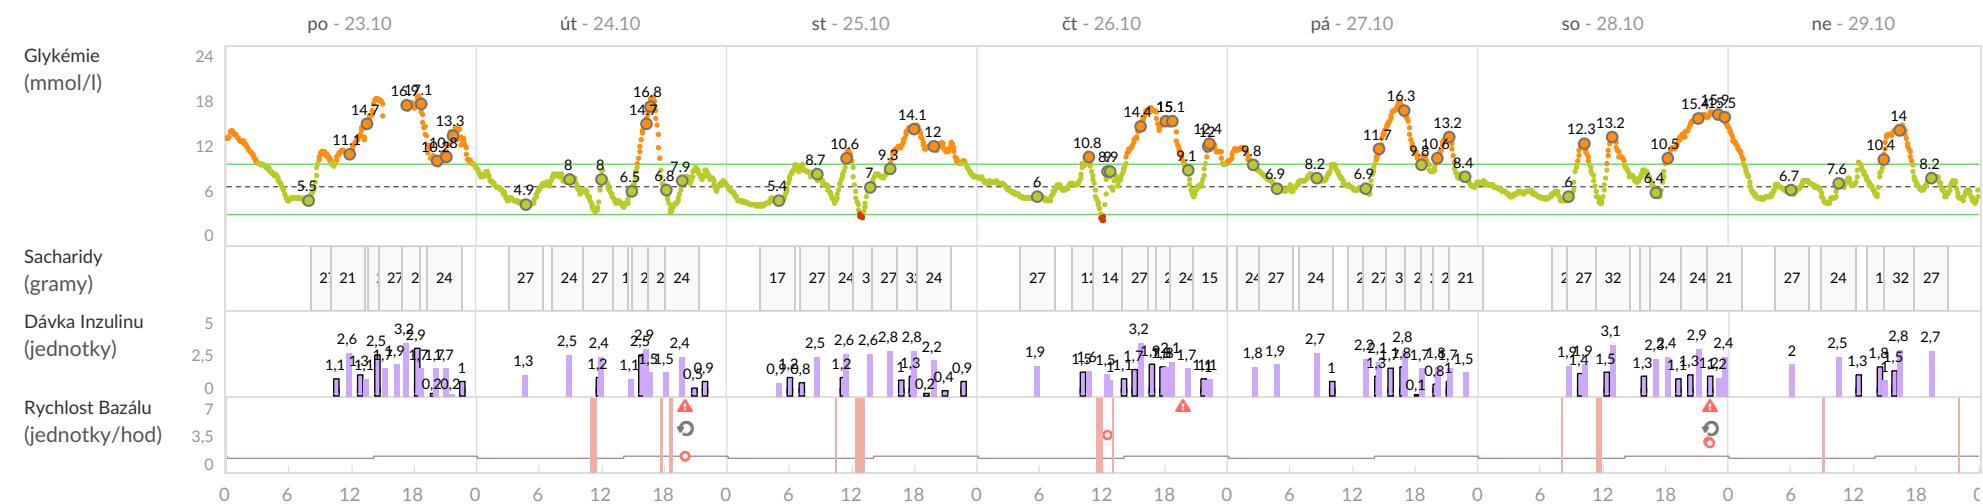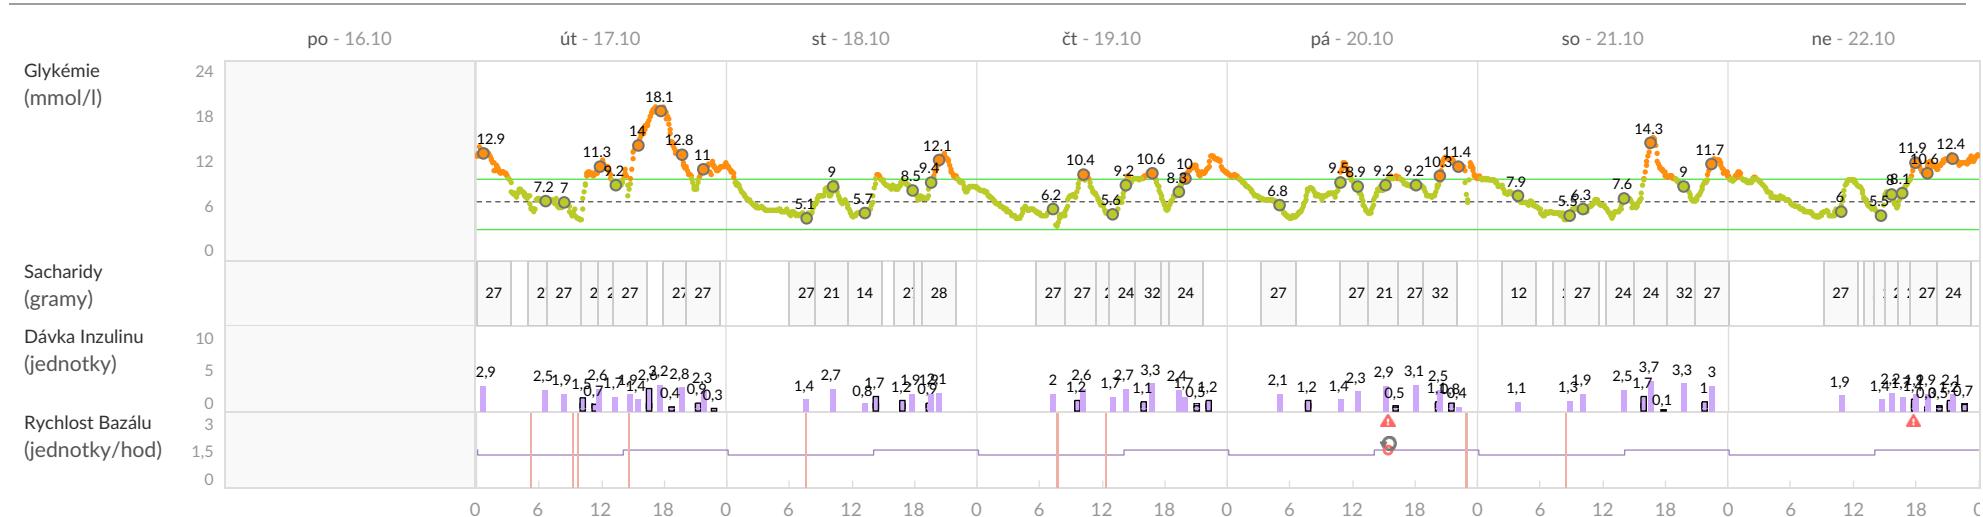

- Glykémie**
- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
 - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
 - Nad rozsahem
 - V cílovém rozsahu
 - Pod rozsahem

- Typy hodnot**
- Hodnoty glykémie
 - Pumpa BG
 - Kalibrace
 - Hodnoty z CGM
 - Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
 - Nad 22,2 (Pumpa BG)
 - Nad22,2


- Dávka inzulinu**
- Bolus
 - Automatický bolus
 - Rozšířený bolus
 - Bazál
 - Předmixovaný
 - Vlastní

- Bazál**
- Plánovaná bazální rychlosť
 - Dočasná rychlosť bazálu
 - Pozastaviť
 - LGS/PLGS
 - Změna setu/pracoviště
 - Výměna nádržky
 - Výstraha pumpy

Datum narození: 2. 10. 1965

Diabetes: 1. typ

17. 10. 2023 - 15. 11. 2023 (30 dní)

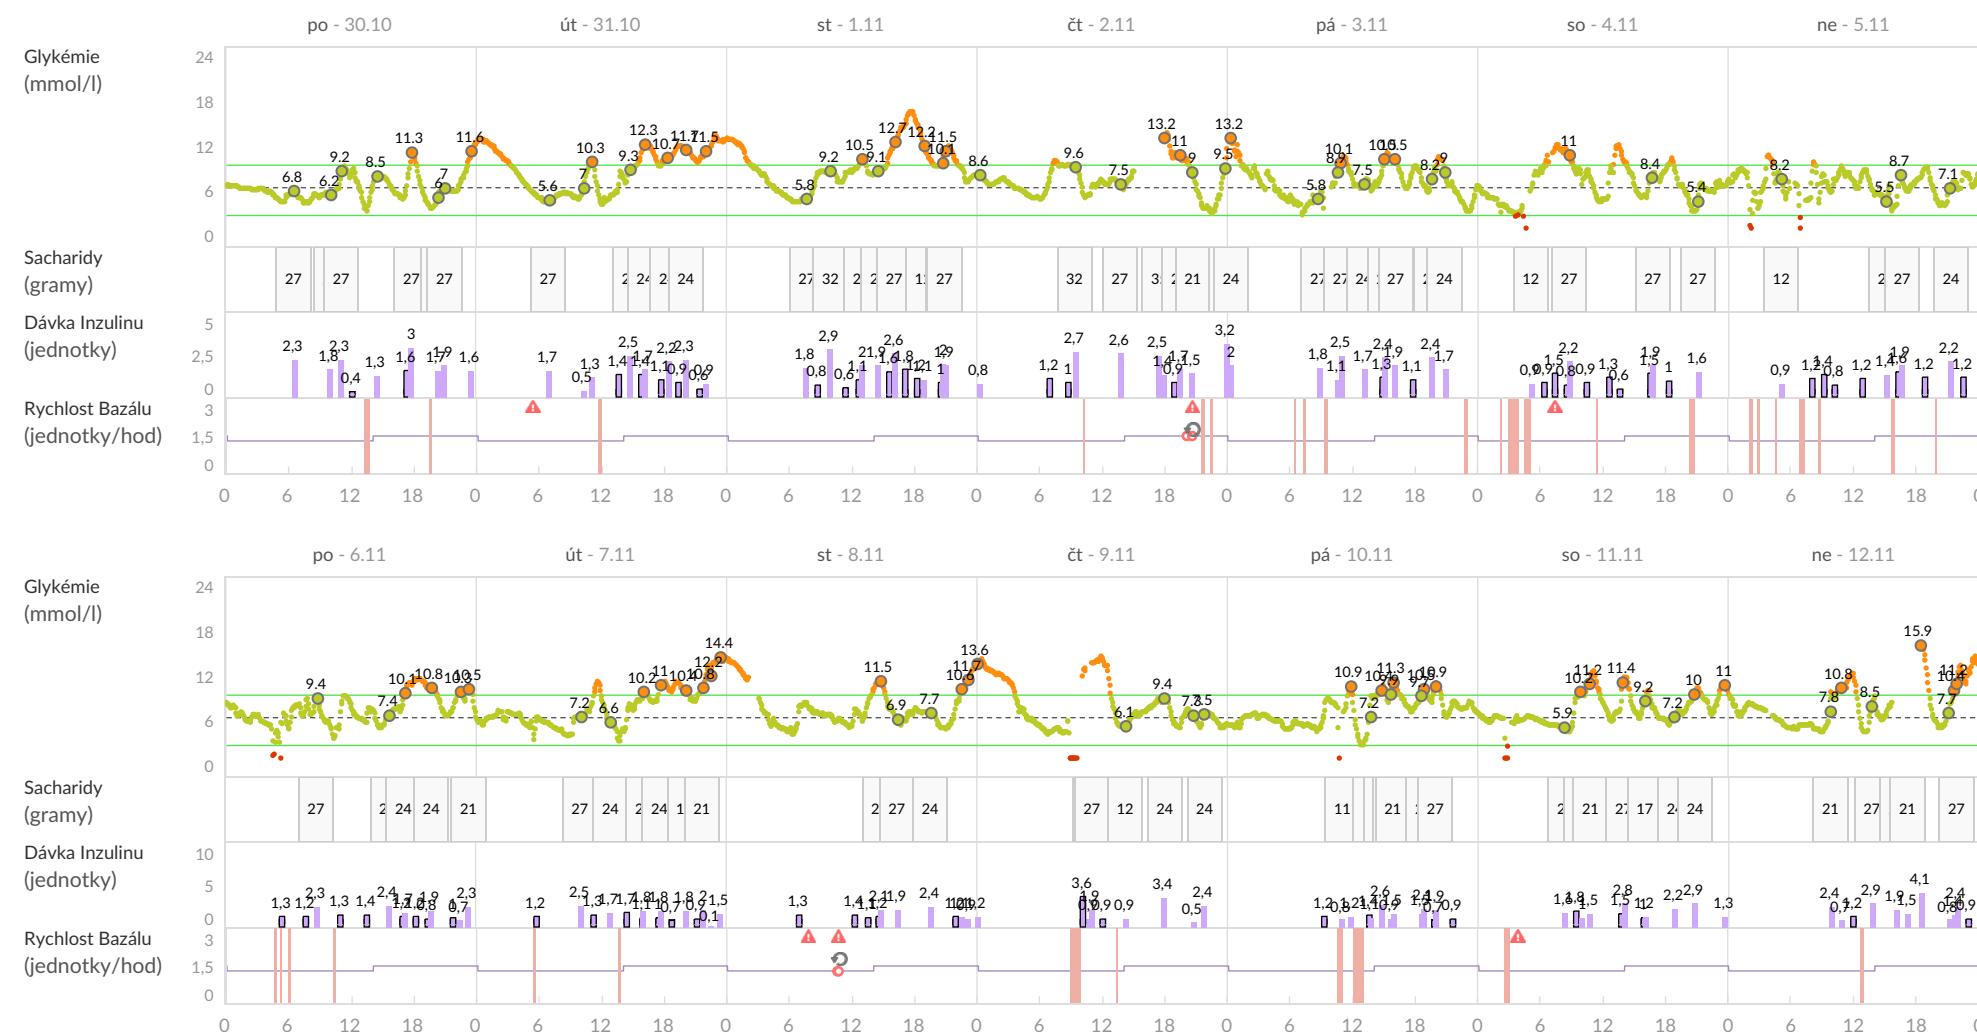


- Glykémie
 - Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
 - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
 - Nad rozsahem
 - V cílovém rozsahu
 - Pod rozsahem

- Typy hodnot
 - ● ● Hodnoty glykémie
 - ● ● Pumpa BG
 - ◆ ◆ ◆ Kalibrace
 - Hodnoty z CGM
 - Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
 - Nad 22,2 (Pumpa BG)
 - Nad 22,2

- Dávka inzulinu
 - Bolus
 - Automatický bolus
 - Rozšířený bolus
 - Bazál
 - Předmixovaný
 - Vlastní

- Bazál
 - Plánovaná bazální rychlosť
 - ... Docasné rychlosť bazálu
 - Pozastaviť
 - LGS/PLGS
 - Změna setu/pracoviště
 - Výměna nádržky
 - ▲ Výstraha pumpy

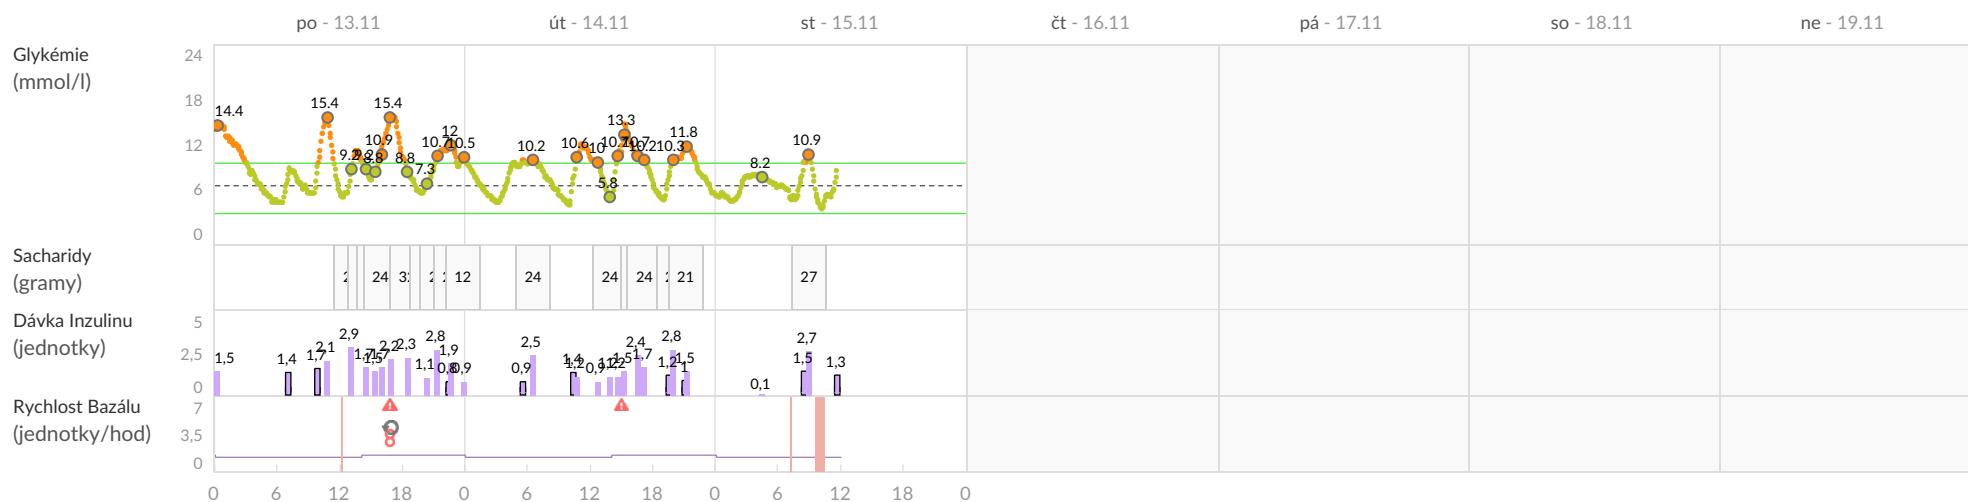**Glykémie**

- ... Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
- Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
- Nad rozsahem
- V cílovém rozsahu
- Pod rozsahem

Typy hodnot

- ● ● Hodnoty glykémie
- ● ● Pumpa BG
- ◆ ◆ ◆ Kalibrace
- --- Hodnoty z CGM
- ... Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Nad 22,2 (Pumpa BG)
- Nad 22,2


Dávka inzulinu

- Bolus
- Automatický bolus
- Rozšířený bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní

Bazál

- Plánovaná bazální rychlosť
- ... Dočasná rychlosť bazálu
- ∞ Pozastavit
- LGS/PLGS
- Změna setu/pracoviště
- Výměna nádržky
- ⚠️ Výstraha pumpy

17. 10. 2023

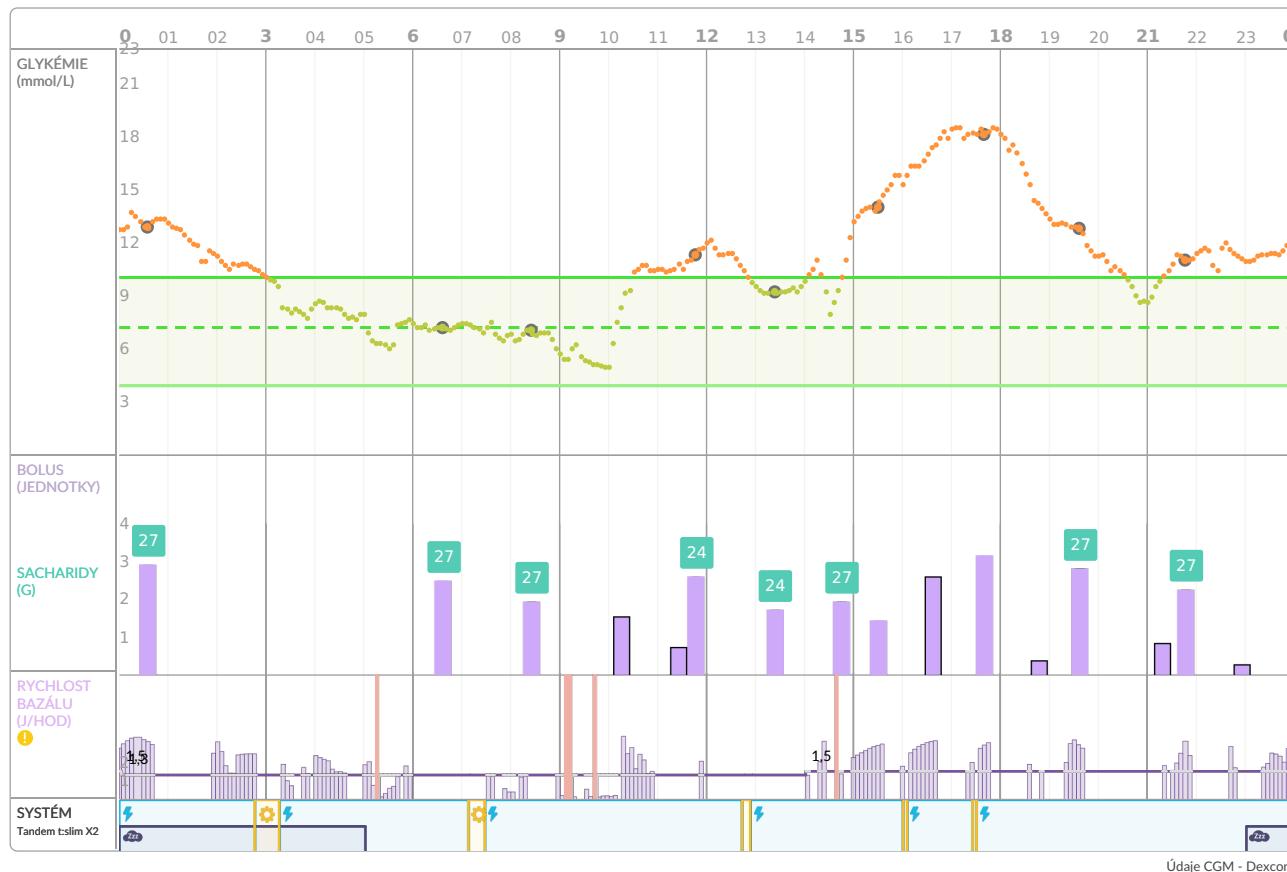

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 0:35	2 6:37	3 8:25	4 10:15	5 11:26	6 11:47	7 13:23	8 14:45	9 15:30	10 16:37
Podaný bolus	2,91	2,48	1,93	1,545	0,745	2,59	1,71	1,93	1,44	2,592
Doporučeno	2,91	2,48	1,93	1,545	0,745	2,59	1,71	1,93	1,44	2,592
Jídlo	1,93	1,93	1,93	-	-	1,71	1,71	1,93	-	-
Korekce	0,98	0,55	-	1,545	0,745	0,88	-	-	1,44	2,592
Aktivní inzulin	2,45	0	0,829	0	1,271	1,723	1,773	1,46	2,953	3,159
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou

- Hodhadované hodnoty ze zařízení CGM

- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

- Glukometr pumpy

- Přes 22.2

- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno

Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat

- Rozložený bolus

- Kombinovaný bolus

- Automatický bolus

- Podaný bolus

- Bazál

- Předmixovaný

- Vlastní

- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy

- Náplň nádobky

- Rychlosť bazálu

- Modulace bazálu

- Nepoužitý plánovaný bazál

- Dočasný bazál

- Nastavit a/nebo Změna pracoviště

- Pozastavit

- LGS/PLGS


Statistiky

	17. říj.	17. říj. - 15. listopadu
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	11,5	9,9
Medián glykémie	11,3	10
Hodnoty glykémie	9	217
Prům. CGM	10,7	8,6
Medián CGM	10,6	8,1
% CGM velmi vysoká	15%	4%
% CGM vysoká hodnota	45%	22%
% CGM cílové rozmezí	40%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	29,6 j	19,9 j
Bazál	38,4 j	33,1 j
Inzulin celkem	67,9 j	53 j
Počet bolusů	16	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (13)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	17. říj.	17. říj. - 15. listopadu
Control-IQ	95%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	5%	3%

18. 10. 2023

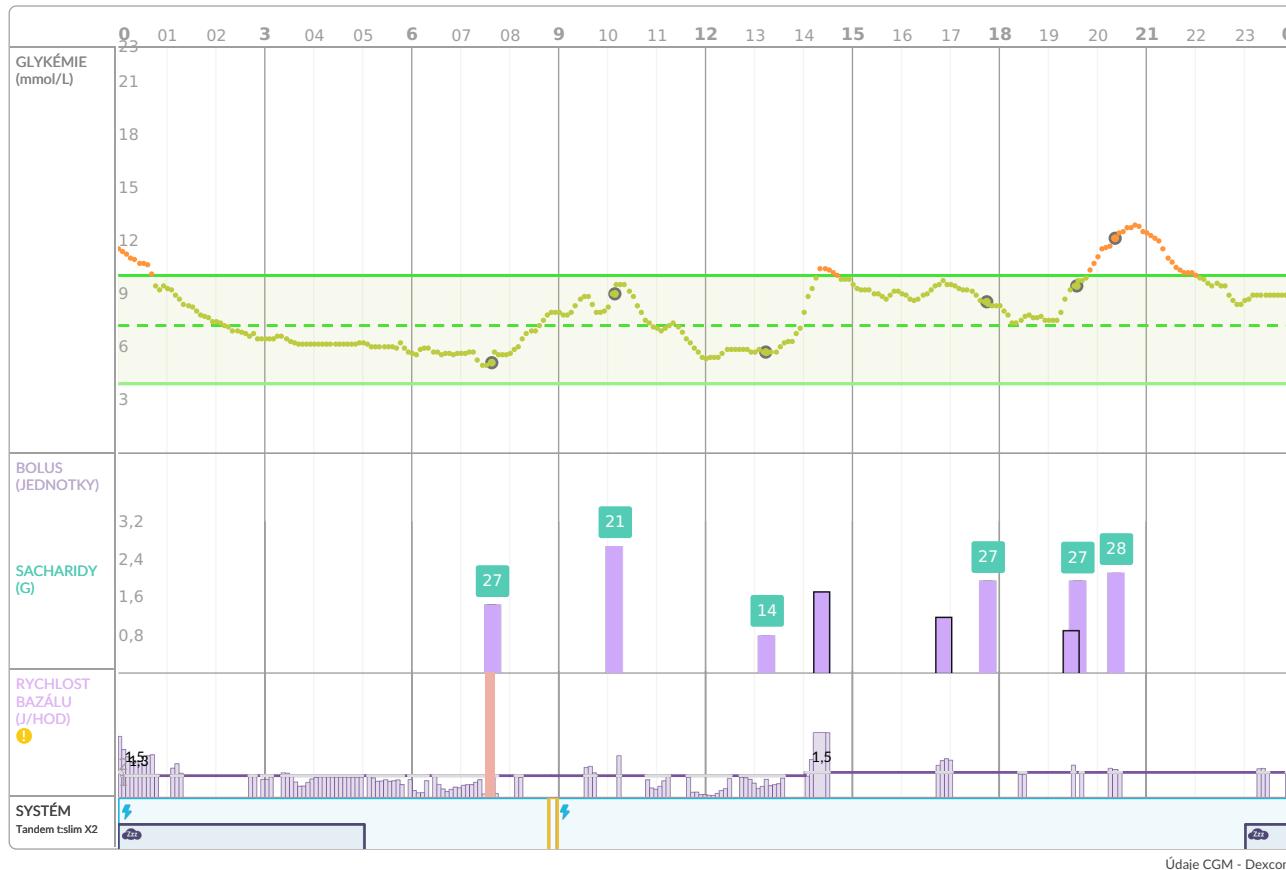**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 7:38	2 10:08	3 13:14	4 14:22	5 16:52	6 17:45	7 19:28	8 19:35	9 20:22	10
Podaný bolus	1,43	2,68	0,8	1,716	1,176	1,94	0,907	1,93	2,11	-
Doporučeno	1,43	2,68	0,8	1,716	1,176	1,94	0,907	1,93	2,11	-
Jídlo	1,43	1,5	0,8	-	-	1,93	-	1,93	2	-
Korekce	-	1,18	-	1,716	1,176	0,01	0,907	-	0,11	-
Aktivní inzulin	0	0,271	0	0,64	0,66	1,325	1,187	2,041	2,888	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou

Hodhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	18. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,3	9,9
Medián glykémie	8,8	10
Hodnoty glykémie	6	217
Prům. CGM	8	8,6
Medián CGM	7,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	14%	22%
% CGM cílové rozmezí	86%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	14,7 j	19,9 j
Bazál	32,3 j	33,1 j
Inzulin celkem	46,9 j	53 j
Počet bolusů	9	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (6)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	18. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	99%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	1%	3%

19. 10. 2023

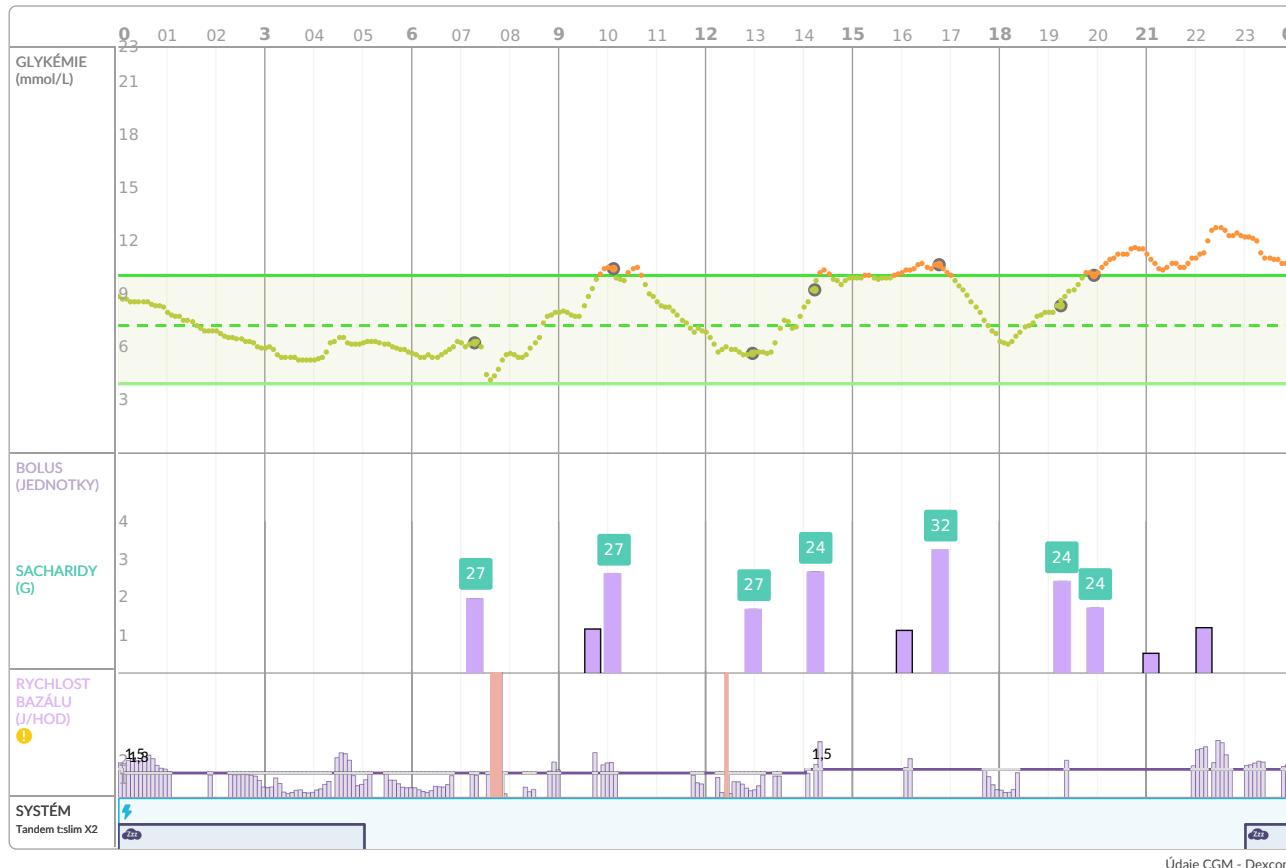

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 7:17	2 9:41	3 10:07	4 12:58	5 14:14	6 16:03	7 16:47	8 19:15	9 19:56	10 21:04
Podaný bolus	1,98	1,15	2,62	1,68	2,67	1,121	3,26	2,42	1,71	0,539
Doporučeno	1,98	1,15	2,62	1,68	2,67	1,121	3,26	2,42	1,71	0,539
Jídlo	1,93	-	1,93	1,68	1,71	-	2,29	1,71	1,71	-
Korekce	0,05	1,15	0,69	-	0,96	1,121	0,97	0,71	-	0,539
Aktivní inzulin	0	0,2	1,462	0	0,757	1,146	1,535	0,388	2,363	2,273
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	19. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,6	9,9
Medián glykémie	9,2	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8,1	8,6
Medián CGM	7,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	27%	22%
% CGM cílové rozmezí	73%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	20,3 j	19,9 j
Bazál	30,9 j	33,1 j
Inzulin celkem	51,2 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (9)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	19. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

20. 10. 2023

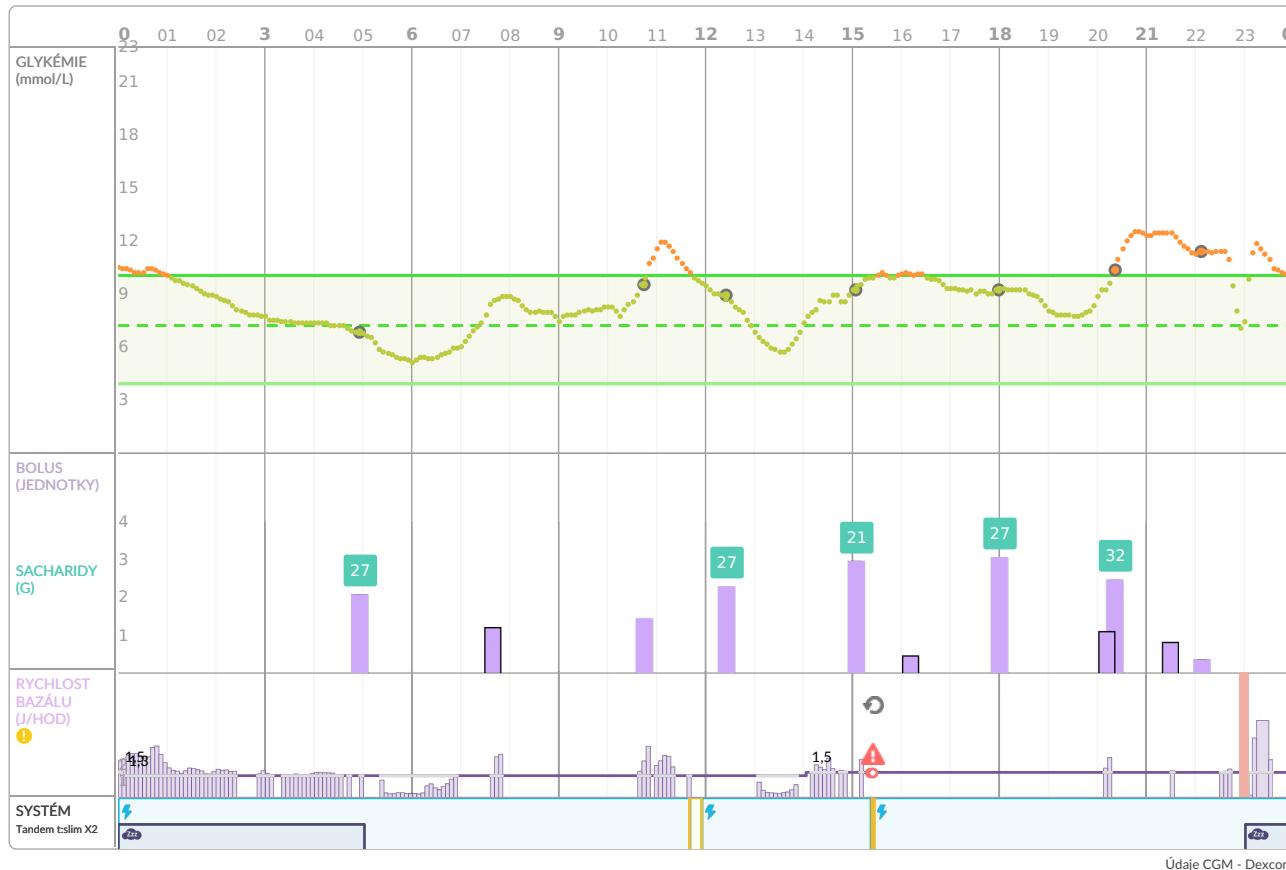

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 4:56	2 7:41	3 10:45	4 12:25	5 15:04	6 16:10	7 18:00	8 20:11	9 20:21	10 21:28
Podaný bolus	2,07	1,183	1,44	2,28	2,94	0,472	3,05	1,096	2,46	0,817
Doporučeno	2,07	1,183	1,44	2,28	2,94	0,472	3,05	1,096	2,46	0,817
Jídlo	1,93	-	-	1,93	1,5	-	1,93	-	2,29	-
Korekce	0,14	1,183	1,44	0,35	1,44	0,472	1,12	1,096	0,17	0,817
Aktivní inzulin	0,206	0	0,259	1,05	0,277	2,346	0,599	0,92	1,931	2,735
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

Control-IQ

Aktivita - fyzická aktivita

Aktivita - spánek

Manuální

Typy hodnot

Pod cílovou hodnotou

V rozmezí

Nad cílovou hodnotou

Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno

Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

Přepsat

Rozložený bolus

Kombinovaný bolus

Automatický bolus

Podaný bolus

Bazál

Předmixovaný

Vlastní

Sachardy

Bazál

Výstraha pumpy

Náplň nádobky

Rychlosť bazálu

Modulace bazálu

Nepoužitý plánovaný bazál

Dočasný bazál

Nastavít a/nebo Změna pracoviště

Pozastavit

LGS/PLGS


Statistiky

	20. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,3	9,9
Medián glykémie	9,2	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8,7	8,6
Medián CGM	8,8	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	25%	22%
% CGM cílové rozmezí	75%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	18,2 j	19,9 j
Bazál	34,9 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,1 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,7 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	100% (11)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	20. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	99%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	1%	3%

21. 10. 2023

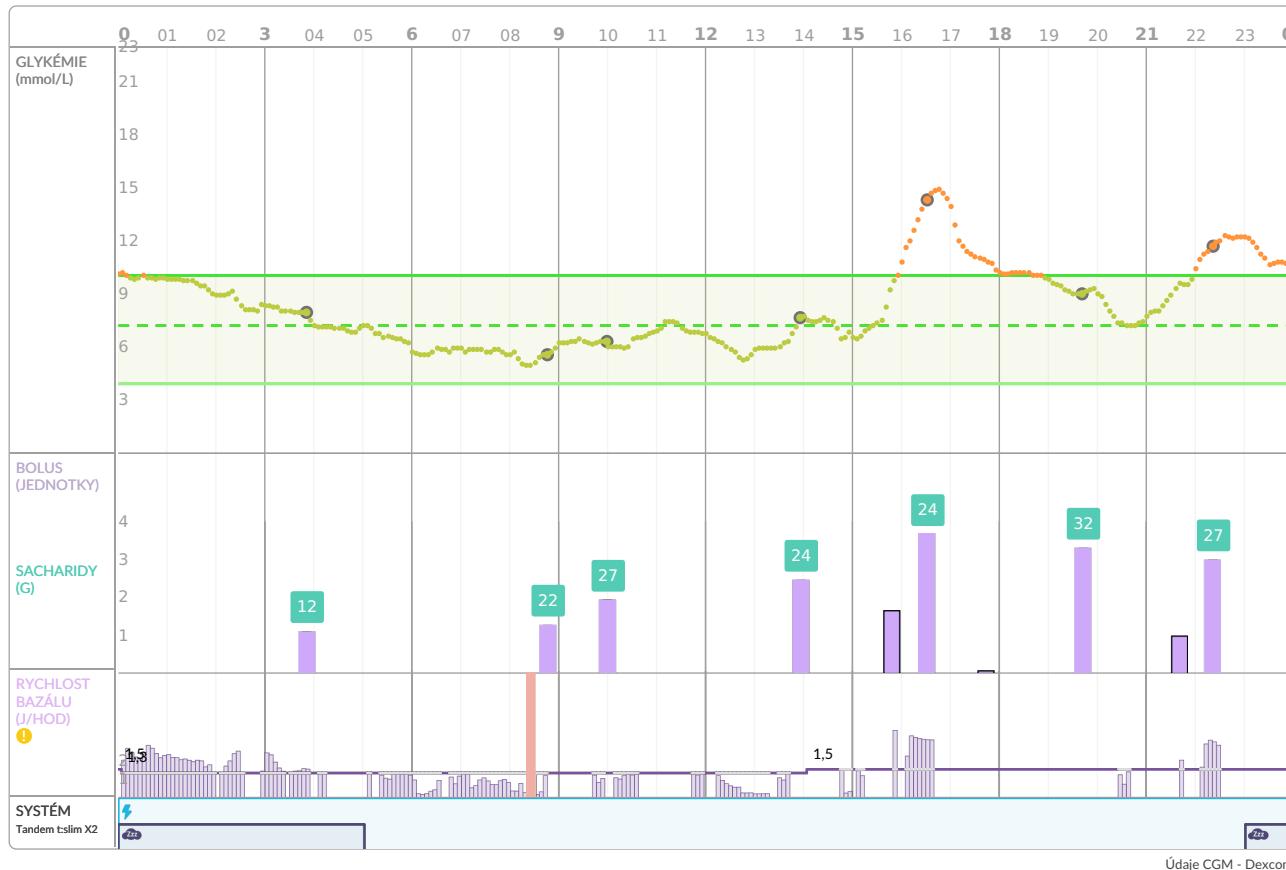

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 3:51	2 8:46	3 10:00	4 13:56	5 15:49	6 16:31	7 17:44	8 19:42	9 21:40	10 22:21
Podaný bolus	1,1	1,27	1,93	2,46	1,652	3,67	0,072	3,31	0,973	3
Doporučeno	1,1	1,27	1,93	2,46	1,652	3,67	0,072	3,31	0,973	3
Jídlo	0,86	1,27	1,93	1,71	-	1,71	-	2,29	-	1,93
Korekce	0,24	-	-	0,75	1,652	1,96	0,072	1,02	0,973	1,07
Aktivní inzulin	0,663	0	0,367	0	0,687	2,6	3,793	0,433	1,176	1,778
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	21. říj.	17. říj. - 15. listopad.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,9	9,9
Medián glykémie	7,9	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8,2	8,6
Medián CGM	7,5	8,1
% CGM velmi vysoká	2%	4%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	78%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	19,4 j	19,9 j
Bazál	33,8 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,2 j	53 j
Počet bolusů	10	12,2
Prům. Bolus	1,9 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	80% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	21. říj.	17. říj. - 15. listopad.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

22. 10. 2023

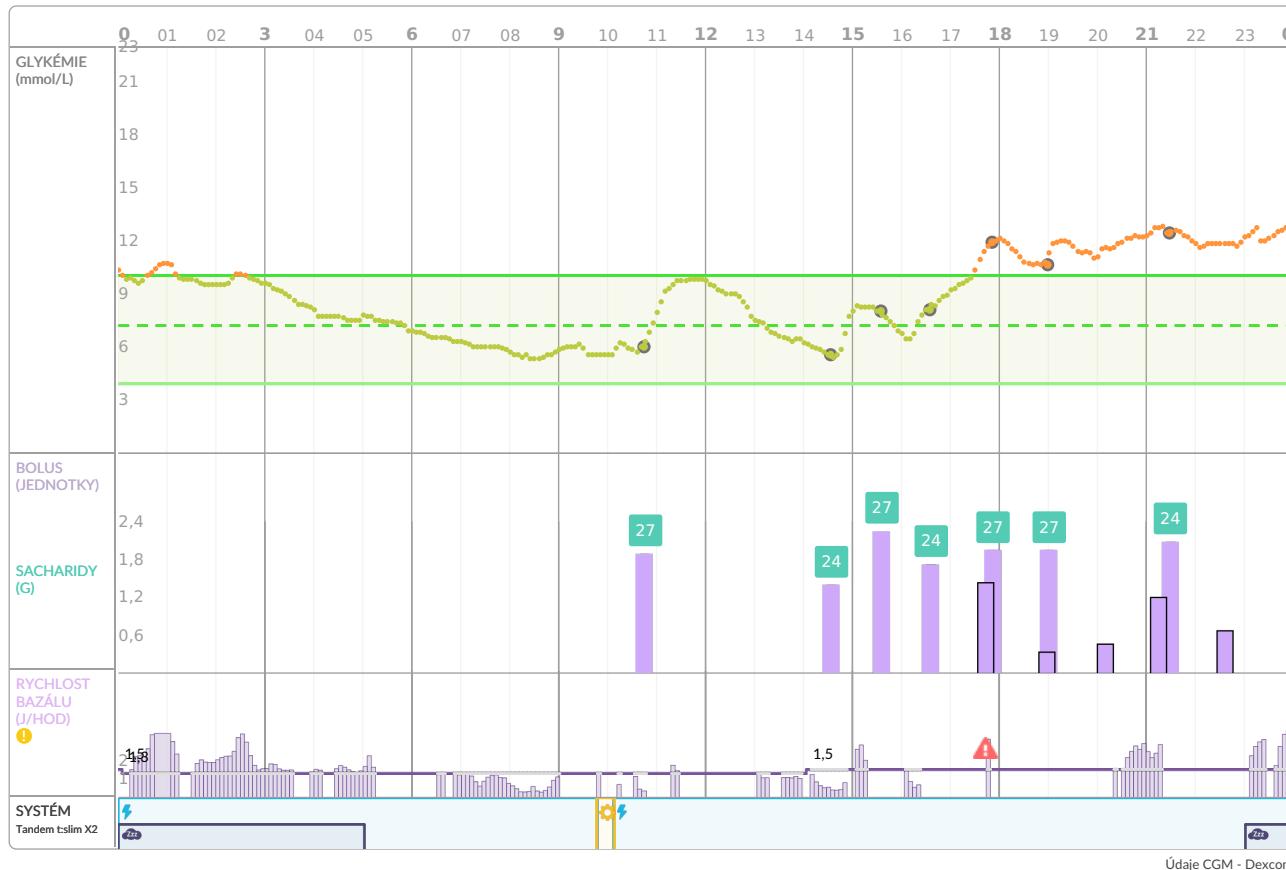

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 10:45	2 14:33	3 15:35	4 16:35	5 17:43	6 17:51	7 18:59	8 19:00	9 20:09	10 21:14
Podaný bolus	1,88	1,38	2,24	1,71	1,44	1,93	0,343	1,93	0,473	1,191
Doporučeno	1,88	1,38	2,24	1,71	1,44	1,93	0,343	1,93	0,473	1,191
Jídlo	1,88	1,38	1,93	1,71	-	1,93	-	1,93	-	-
Korekce	-	-	0,31	-	1,44	-	0,343	-	0,473	1,191
Aktivní inzulin	0	0	0,755	1,86	1,946	3,256	2,957	3,3	2,56	1,845
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	22. říj.	17. říj. - 15. listopad.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,9	9,9
Medián glykémie	8,1	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8,8	8,6
Medián CGM	8,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	32%	22%
% CGM cílové rozmezí	68%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	17,3 j	19,9 j
Bazál	36,2 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,5 j	53 j
Počet bolusů	12	12,2
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (7)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	22. říj.	17. říj. - 15. listopad.
Control-IQ	99%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	1%	3%

23. 10. 2023

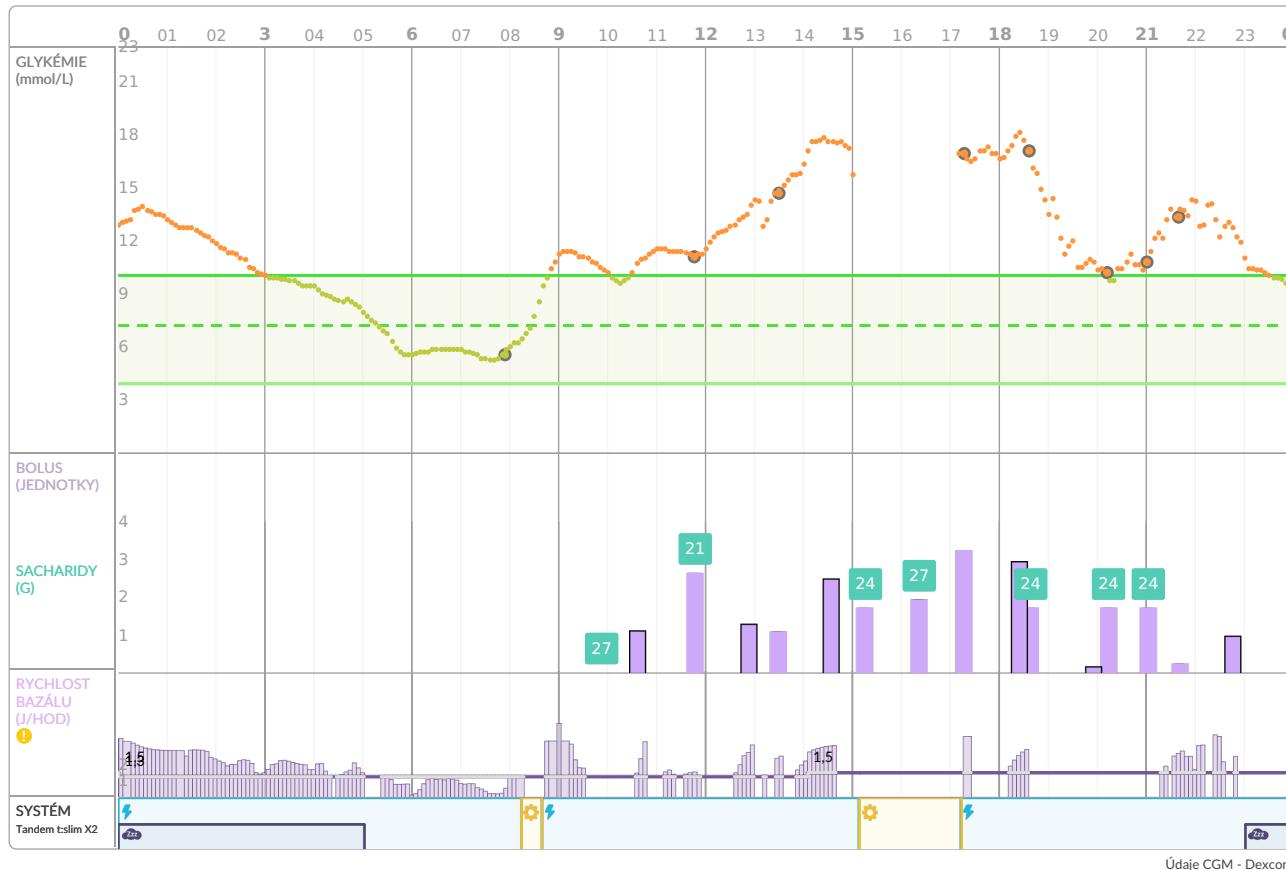

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 9:51	2 10:37	3 11:46	4 12:54	5 13:30	6 14:34	7 15:15	8 16:21	9 17:16	10 18:24
Podaný bolus	0	1,129	2,64	1,304	1,1	2,475	1,71	1,93	3,23	2,935
Doporučeno	0	1,129	2,64	1,304	1,1	2,475	1,71	1,93	3,23	2,935
Jídlo	-	-	1,5	-	-	-	1,71	1,93	-	-
Korekce	-	1,129	1,14	1,304	1,1	2,475	-	-	3,23	2,935
Aktivní inzulin	-	0,7	1,357	2,737	3,203	3,108	4,173	2,953	2,772	3,697
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	23. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	12,4	9,9
Medián glykémie	12,2	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	11,4	8,6
Medián CGM	11,2	8,1
% CGM velmi vysoká	20%	4%
% CGM vysoká hodnota	49%	22%
% CGM cílové rozmezí	31%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	25 j	19,9 j
Bazál	42,9 j	33,1 j
Inzulin celkem	67,9 j	53 j
Počet bolusů	16	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (10)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	23. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	90%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	10%	3%

24. 10. 2023

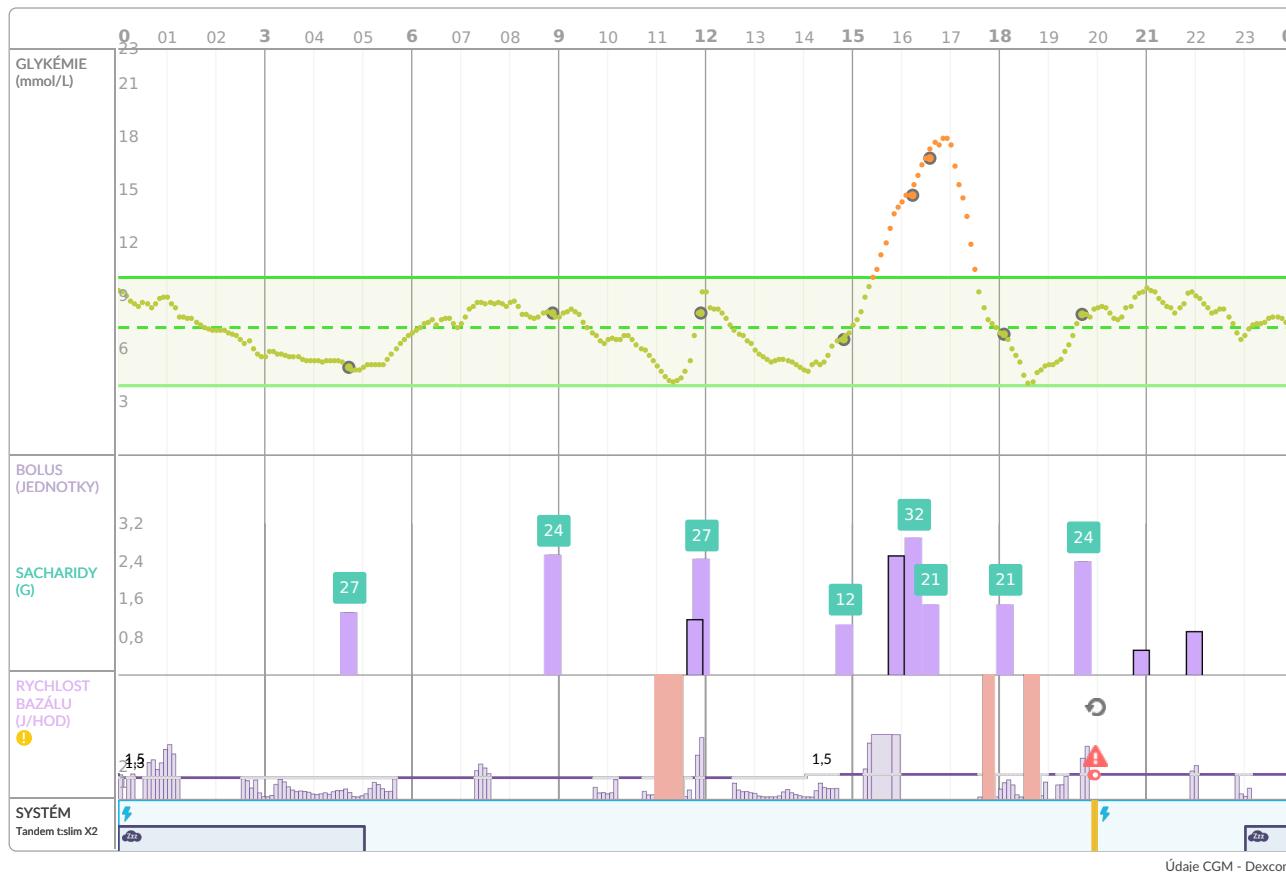

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 4:43	2 8:53	3 11:47	4 11:54	5 14:50	6 15:53	7 16:14	8 16:35	9 18:06	10 19:42
Podaný bolus	1,33	2,54	1,187	2,44	1,08	2,54	2,88	1,5	1,5	2,4
Doporučeno	1,33	2,54	1,187	2,44	1,08	2,54	2,88	1,5	1,5	2,4
Jídlo	1,33	1,71	-	1,93	0,86	-	2,29	1,5	1,5	1,71
Korekce	-	0,83	1,187	0,51	0,22	2,54	0,59	-	-	0,69
Aktivní inzulin	0	0,116	0	0,443	0	1,642	4,187	6,563	2,546	0,207
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	24. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,2	9,9
Medián glykémie	8	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	7,6	8,6
Medián CGM	7,4	8,1
% CGM velmi vysoká	6%	4%
% CGM vysoká hodnota	3%	22%
% CGM cílové rozmezí	91%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	20,9 j	19,9 j
Bazál	28,3 j	33,1 j
Inzulin celkem	49,1 j	53 j
Počet bolusů	12	12,2
Prům. Bolus	1,7 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	75% (9)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	24. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

25. 10. 2023

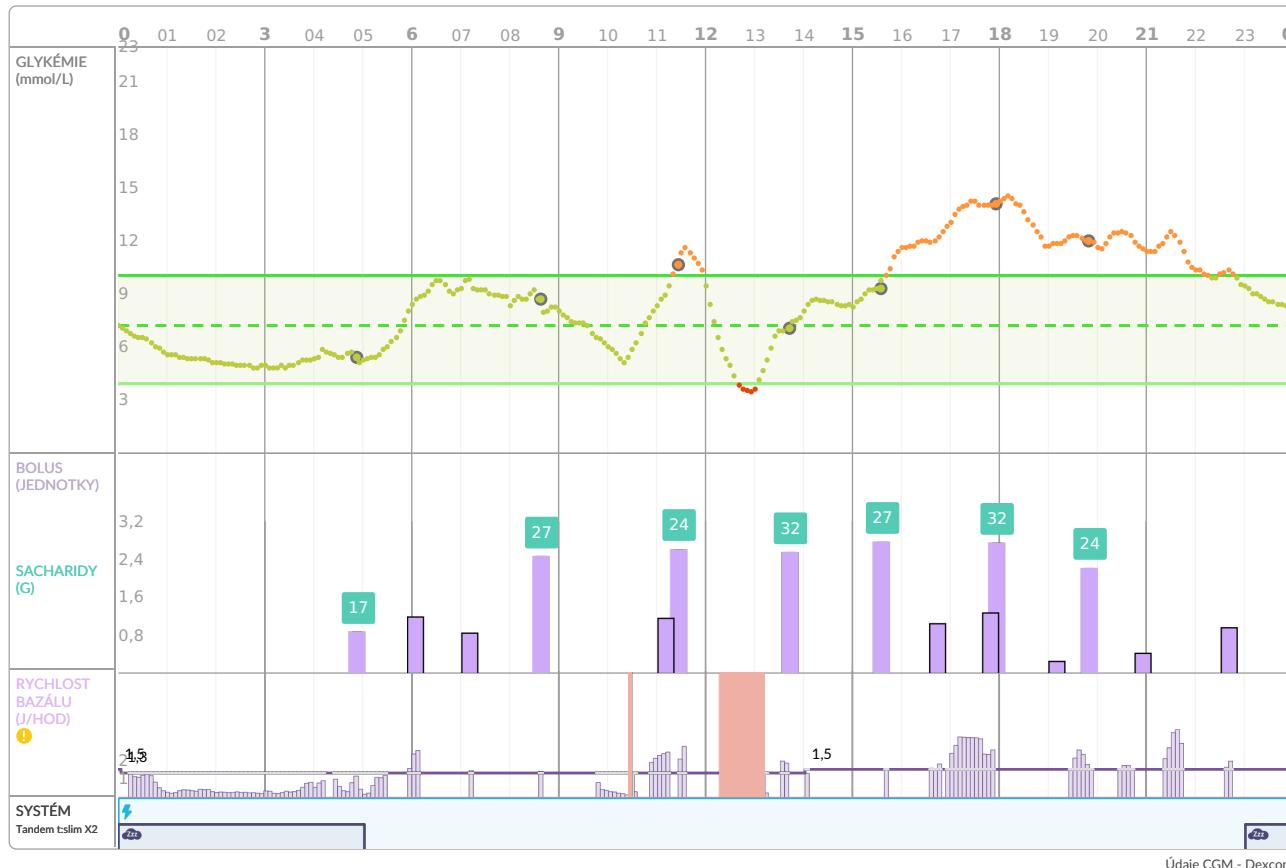


Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 4:53	2 6:05	3 7:10	4 8:38	5 11:11	6 11:26	7 13:43	8 15:36	9 16:43	10 17:48
Podaný bolus	0,86	1,167	0,836	2,46	1,157	2,62	2,55	2,77	1,035	1,268
Doporučeno	0,86	1,167	0,836	2,46	1,157	2,62	2,55	2,77	1,035	1,268
Jídlo	0,86	-	-	1,93	-	1,71	2,29	1,93	-	-
Korekce	-	1,167	0,836	0,53	1,157	0,91	0,26	0,84	1,035	1,268
Aktivní inzulin	0	0,01	1,007	0,725	0,166	1,342	0,136	0,936	2,307	2,771
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)



Typy hodnot



Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno

Nepodáno

Segment bazálu, který v dobu stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

Prepsat

Rozložený bolus

Kombinovaný bolus

Automatický bolus

Podaný bolus

Bazál

Předmixovaný

Vlastní

Sachardy

Bazál

Výstraha pumpy

Náplň nádobky

Rychlosť bazálu

Modulace bazálu

Nepoužitý plánovaný bazál

Dočasný bazál

Nastavit a/nebo Změna pracoviště

Pozastavit

LGS/PLGS


Statistiky

	25. říj.	17. říj. - 15. lis.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,6	9,9
Medián glykémie	9,3	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8,6	8,6
Medián CGM	8,6	8,1
% CGM velmi vysoká	5%	4%
% CGM vysoká hodnota	27%	22%
% CGM cílové rozmezí	66%	74%
% CGM nízká hodnota	2%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	23,3 j	19,9 j
Bazál	30,1 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,4 j	53 j
Počet bolusů	15	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (14)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	25. říj.	17. říj. - 15. lis.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

26. 10. 2023

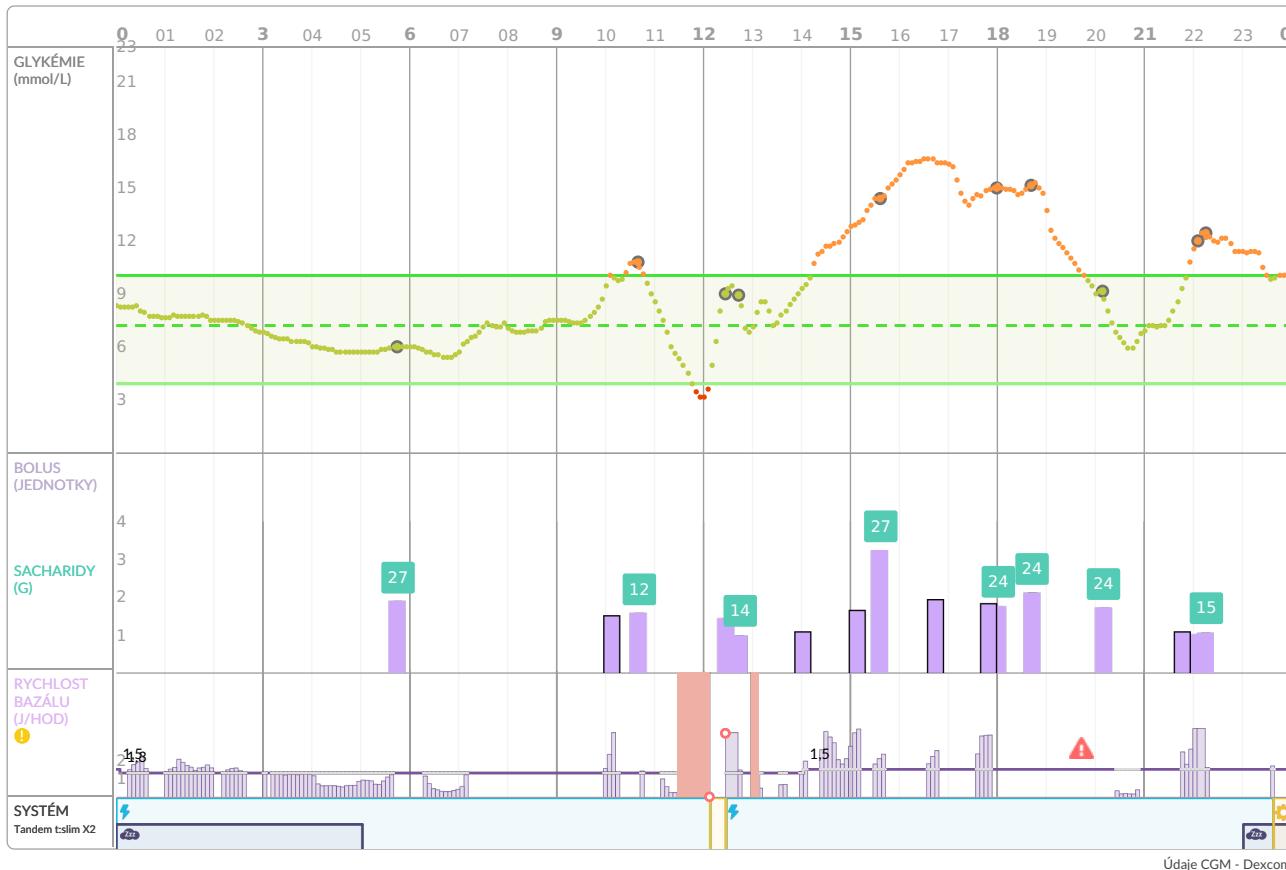

Údaje CGM - Dexcom

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:44	2 10:07	3 10:40	4 12:27	5 12:44	6 14:02	7 15:08	8 15:36	9 16:43	10 17:48
Podaný bolus	1,88	1,513	1,57	1,45	1	1,082	1,663	3,24	1,93	1,831
Doporučeno	1,88	1,513	1,57	1,45	1	1,082	1,663	3,24	1,93	1,831
Jídlo	1,88	-	0,86	-	1	-	-	1,93	-	-
Korekce	-	1,513	0,71	1,45	-	1,082	1,663	1,31	1,93	1,831
Aktivní inzulin	0	0,085	1,639	0	1,611	1,04	2,018	3,299	4,005	3,315
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	26. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	11,3	9,9
Medián glykémie	11,4	10
Hodnoty glykémie	10	217
Prům. CGM	9,1	8,6
Medián CGM	7,8	8,1
% CGM velmi vysoká	15%	4%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	66%	74%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	25,9 j	19,9 j
Bazál	33,2 j	33,1 j
Inzulin celkem	59,2 j	53 j
Počet bolusů	16	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	75% (12)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	26. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	97%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	3%	3%

27. 10. 2023

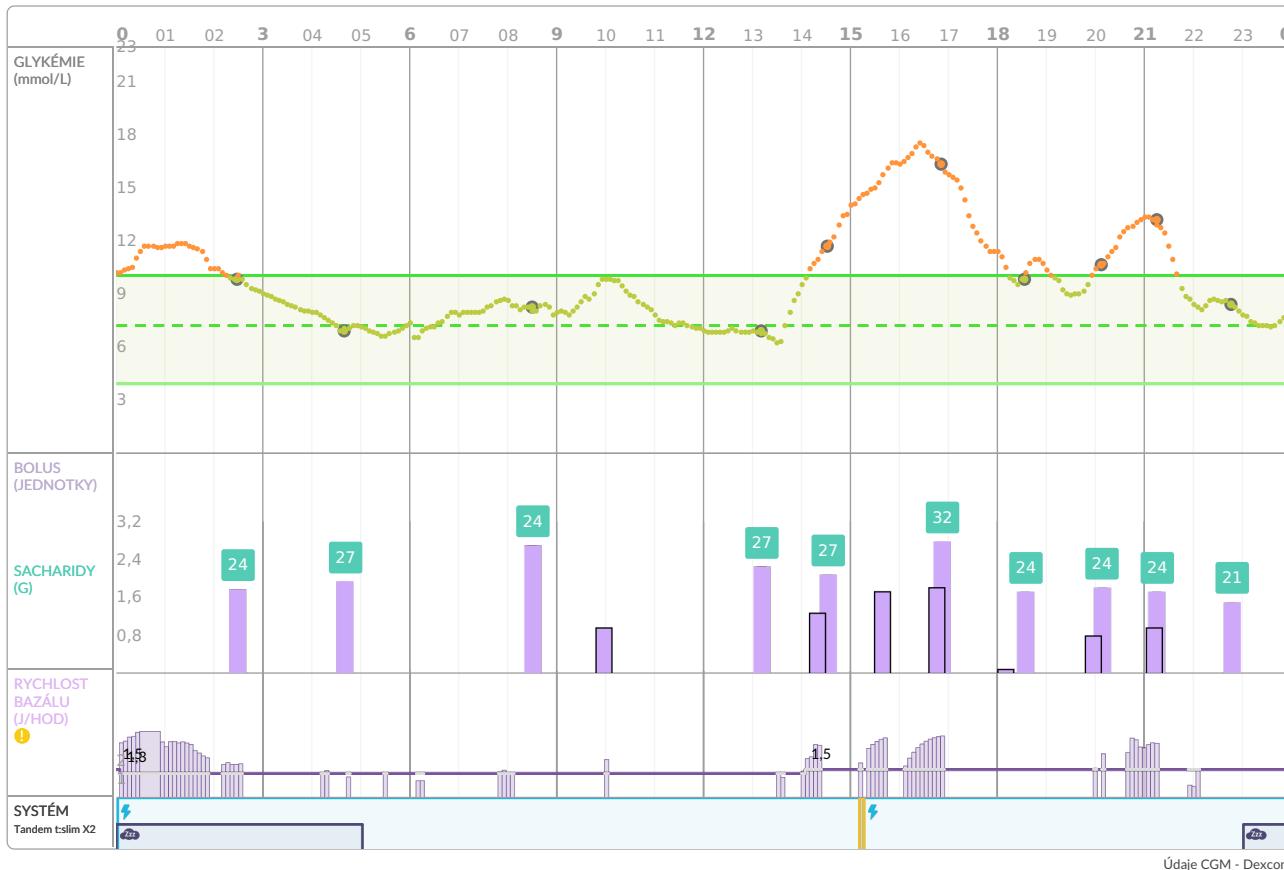

Údaje CGM - Dexcom

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 2:28	2 4:40	3 8:30	4 9:58	5 13:10	6 14:19	7 14:32	8 15:39	9 16:44	10 16:52
Podaný bolus	1,77	1,93	2,7	0,957	2,24	1,272	2,08	1,703	1,787	2,78
Doporučeno	1,77	1,93	2,7	0,957	2,24	1,272	2,08	1,703	1,787	2,78
Jídlo	1,71	1,93	1,71	-	1,93	-	1,93	-	-	2,29
Korekce	0,06	-	0,99	0,957	0,31	1,272	0,15	1,703	1,787	0,49
Aktivní inzulin	1,795	0,699	0,059	1,568	0,076	1,846	2,959	3,47	3,469	5,178
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Statistiky

	27. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	10,2	9,9
Medián glykémie	9,8	10
Hodnoty glykémie	10	217
Prům. CGM	9,7	8,6
Medián CGM	8,8	8,1
% CGM velmi vysoká	10%	4%
% CGM vysoká hodnota	27%	22%
% CGM cílové rozmezí	63%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	27,8 j	19,9 j
Bazál	39,4 j	33,1 j
Inzulin celkem	67,1 j	53 j
Počet bolusů	17	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (13)	77% (9,4)

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy


Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS

Podrobnosti systému

	27. říj.	17. říj. - 15. lis.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

28. 10. 2023

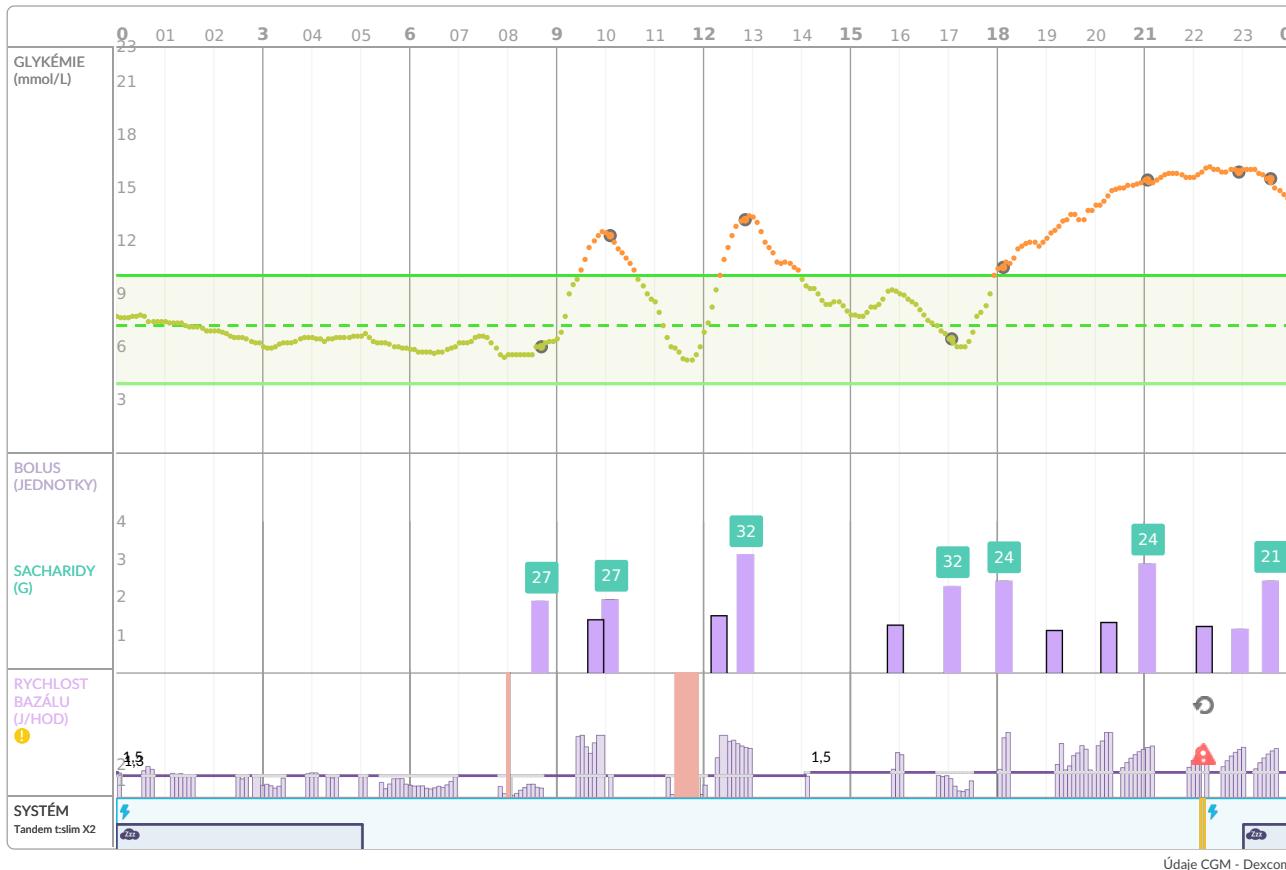

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 8:41	2 9:49	3 10:06	4 12:19	5 12:51	6 15:55	7 17:04	8 18:07	9 19:10	10 20:15
Podaný bolus	1,88	1,388	1,93	1,519	3,11	1,278	2,29	2,42	1,125	1,344
Doporučeno	1,88	1,388	1,93	1,519	3,11	1,278	2,29	2,42	1,125	1,344
Jídlo	1,88	-	1,93	-	2,29	-	2,29	1,71	-	-
Korekce	-	1,388	-	1,519	0,82	1,278	-	0,71	1,125	1,344
Aktivní inzulin	0	1,801	3,375	0,456	2,73	0,576	0,96	1,732	2,65	2,918
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	28. říj.	17. říj. - 15. lis.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	11,9	9,9
Medián glykémie	12,8	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	9,4	8,6
Medián CGM	8	8,1
% CGM velmi vysoká	17%	4%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	63%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	26 j	19,9 j
Bazál	37,3 j	33,1 j
Inzulin celkem	63,3 j	53 j
Počet bolusů	14	12,2
Prům. Bolus	1,9 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (11)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	28. říj.	17. říj. - 15. lis.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

29. 10. 2023

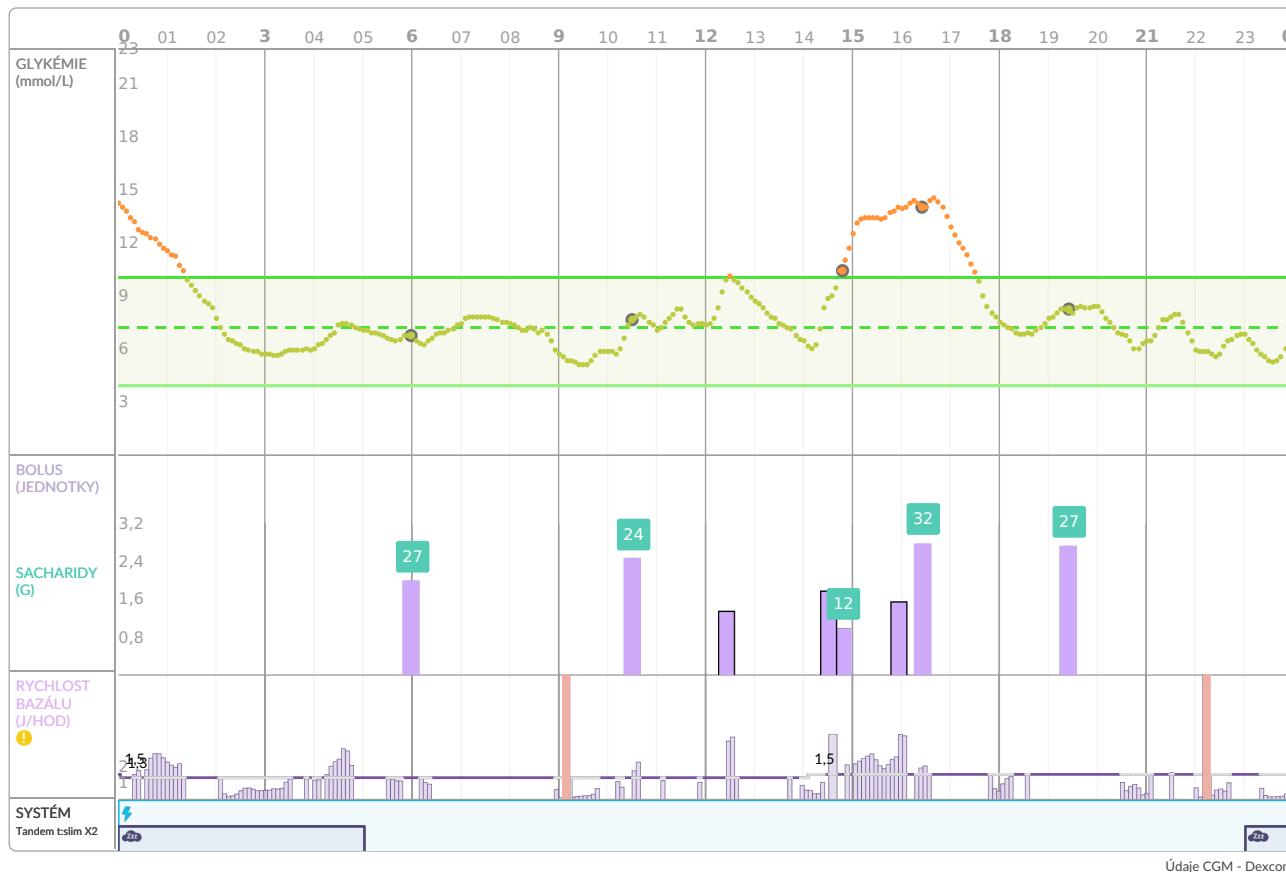

Bolusy pumpy


Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 6:00	2 10:31	3 12:25	4 14:30	5 14:48	6 15:56	7 16:25	8 19:24	9	10
Podaný bolus	1,99	2,46	1,348	1,782	0,99	1,538	2,79	2,73	-	-
Doporučeno	1,99	2,46	1,348	1,782	0,99	1,538	2,79	2,73	-	-
Jídlo	1,93	1,71	-	-	0,86	-	2,29	1,93	-	-
Korekce	0,06	0,75	1,348	1,782	0,13	1,538	0,5	0,8	-	-
Aktivní inzulin	0,237	0	0,903	0,255	2,259	2,857	3,888	0,249	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)



Typy hodnot



Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno


Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu



Bazál




Statistiky

	29. říj.	17. říj. - 15. lis.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,4	9,9
Medián glykémie	8,2	10
Hodnoty glykémie	5	217
Prům. CGM	8,1	8,6
Medián CGM	7,3	8,1
% CGM velmi vysoká	5%	4%
% CGM vysoká hodnota	13%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	15,6 j	19,9 j
Bazál	32 j	33,1 j
Inzulin celkem	47,7 j	53 j
Počet bolusů	8	12,2
Prům. Bolus	2 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	100% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	29. říj.	17. říj. - 15. lis.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

30. 10. 2023

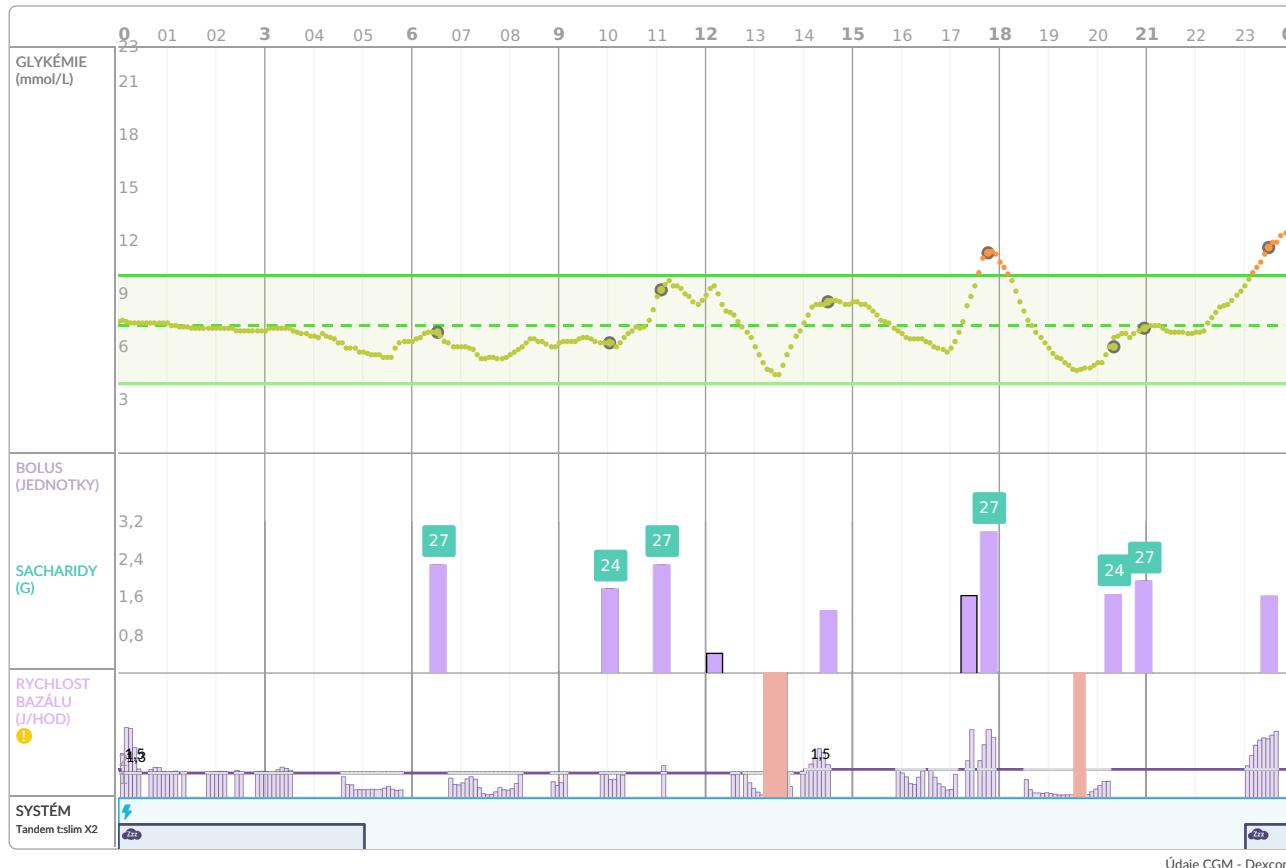

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 6:32	2 10:02	3 11:06	4 12:10	5 14:30	6 17:23	7 17:46	8 20:20	9 20:57	10 23:31
Podaný bolus	2,28	1,76	2,28	0,426	1,33	1,64	2,98	1,66	1,93	1,64
Doporučeno	2,28	1,76	2,28	0,426	1,33	1,64	2,98	1,66	1,93	1,64
Jídlo	1,93	1,71	1,93	-	-	-	1,93	1,66	1,93	-
Korekce	0,35	0,05	0,35	0,426	1,33	1,64	1,05	-	-	1,64
Aktivní inzulin	0	0	1,201	2,2	0	0	1,841	0	0,863	1,111
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou

Hodhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	30. říj.	17. říj. - 15. lis.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,3	9,9
Medián glykémie	7,8	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	7,1	8,6
Medián CGM	6,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	6%	22%
% CGM cílové rozmezí	94%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	17,9 j	19,9 j
Bazál	30 j	33,1 j
Inzulin celkem	47,9 j	53 j
Počet bolusů	10	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	80% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	30. říj.	17. říj. - 15. lis.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

31. 10. 2023

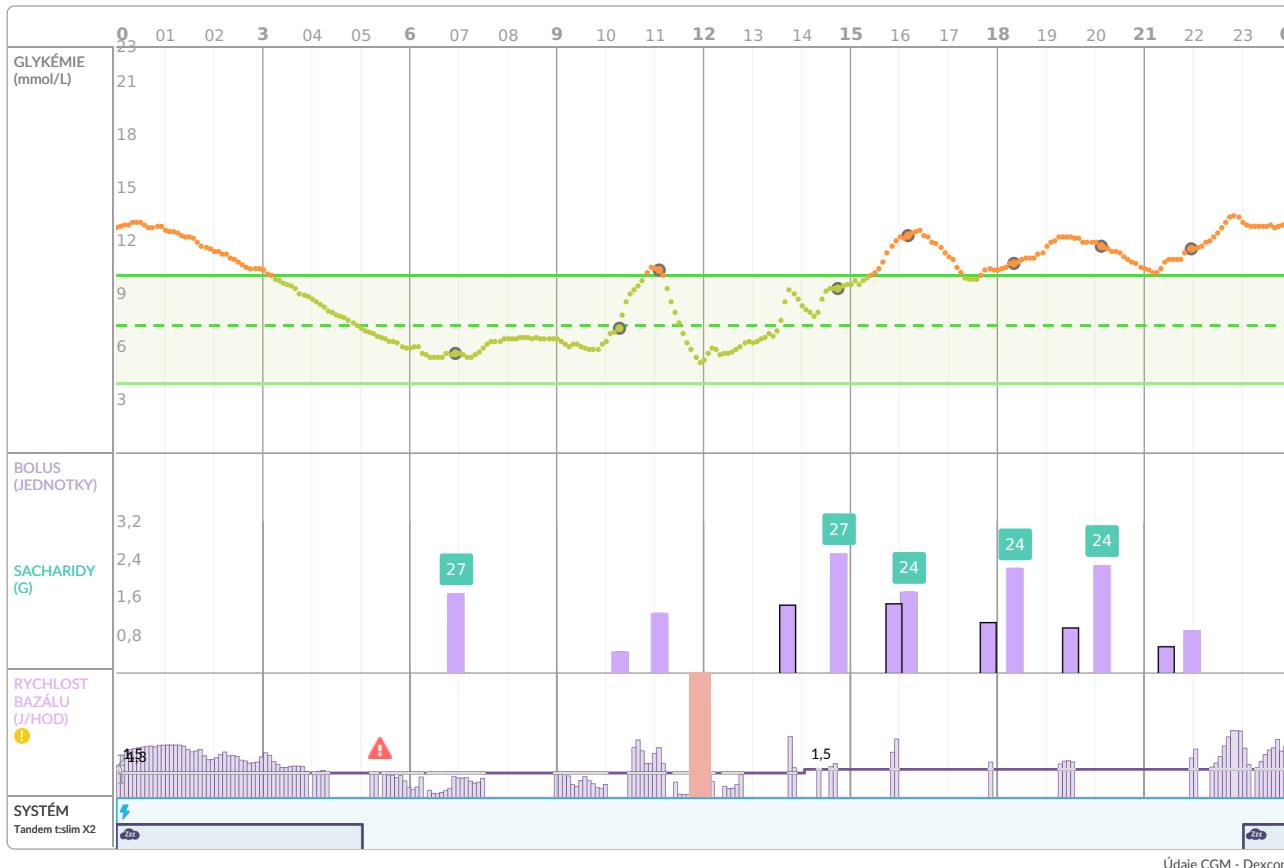

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 6:56	2 10:17	3 11:06	4 13:43	5 14:45	6 15:54	7 16:11	8 17:49	9 18:21	10 19:29
Podaný bolus	1,68	0,45	1,27	1,439	2,53	1,449	1,71	1,069	2,21	0,941
Doporučeno	1,68	0,45	1,27	1,439	2,53	1,449	1,71	1,069	2,21	0,941
Jídlo	1,68	-	-	-	1,93	-	1,71	-	1,71	-
Korekce	-	0,45	1,27	1,439	0,6	1,449	-	1,069	0,5	0,941
Aktivní inzulin	0	0	0,825	0	1,177	2,389	3,429	1,799	1,934	2,415
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Statistiky

	31. říj.	17. říj. - 15. list.
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,8	9,9
Medián glykémie	10,5	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	9,4	8,6
Medián CGM	9,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	50%	22%
% CGM cílové rozmezí	50%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	18,5 j	19,9 j
Bazál	37,6 j	33,1 j
Inzulin celkem	56,1 j	53 j
Počet bolusů	13	12,2
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (11)	77% (9,4)

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22,2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22,2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy


Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS

Podrobnosti systému

	31. říj.	17. říj. - 15. list.
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

1. 11. 2023

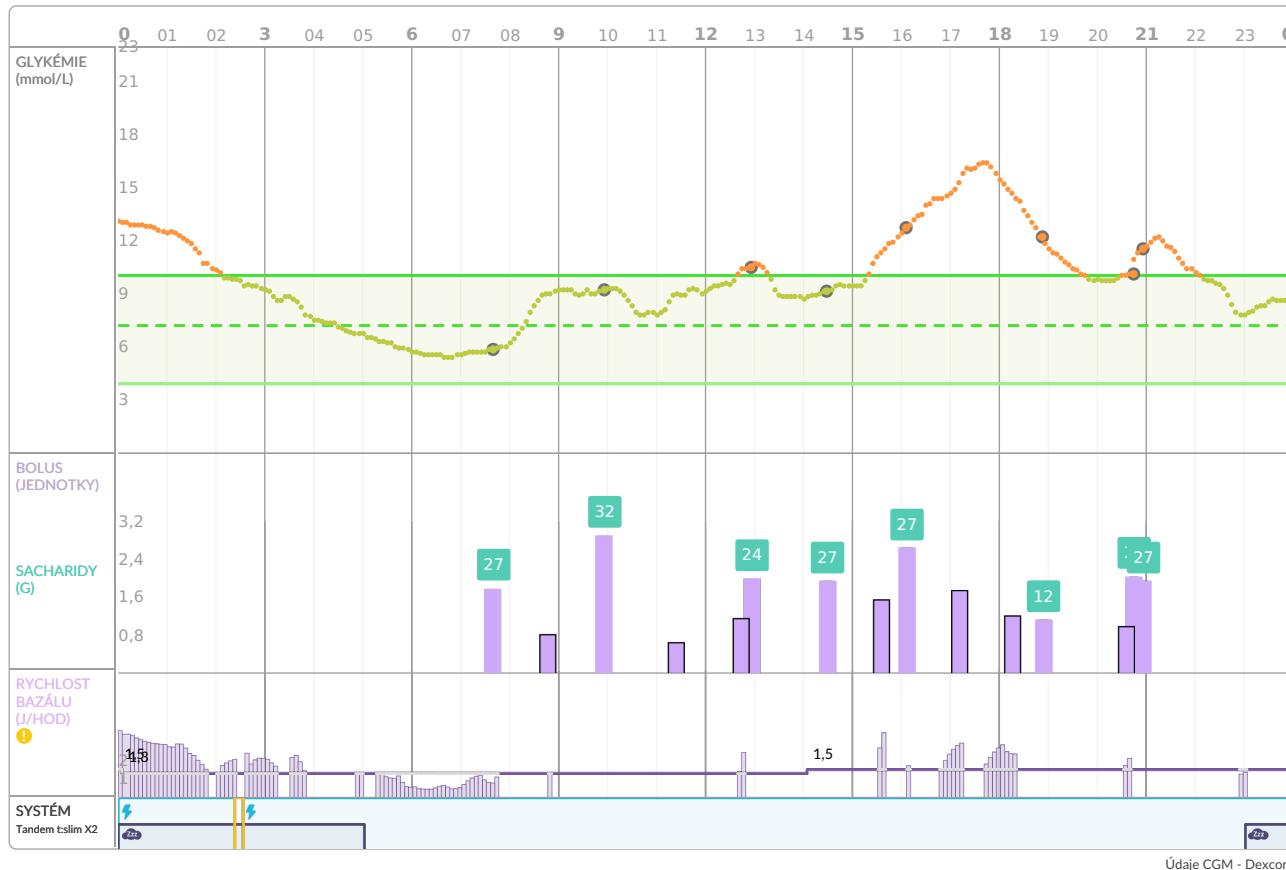

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 7:39	2 8:46	3 9:55	4 11:23	5 12:43	6 12:56	7 14:28	8 15:36	9 16:06	10 17:11
Podaný bolus	1,78	0,819	2,9	0,634	1,14	1,98	1,93	1,555	2,63	1,754
Doporučeno	1,78	0,819	2,9	0,634	1,14	1,98	1,93	1,555	2,63	1,754
Jídlo	1,78	-	2,29	-	-	1,71	1,93	-	1,93	-
Korekce	-	0,819	0,61	0,634	1,14	0,27	-	1,555	0,7	1,754
Aktivní inzulin	0	0,906	0,938	1,797	0,822	1,932	1,688	2,034	2,969	3,51
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	1. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	10,1	9,9
Medián glykémie	10,3	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	9,7	8,6
Medián CGM	9,4	8,1
% CGM velmi vysoká	8%	4%
% CGM vysoká hodnota	29%	22%
% CGM cílové rozmezí	63%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	24,4 j	19,9 j
Bazál	36,8 j	33,1 j
Inzulin celkem	61,1 j	53 j
Počet bolusů	15	12,2
Prům. Bolus	1,6 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	80% (12)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	1. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	99%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	1%	3%

2. 11. 2023

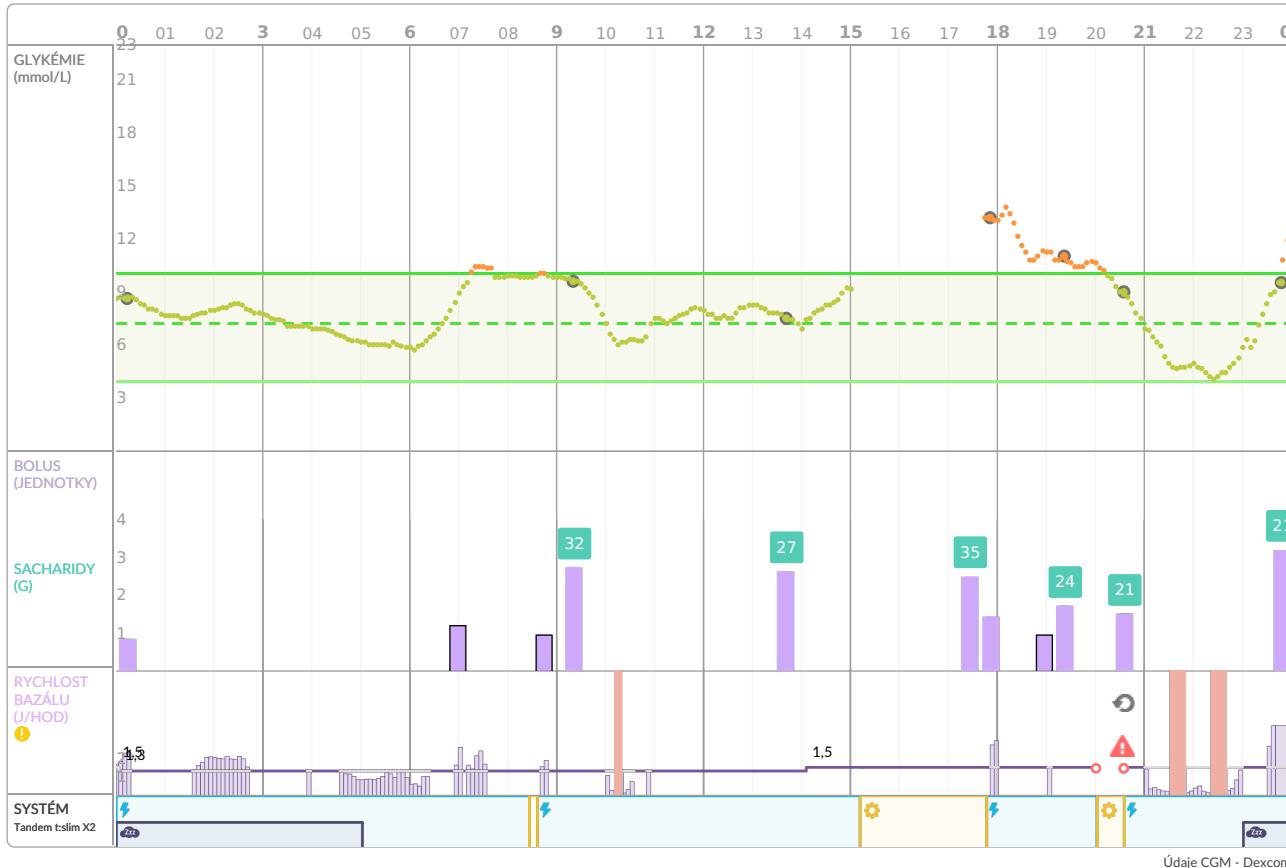

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 0:14	2 6:59	3 8:44	4 9:21	5 13:41	6 17:26	7 17:51	8 18:56	9 19:22	10 20:35
Podaný bolus	0,84	1,177	0,96	2,73	2,63	2,5	1,44	0,935	1,71	1,5
Doporučeno	0,84	1,177	0,96	2,73	2,63	2,5	1,44	0,935	1,71	1,5
Jídlo	-	-	-	2,29	1,93	2,5	-	-	1,71	1,5
Korekce	0,84	1,177	0,96	0,44	0,7	-	1,44	0,935	-	-
Aktivní inzulin	0,41	0	0,672	1,254	0	0,09	2,342	2,484	2,678	1,538
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

Control-IQ

Aktivita - fyzická aktivita

Aktivita - spánek

Manuální

Typy hodnot

Pod cílovou hodnotou

V rozmezí

Nad cílovou hodnotou

Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno

Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

Přepsat

Rozložený bolus

Kombinovaný bolus

Automatický bolus

Podaný bolus

Bazál

Předmixovaný

Vlastní

Sacharidy

Bazál

Výstraha pumpy

Náplň nádobky

Rychlosť bazálu

Modulace bazálu

Nepoužitý plánovaný bazál

Dočasný bazál

Nastavít a/nebo Změna pracoviště

Pozastavit

LGS/PLGS


Statistiky

	2. LIS	17. říj - 15. lis
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,8	9,9
Medián glykémie	9,5	10
Hodnoty glykémie	7	217
Prům. CGM	8	8,6
Medián CGM	7,8	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	16%	22%
% CGM cílové rozmezí	84%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	19,6 j	19,9 j
Bazál	31,2 j	33,1 j
Inzulin celkem	50,9 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	2. LIS	17. říj - 15. LIS
Control-IQ	86%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	14%	3%

3. 11. 2023

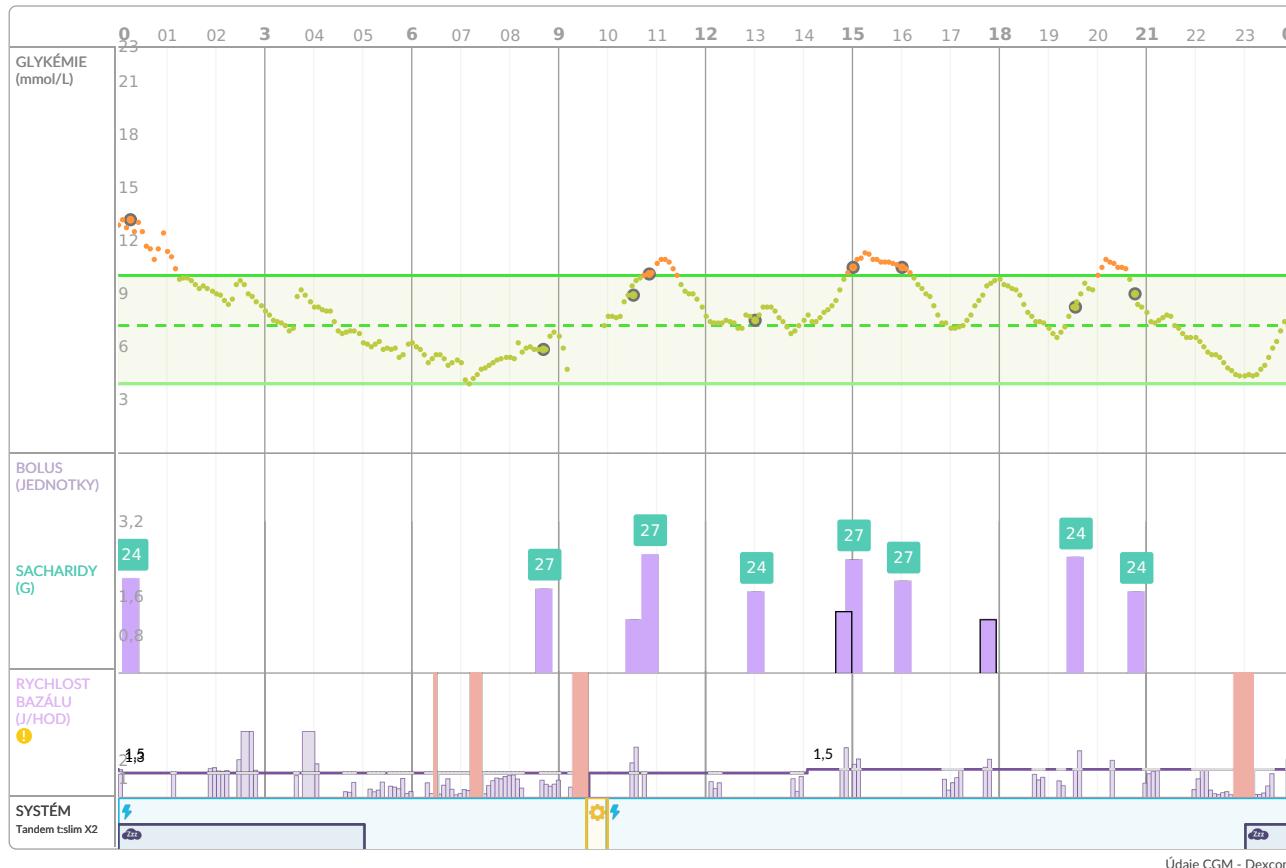

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 0:16	2 8:42	3 10:32	4 10:51	5 13:01	6 14:49	7 15:01	8 16:01	9 17:44	10 19:33
Podaný bolus	1,99	1,78	1,12	2,51	1,71	1,299	2,4	1,93	1,11	2,44
Doporučeno	1,99	1,78	1,12	2,51	1,71	1,299	2,4	1,93	1,11	2,44
Jídlo	1,71	1,78	-	1,93	1,71	-	1,93	1,93	-	1,71
Korekce	0,28	-	1,12	0,58	-	1,299	0,47	-	1,11	0,73
Aktivní inzulin	3,266	0	0,277	1,424	0,862	0,69	1,974	2,951	1,294	0,319
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	3. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,3	9,9
Medián glykémie	9	10
Hodnoty glykémie	9	217
Prům. CGM	7,9	8,6
Medián CGM	7,7	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	17%	22%
% CGM cílové rozmezí	83%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	20 j	19,9 j
Bazál	29,4 j	33,1 j
Inzulin celkem	49,4 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (7)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	3. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	98%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	2%	3%

4. 11. 2023

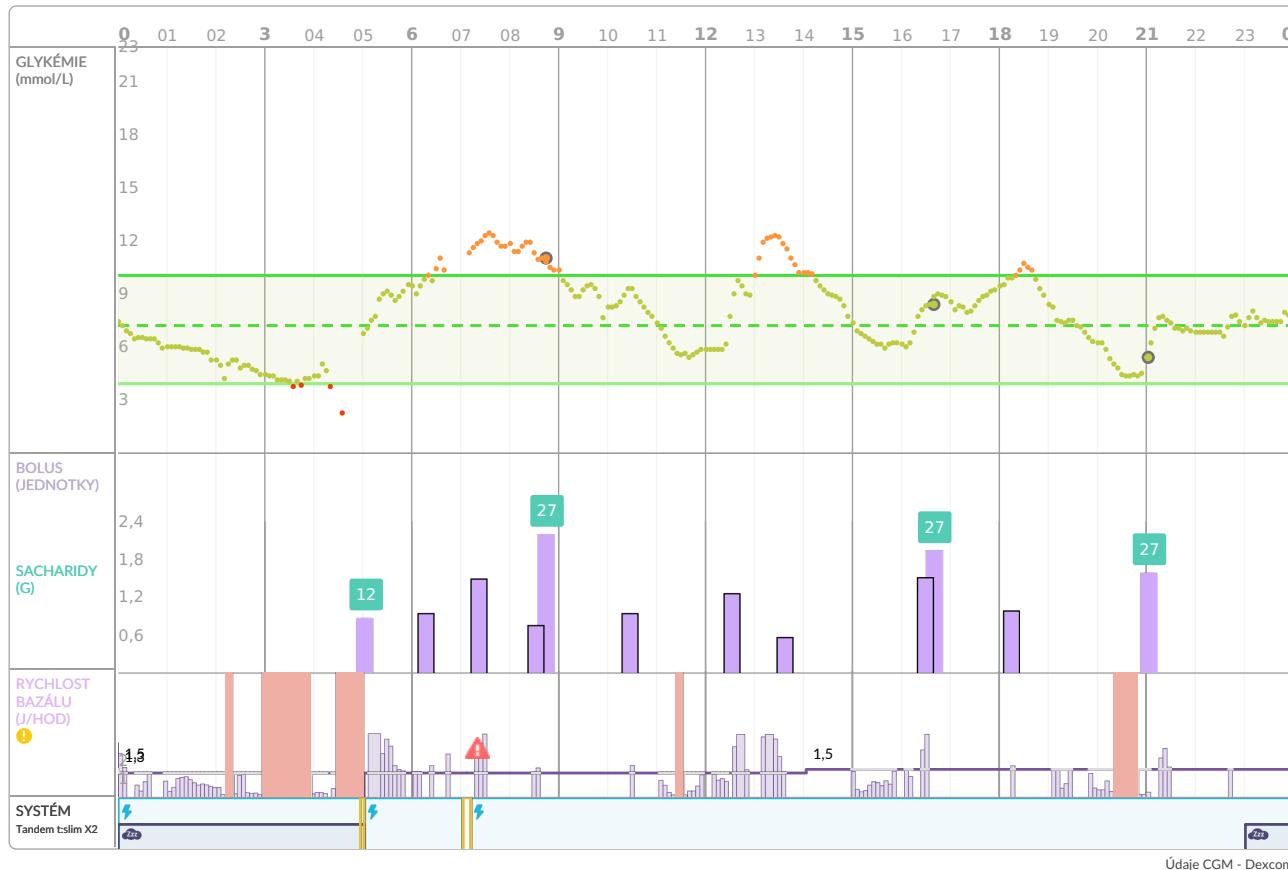

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:03	2 6:17	3 7:22	4 8:32	5 8:45	6 10:27	7 12:33	8 13:37	9 16:28	10 16:40
Podaný bolus	0,86	0,947	1,493	0,758	2,19	0,949	1,258	0,567	1,517	1,93
Doporučeno	0,86	0,947	1,493	0,758	2,19	0,949	1,258	0,567	1,517	1,93
Jídlo	0,86	-	-	-	1,93	-	-	-	-	1,93
Korekce	-	0,947	1,493	0,758	0,26	0,949	1,258	0,567	1,517	-
Aktivní inzulin	0	0,536	1,133	1,619	2,185	1,421	0	1,805	0	1,426
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	4. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	8,3	9,9
Medián glykémie	8,4	10
Hodnoty glykémie	3	217
Prům. CGM	7,7	8,6
Medián CGM	7,5	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	17%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	74%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	15,1 j	19,9 j
Bazál	29 j	33,1 j
Inzulin celkem	44 j	53 j
Počet bolusů	12	12,2
Prům. Bolus	1,3 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	75% (9)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	4. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	99%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	1%	3%

5. 11. 2023

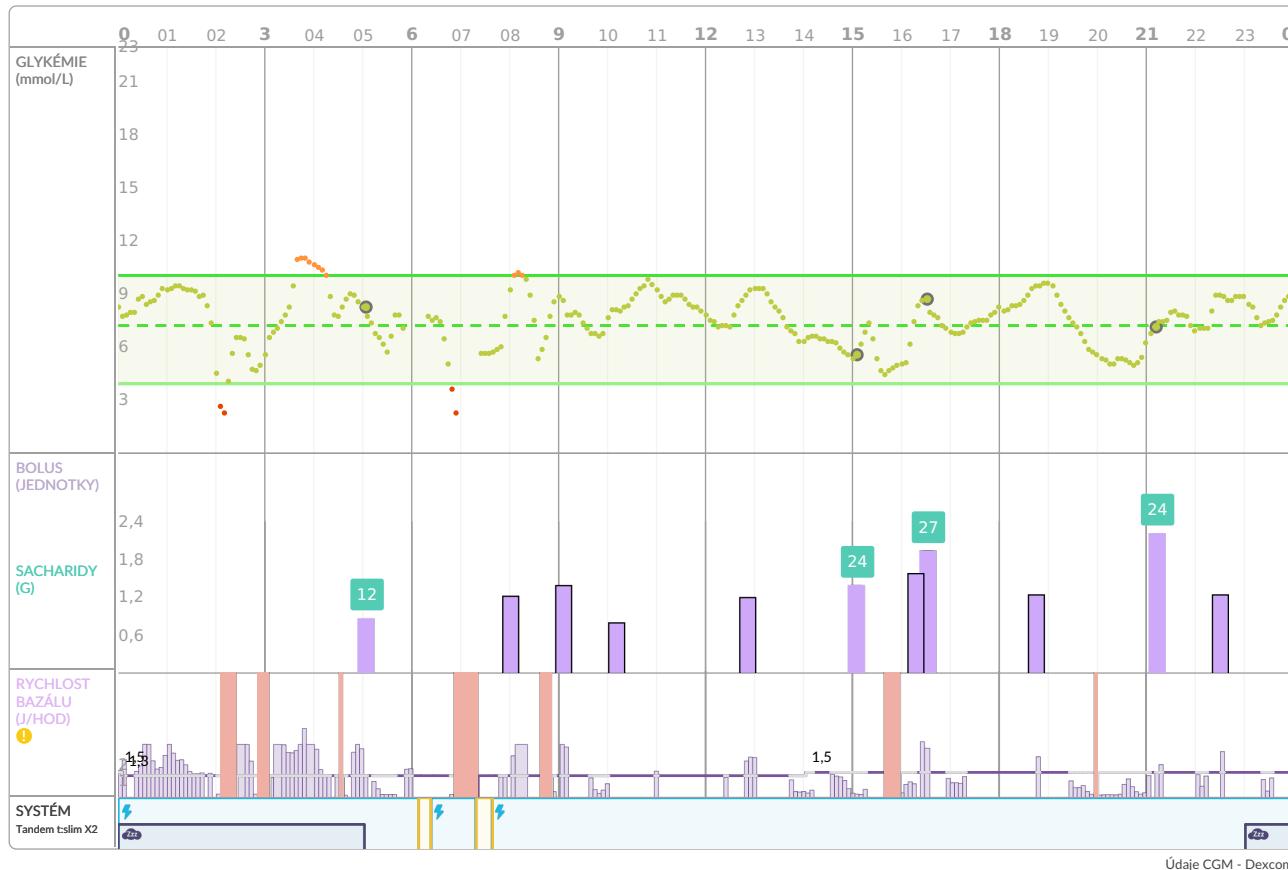


Bolusy pumpy


Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:04	2 8:01	3 9:06	4 10:11	5 12:52	6 15:05	7 16:18	8 16:32	9 18:45	10 21:13
Podaný bolus	0,86	1,223	1,391	0,8	1,2	1,38	1,582	1,93	1,249	2,21
Doporučeno	0,86	1,223	1,391	0,8	1,2	1,38	1,582	1,93	1,249	2,21
Jídlo	0,86	-	-	-	-	1,38	-	1,93	-	1,71
Korekce	-	1,223	1,391	0,8	1,2	-	1,582	-	1,249	0,5
Aktivní inzulin	1,205	0	0,909	1,235	0,231	0	0	1,67	0,789	0
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)



Typy hodnot



Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno


Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu



Bazál




Statistiky

	5. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	7,4	9,9
Medián glykémie	7,6	10
Hodnoty glykémie	4	217
Prům. CGM	7,5	8,6
Medián CGM	7,7	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	4%	22%
% CGM cílové rozmezí	95%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	1%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	15,1 j	19,9 j
Bazál	32,1 j	33,1 j
Inzulin celkem	47,2 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	5. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	98%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	2%	3%

6. 11. 2023

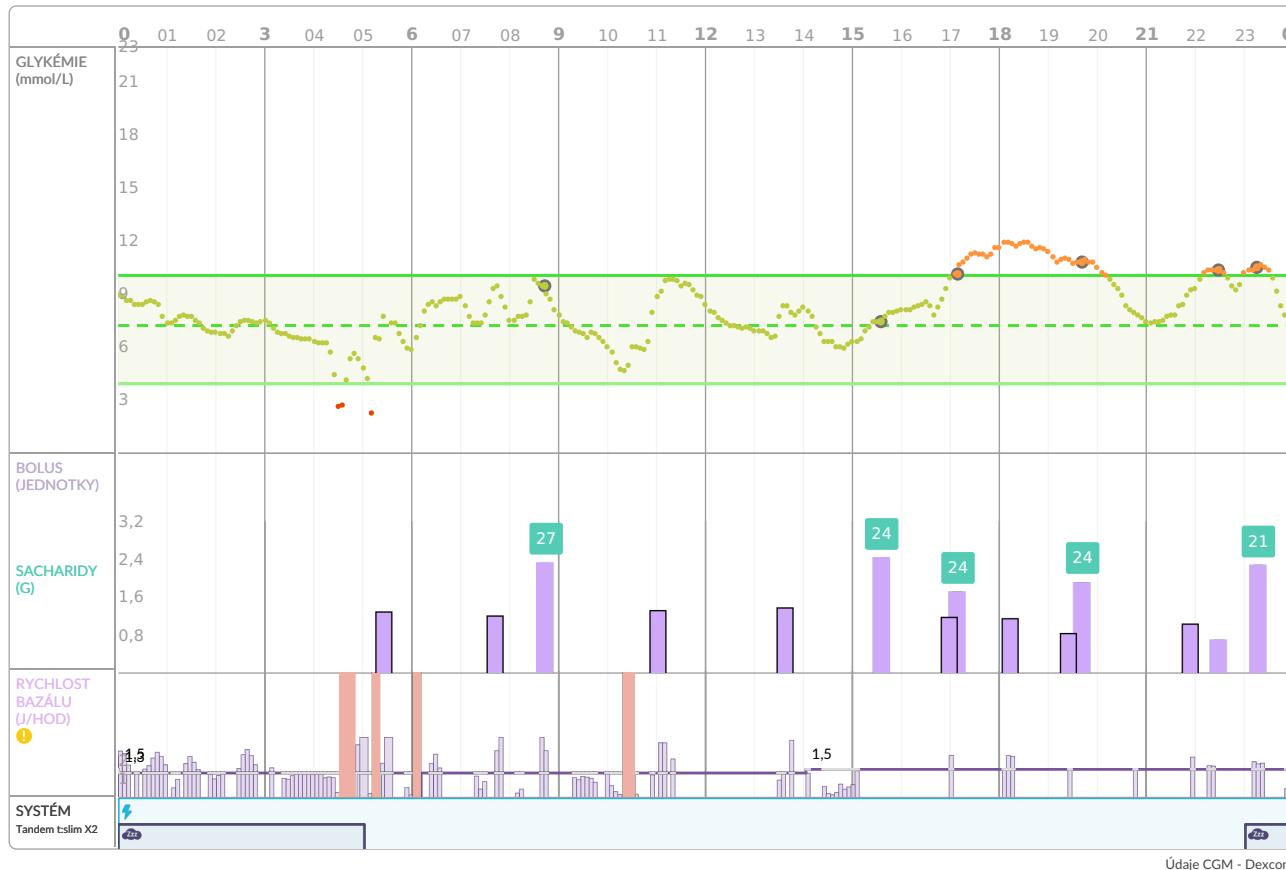

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:26	2 7:42	3 8:43	4 11:02	5 13:37	6 15:35	7 16:58	8 17:08	9 18:13	10 19:23
Podaný bolus	1,284	1,202	2,33	1,333	1,373	2,43	1,171	1,71	1,151	0,834
Doporučeno	1,284	1,202	2,33	1,333	1,373	2,43	1,171	1,71	1,151	0,834
Jídlo	-	-	1,93	-	-	1,71	-	1,71	-	-
Korekce	1,284	1,202	0,4	1,333	1,373	0,72	1,171	-	1,151	0,834
Aktivní inzulin	0	0,228	1,247	0,093	0,146	0	1,309	2,365	2,481	1,645
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Statistiky

	6. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,7	9,9
Medián glykémie	10,2	10
Hodnoty glykémie	6	217
Prům. CGM	8,1	8,6
Medián CGM	7,8	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	81%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	1%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	20,7 j	19,9 j
Bazál	33 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,8 j	53 j
Počet bolusů	14	12,2
Prům. Bolus	1,5 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (13)	77% (9,4)

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22,2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22,2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy


Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS

Podrobnosti systému

	6. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

7. 11. 2023

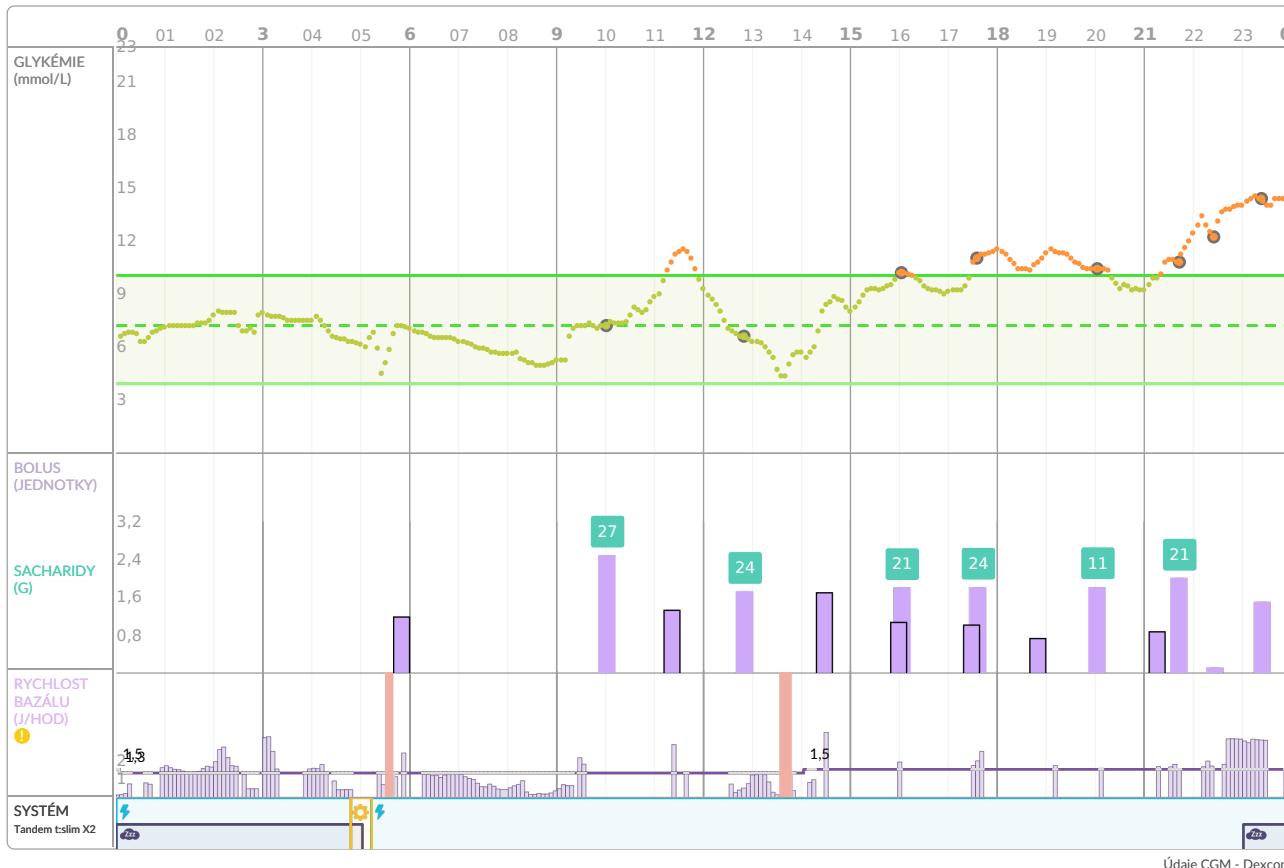

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:50	2 10:01	3 11:21	4 12:50	5 14:27	6 15:57	7 16:02	8 17:28	9 17:36	10 18:47
Podaný bolus	1,169	2,48	1,308	1,71	1,685	1,063	1,79	1,008	1,8	0,72
Doporučeno	1,169	2,48	1,308	1,71	1,685	1,063	1,79	1,008	1,8	0,72
Jídlo	-	1,93	-	1,71	-	-	1,5	-	1,71	-
Korekce	1,169	0,55	1,308	-	1,685	1,063	0,29	1,008	0,09	0,72
Aktivní inzulin	0	0	1,446	0,855	0,268	0,972	1,994	1,821	2,628	2,374
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivity
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	7. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	10,4	9,9
Medián glykémie	10,6	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	8,5	8,6
Medián CGM	7,8	8,1
% CGM velmi vysoká	5%	4%
% CGM vysoká hodnota	22%	22%
% CGM cílové rozmezí	73%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	21 j	19,9 j
Bazál	32,4 j	33,1 j
Inzulin celkem	53,4 j	53 j
Počet bolusů	15	12,2
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (14)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	7. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	98%	97%
Aktivita - fyzická aktivity	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	2%	3%

8. 11. 2023

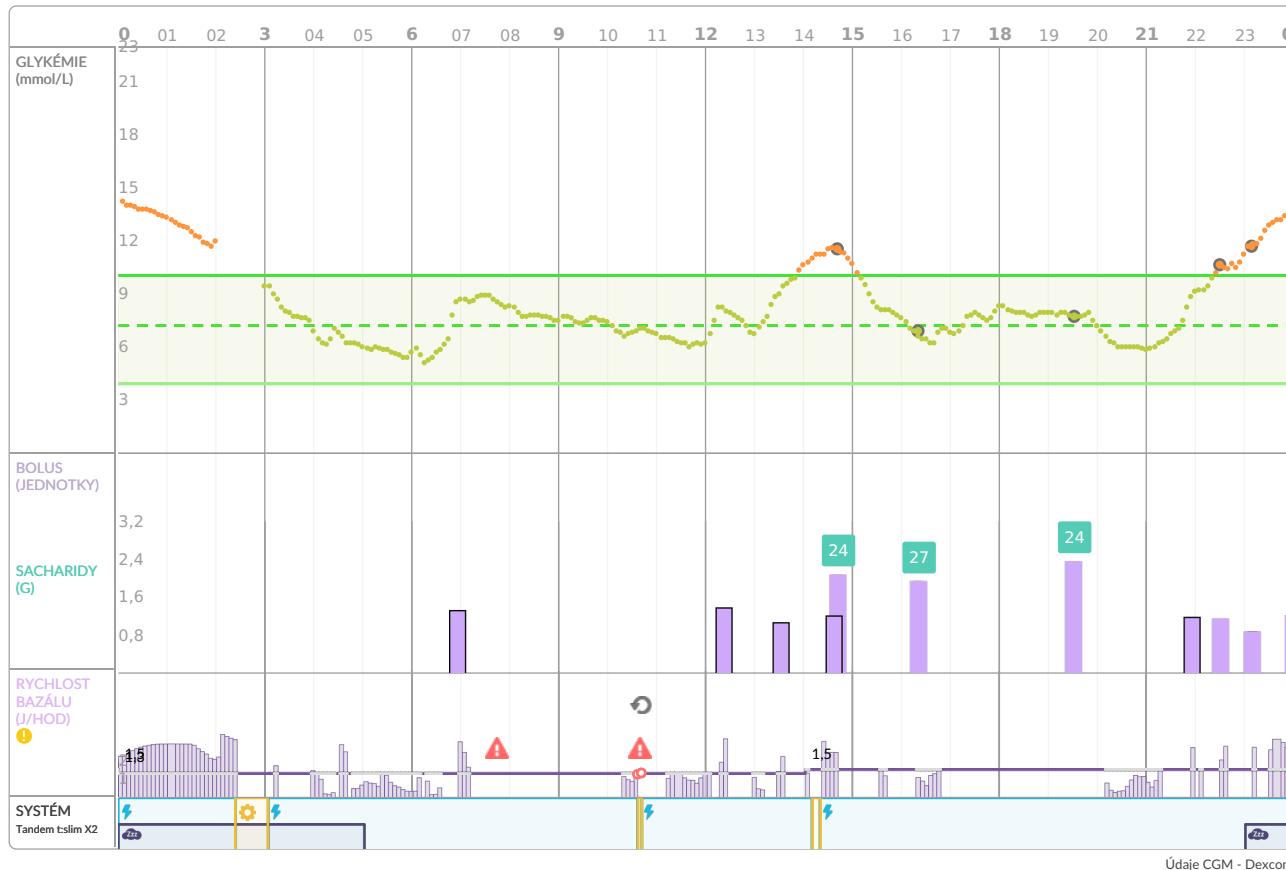

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 6:56	2 12:22	3 13:31	4 14:37	5 14:42	6 16:20	7 19:31	8 21:54	9 22:30	10 23:09
Podaný bolus	1,329	1,368	1,078	1,218	2,08	1,93	2,36	1,172	1,14	0,87
Doporučeno	1,329	1,368	1,078	1,218	2,08	1,93	2,36	1,172	1,14	0,87
Jídlo	-	-	-	-	1,71	1,93	1,71	-	-	-
Korekce	1,329	1,368	1,078	1,218	0,37	-	0,65	1,172	1,14	0,87
Aktivní inzulin	0	0	0,839	1,409	2,634	1,747	0,147	0,026	1,111	1,925
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivity
- Aktivita - spánok
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	8. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	10,3	9,9
Medián glykémie	11	10
Hodnoty glykémie	6	217
Prům. CGM	8,4	8,6
Medián CGM	7,7	8,1
% CGM velmi vysoká	1%	4%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	79%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	14,6 j	19,9 j
Bazál	35,3 j	33,1 j
Inzulin celkem	49,9 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,3 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (10)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	8. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	96%	97%
Aktivita - fyzická aktivity	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	4%	3%

9. 11. 2023

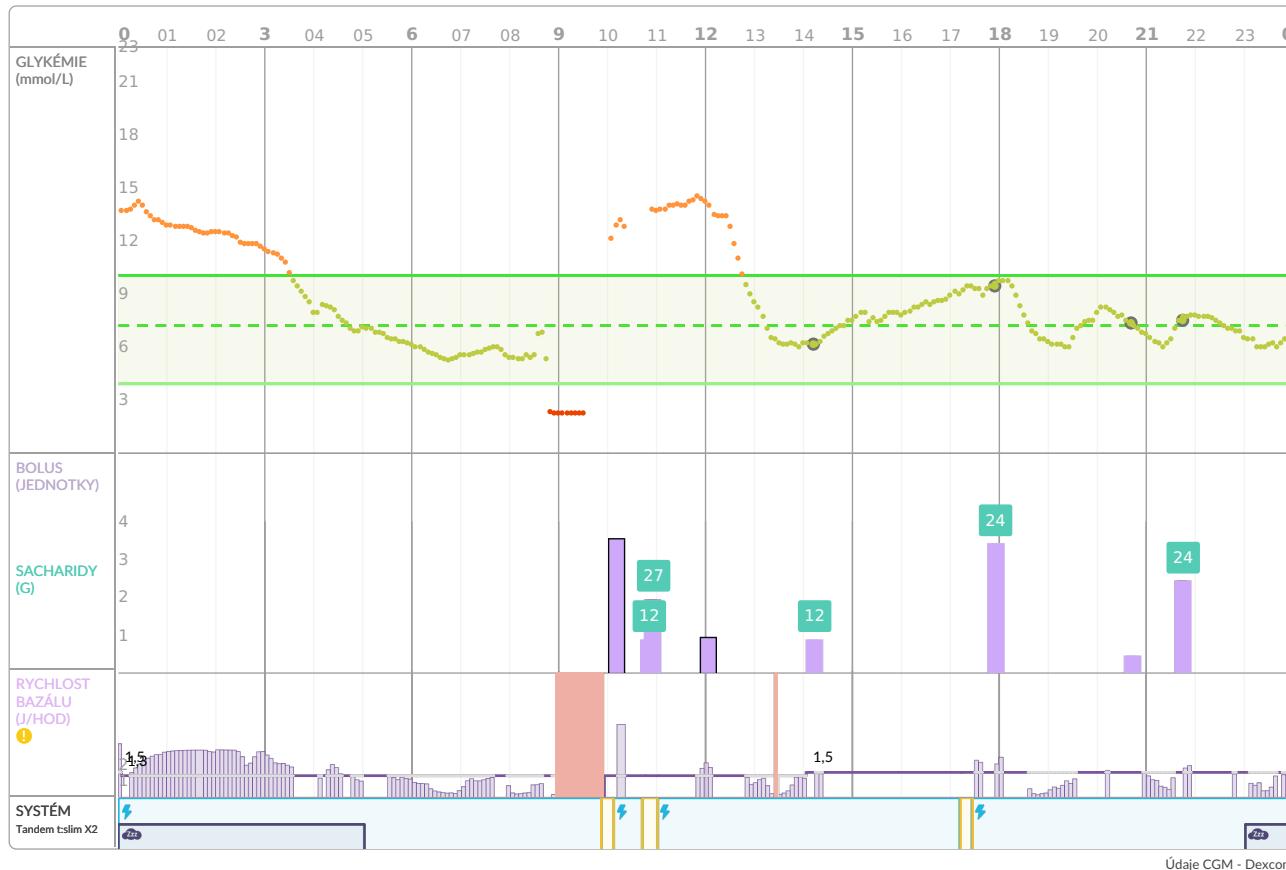

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 10:11	2 10:50	3 10:55	4 12:02	5 14:12	6 17:54	7 20:42	8 21:44	9	10
Podaný bolus	3,56	0,86	1,93	0,93	0,86	3,4	0,47	2,41	-	-
Doporučeno	3,56	0,86	1,93	0,93	0,86	3,4	0,47	2,41	-	-
Jídlo	-	0,86	1,93	-	0,86	1,71	-	1,71	-	-
Korekce	3,56	-	-	0,93	-	1,69	0,47	0,7	-	-
Aktivní inzulin	0	2,846	3,662	3,621	0,024	0,145	0,133	0	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

Control-IQ

Aktivita - fyzická aktivita

Aktivita - spánek

Manuální

Typy hodnot

Pod cílovou hodnotou

V rozmezí

Nad cílovou hodnotou

Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Přerušeno

Nepodáno

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

Přepsat

Rozložený bolus

Kombinovaný bolus

Automatický bolus

Podaný bolus

Bazál

Předmixovaný

Vlastní

Sacharidy

Bazál

Výstraha pumpy

Náplň nádobky

Rychlosť bazálu

Modulace bazálu

Nepoužitý plánovaný bazál

Dočasný bazál

Nastavít a/nebo Změna pracoviště

Pozastavit

LGS/PLGS

Statistiky


	9. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	7,6	9,9
Medián glykémie	7,4	10
Hodnoty glykémie	4	217
Prům. CGM	8,4	8,6
Medián CGM	7,6	8,1
% CGM velmi vysoká	5%	4%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	72%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	3%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	15,6 j	19,9 j
Bazál	33 j	33,1 j
Inzulin celkem	48,6 j	53 j
Počet bolusů	8	12,2
Prům. Bolus	2 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (5)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	9. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	97%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	3%	3%

17. 10. 2023 - 15. 11. 2023 (30 dní)

10. 11. 2023

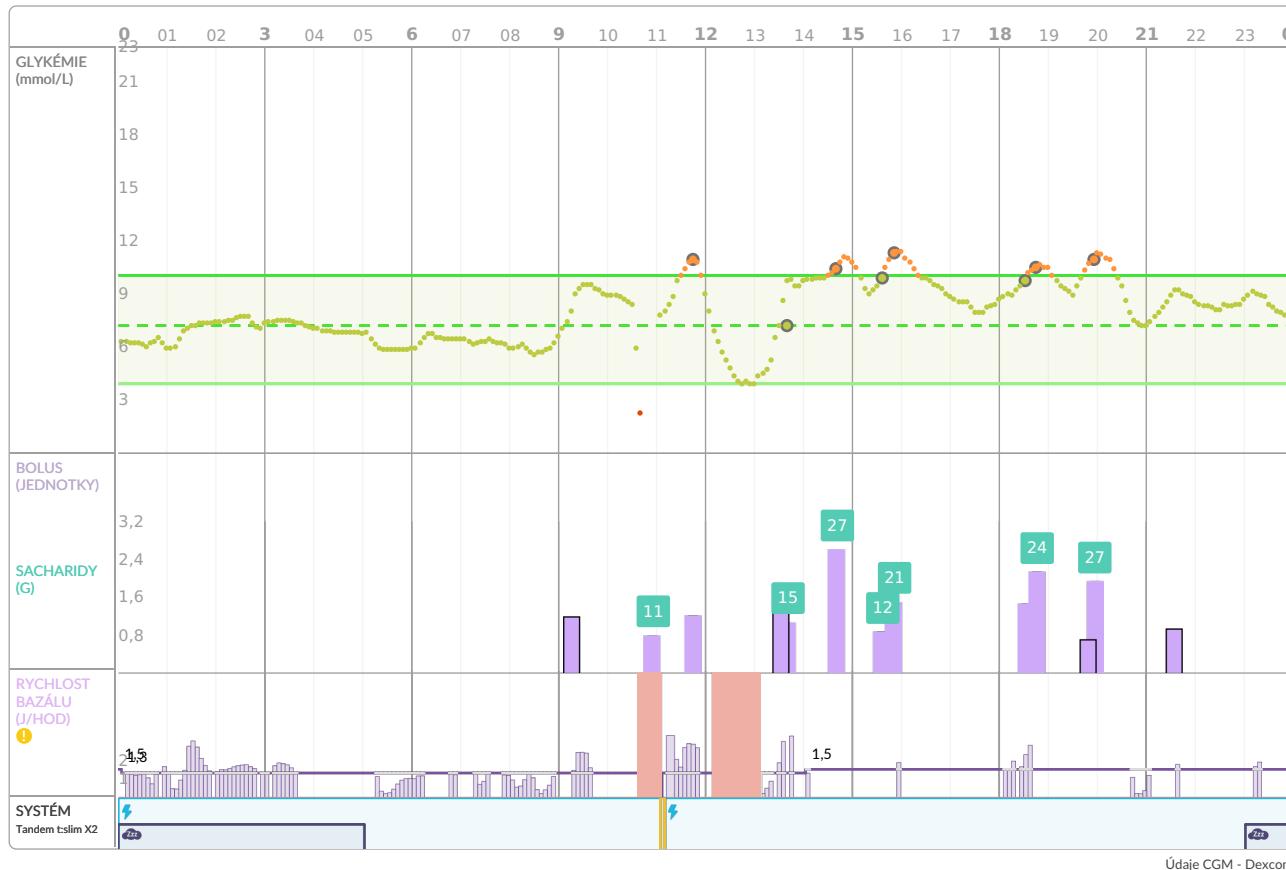

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den



Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
 - V rozmezí
 - Nad cílovou hodnotou
 - --- --- Hodnoty z CGM
 - *** Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
 - Glukometr pumpy
 - Přes 22.2
 - Hodnoty glykémie pro

Glykémie

- Horní limit před jídlem: **7,2**
- Horní limit po jídle: **10**
- Normální glykémie: **3,9 - 10**
- Cílový rozsah: **3,9 - 10**
- Přerušeno
- Nepodáno

! Segment bazálu, který v době stahování probíhal není zobrazen

- Dávka inzulinu
- ↳ Přepsat
- ↳ Rozložený bolus
- ↳ Kombinovaný bolus
- ↳ Automaticky
- ↳ Podaný bolus
- ↳ Bazál
- ↳ Předmixování
- ↳ Vlastní
- ↳ Sacharidy

-  Výstraha pumpý
-  Náplň nádobky
-  Rychlosť bazálu
-  Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
-  Dočasný bazál
-  Nastavíť a/nebo
Změna pracovišť
-  Pozastaviť
-  LGS/PLGS


Statistiky

	10. LIS	17. ŘÍJ.	15. LIS
Statistiky glykémie			
Prům. Glykémie	10,1	9,9	
Medián glykémie	10,5	10	
Hodnoty glykémie	8	217	
Prům. CGM	7,9	8,6	
Medián CGM	7,9	8,1	
% CGM velmi vysoká	0%	4%	
% CGM vysoká hodnota	13%	22%	
% CGM cílové rozmezí	87%	74%	
% CGM nízká hodnota	0%	0%	
% CGM velmi nízká	0%	0%	
Inzulin – zařízení			
Bolus	17,7 j	19,9 j	
Bazál	31,9 j	33,1 j	
Inzulin celkem	49,6 j	53 j	
Počet bolusů	13	12,2	
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j	
Počet kor. Bolus	NaN% (8)	77% (9,4)	

Podrobnosti systému

	10. LIS	17. ŘÍJ.	15. LIS
Control-IQ	100%	97%	
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%	
Aktivita - spánek	25%	25%	
Manuální	0%	3%	

11. 11. 2023

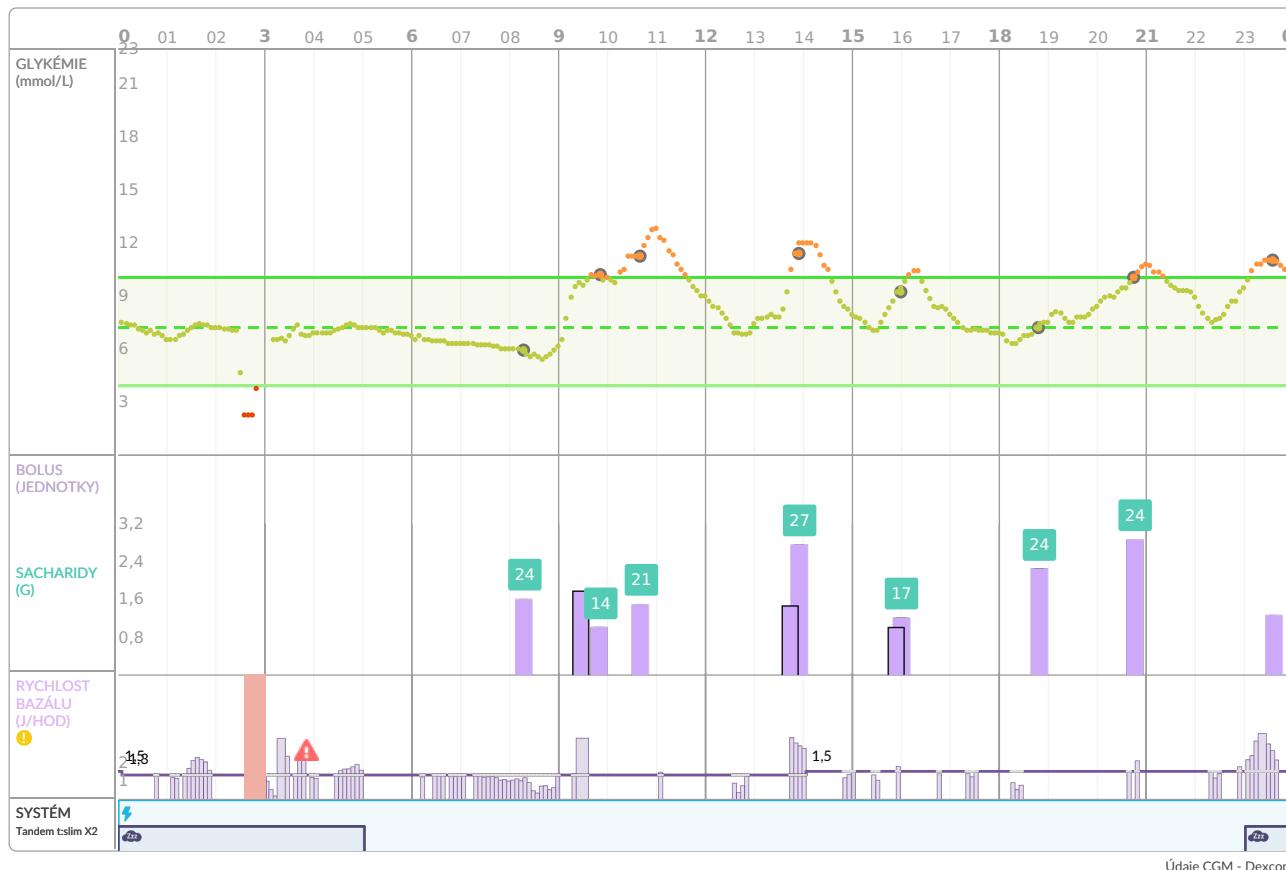

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 8:17	2 9:26	3 9:50	4 10:40	5 13:43	6 13:54	7 15:53	8 15:59	9 18:48	10 20:45
Podaný bolus	1,61	1,782	1	1,5	1,454	2,76	1,022	1,21	2,24	2,87
Doporučeno	1,61	1,782	1	1,5	1,454	2,76	1,022	1,21	2,24	2,87
Jídlo	1,61	-	1	1,5	-	1,93	-	1,21	1,71	1,71
Korekce	-	1,782	-	-	1,454	0,83	1,022	-	0,53	1,16
Aktivní inzulin	0	0,909	2,773	2,619	0,098	1,821	1,552	2,467	0,078	0,795
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Odhadované hodnoty ze zařízení CGM

Glukometr pumpy

Přes 22.2

Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sachardy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	11. LIS	17. říj - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,5	9,9
Medián glykémie	10,1	10
Hodnoty glykémie	8	217
Prům. CGM	8,1	8,6
Medián CGM	7,5	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	19%	22%
% CGM cílové rozmezí	80%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	1%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	18,7 j	19,9 j
Bazál	34,3 j	33,1 j
Inzulin celkem	53 j	53 j
Počet bolusů	11	12,2
Prům. Bolus	1,7 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (7)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	11. LIS	17. říj - 15. LIS
Control-IQ	100%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	0%	3%

13. 11. 2023

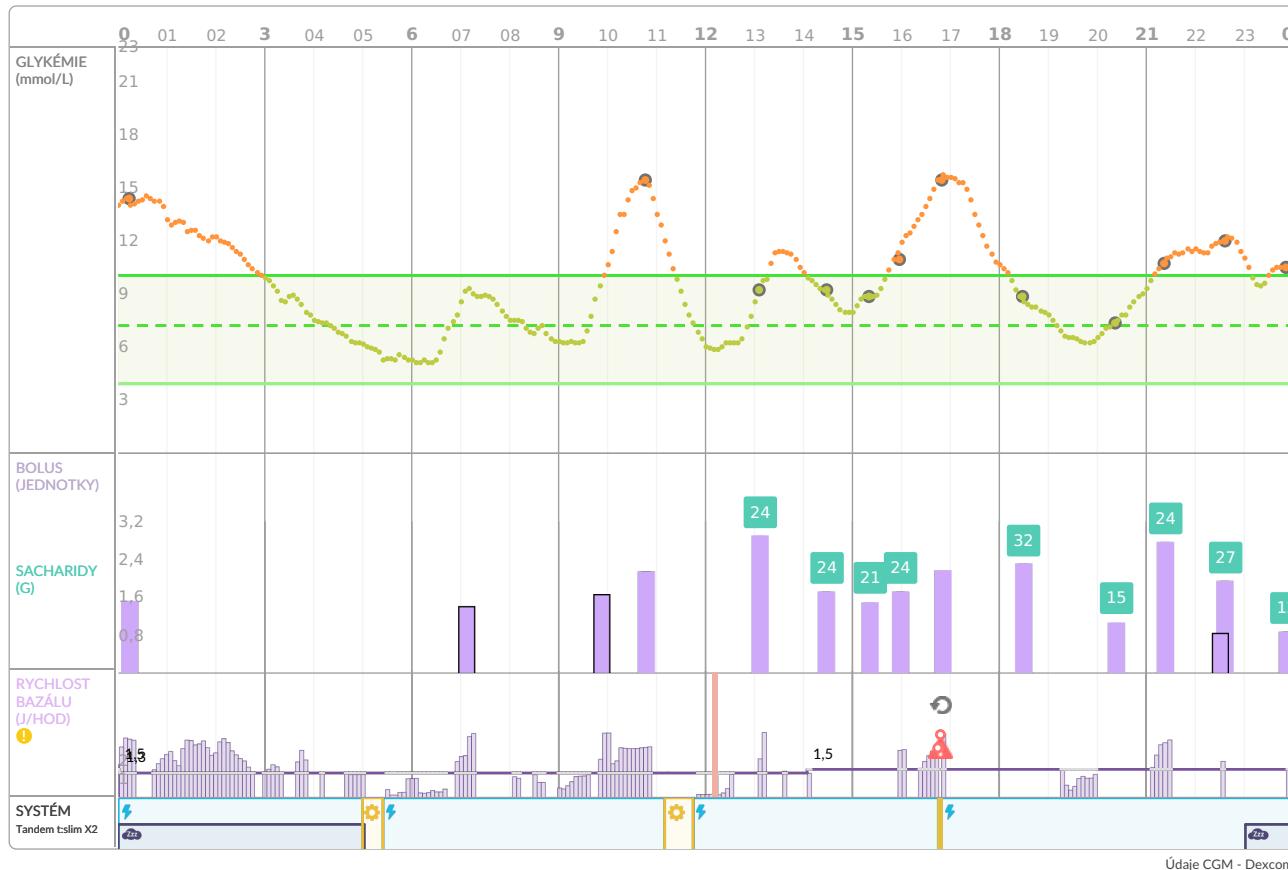

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 0:13	2 7:08	3 9:53	4 10:46	5 13:06	6 14:28	7 15:21	8 15:58	9 16:49	10 18:28
Podaný bolus	1,51	1,41	1,669	2,14	2,89	1,71	1,5	1,71	2,16	2,29
Doporučeno	1,51	1,41	1,669	2,14	2,89	1,71	1,5	1,71	2,16	2,29
Jídlo	-	-	-	-	1,71	1,71	1,5	1,71	-	2,29
Korekce	1,51	1,41	1,669	2,14	1,18	-	-	-	2,16	-
Aktivní inzulin	2,64	0	0,029	2,507	0,366	1,848	2,098	2,652	3,012	1,68
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS


Statistiky

	13. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	11,1	9,9
Medián glykémie	10,6	10
Hodnoty glykémie	12	217
Prům. CGM	9,6	8,6
Medián CGM	9,3	8,1
% CGM velmi vysoká	11%	4%
% CGM vysoká hodnota	32%	22%
% CGM cílové rozmezí	57%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	26,5 j	19,9 j
Bazál	36,9 j	33,1 j
Inzulin celkem	63,3 j	53 j
Počet bolusů	15	12,2
Prům. Bolus	1,8 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (8)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	13. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	96%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	4%	3%

14. 11. 2023

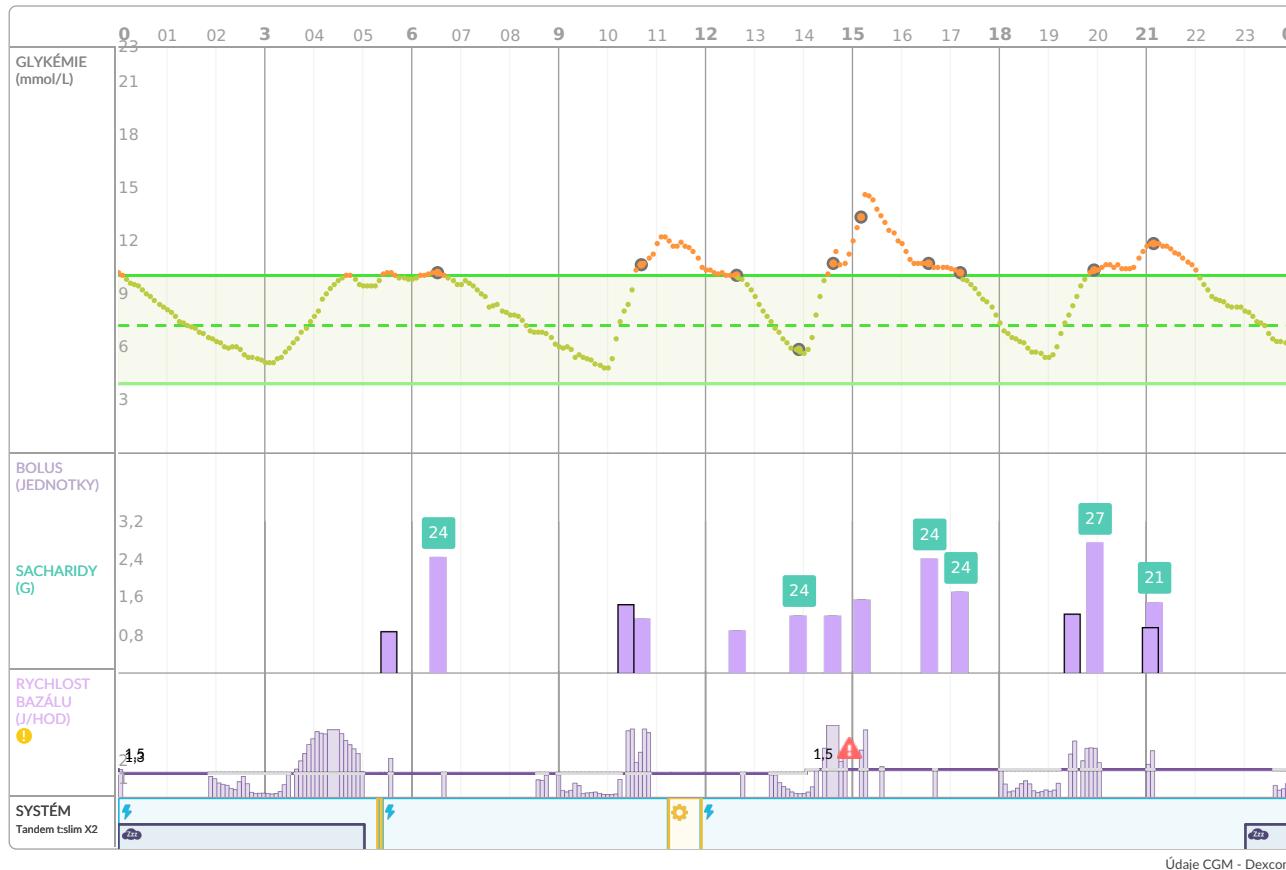

Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 5:31	2 6:32	3 10:22	4 10:42	5 12:38	6 13:54	7 14:36	8 15:10	9 16:33	10 17:12
Podaný bolus	0,87	2,45	1,433	1,16	0,9	1,22	1,2	1,53	2,42	1,71
Doporučeno	0,87	2,45	1,433	1,16	0,9	1,22	1,2	1,53	2,42	1,71
Jídlo	-	1,71	-	-	-	1,22	-	-	1,71	1,71
Korekce	0,87	0,74	1,433	1,16	0,9	-	1,2	1,53	0,71	-
Aktivní inzulin	1,299	1,306	0	1,085	0,965	0,341	1,361	2,471	1,847	3,239
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Statistiky

	14. LIS	17. říj - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	10,4	9,9
Medián glykémie	10,4	10
Hodnoty glykémie	10	217
Prům. CGM	8,8	8,6
Medián CGM	9,1	8,1
% CGM velmi vysoká	1%	4%
% CGM vysoká hodnota	34%	22%
% CGM cílové rozmezí	65%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	21,3 j	19,9 j
Bazál	33,4 j	33,1 j
Inzulin celkem	54,7 j	53 j
Počet bolusů	14	12,2
Prům. Bolus	1,5 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	NaN% (11)	77% (9,4)

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22,2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22,2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy


Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS

Podrobnosti systému

	14. LIS	17. říj - 15. LIS
Control-IQ	97%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	25%	25%
Manuální	3%	3%

15. 11. 2023

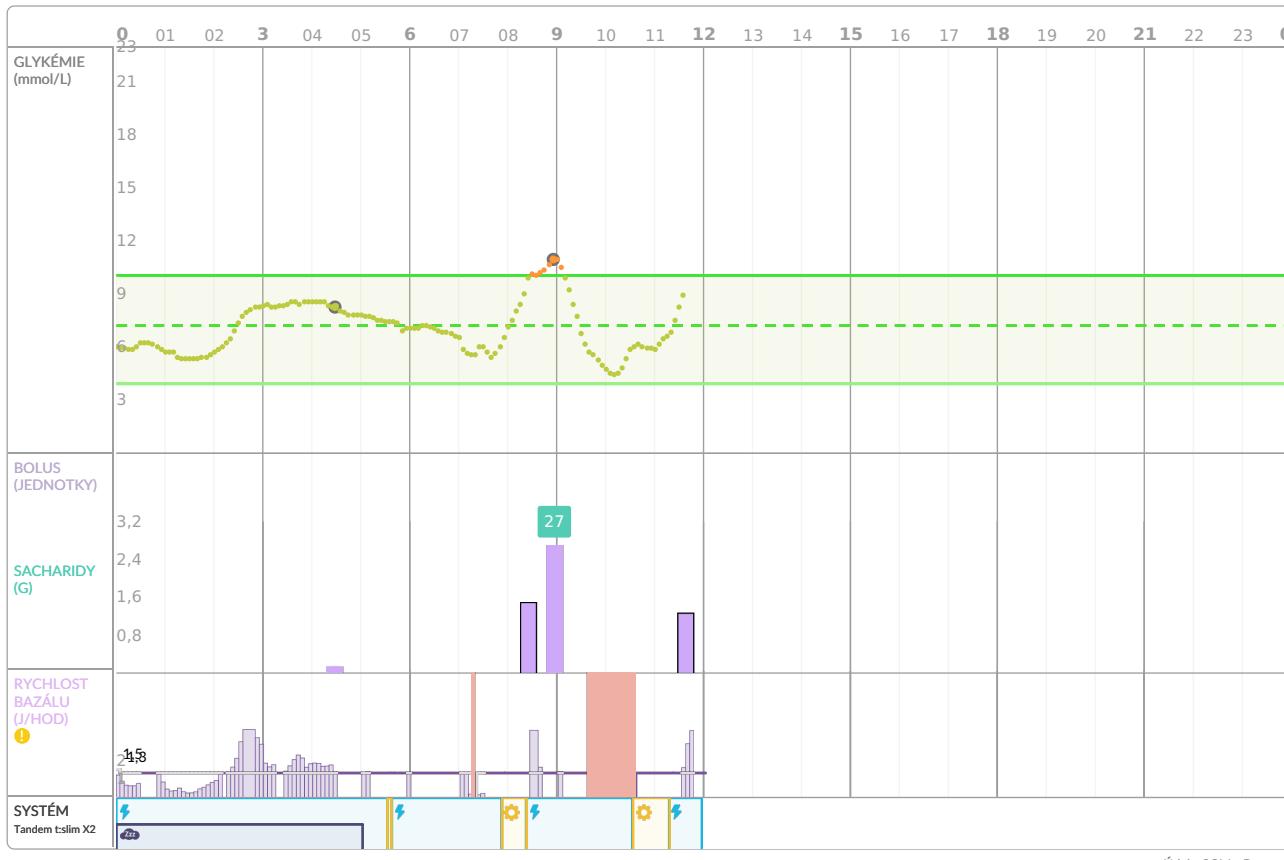

Údaje CGM - Dexcom

Bolusy pumpy

Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 4:29	2 8:26	3 8:56	4 11:37	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	0,14	1,482	2,69	1,266	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	0,14	1,482	2,69	1,266	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	1,93	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	0,14	1,482	0,76	1,266	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	0,908	0	1,64	0,122	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - fyzická aktivita
- Aktivita - spánek
- Manuální

Typy hodnot

- Pod cílovou hodnotou
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- Glukometr pumpy
- Přes 22.2
- Hodnoty glykémie pro pumpu přes 22.2

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Přerušeno
- Nepodáno
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Kombinovaný bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní
- Sacharidy

Bazál

- Výstraha pumpy
- Náplň nádobky
- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- Dočasný bazál
- Nastavit a/nebo Změna pracoviště
- Pozastavit
- LGS/PLGS

Statistiky

	15. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Statistiky glykémie		
Prům. Glykémie	9,5	9,9
Medián glykémie	9,5	10
Hodnoty glykémie	2	217
Prům. CGM	7	8,6
Medián CGM	6,9	8,1
% CGM velmi vysoká	0%	4%
% CGM vysoká hodnota	6%	22%
% CGM cílové rozmezí	94%	74%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	5,6 j	19,9 j
Bazál	14,2 j	33,1 j
Inzulin celkem	19,8 j	53 j
Počet bolusu	4	12,2
Prům. Bolus	1,4 j	1,6 j
Počet kor. Bolus	100% (4)	77% (9,4)

Podrobnosti systému

	15. LIS	17. ŘÍJ - 15. LIS
Control-IQ	89%	97%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	42%	25%
Manuální	11%	3%

Tandem t:slim X2

Čas poslední synchronizace: 15. 11. 2023 - 12:24
819914

Tandem t:slim X2

Obecně

Čas aktivního inzulinu	5 hodina
Povoleno automatické vypnutí	VYPNUTO
Jednotka měření	mmol/l
Velikost kanyly Prime	0,7 J
Poslední stisknutí klávesy pro zobrazení časového limitu	120 druhý
Funkce Zámek	VYPNUTO
Nízká hladina nádržky	20 J
Objem čerpadla: Alarms	Vibrace
Objem čerpadla: upozornění	Vibrace
Objem čerpadla: bolus	Vibrace
Objem čerpadla: tlačítko	Nízká
Objem čerpadla: rychlý bolus	Nízká
Objem čerpadla: Připomínky	Nízká

Bazál

Aktivní bazální program

Martin

Bolus

Maximální bolus	10 J
Množství rychlého bolusu	1 J
Povolen rychlý bolus	ZAPNUTO

Hybridní uzavřená smyčka

Povolen uzavřený okruh	ZAPNUTO
Celkový denní inzulin	50 J
Hmotnost	74 kg / 163 lb

Bazál

Martin Aktivní

00:00 (14 hod)	1,3 jednotky/hod
14:00 (5 hod)	1,5 jednotky/hod
19:00 (5 hod)	1,5 jednotky/hod
Celkem	33,2 jednotky

Senzitivita (ISF, korekce)

Martin Aktivní

00:00 (14 hod)	2 mmol/l
14:00 (5 hod)	1,8 mmol/l
19:00 (5 hod)	2 mmol/l

Poměr inzulinu a sacharidů

Martin Aktivní

00:00 (14 hod)	14 g/jednotku
14:00 (5 hod)	14 g/jednotku
19:00 (5 hod)	14 g/jednotku

Cílový rozsah glykémie

Martin Aktivní

00:00 (14 hod)	5,5 mmol/l (+0/-0)
14:00 (5 hod)	5,5 mmol/l (+0/-0)
19:00 (5 hod)	5,5 mmol/l (+0/-0)