


### Podrobnosti o důvodu ukončení

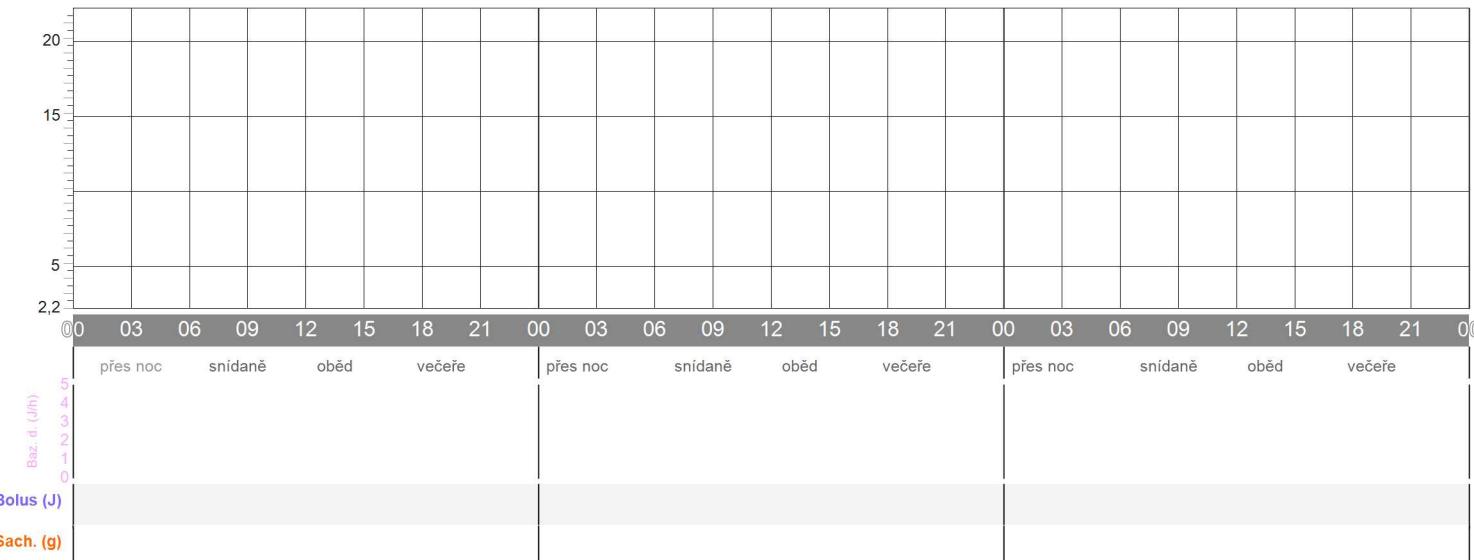

○ Glykémie  
● Kalibrace

Autom. bazál  
Bazál

Zastavit  
při níz. GS

Zastavit  
před níz. GS

Automat.  
korekce  
+ Aktivní inzulin

Bolus  
+ aktivní inzulin

Ruční režim

Cíl  
+ dočasný cíl

Změna času

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 07.08.2023		24:00	11	3	3								
Úterý 08.08.2023		21:10	22	3	3			1	1	0,3	1	10,2	0:07 
Středa 09.08.2023		24:00	23	4	4	2							0:01 
Čtvrttek 10.08.2023		24:00	27	3	3	2							
Pátek 11.08.2023		24:00	20	3	3	1							
Sobota 12.08.2023		24:00	15	3	3			1	1	0,3	1	8,6	0:07 
Neděle 13.08.2023		24:00	15	3	3	1							
Pondělí 14.08.2023		24:00	13	3	3	1							
Úterý 15.08.2023	1	21:15	6	3	3	2							0:35 
Středa 16.08.2023	1	24:00	13	4	4	3		1	1	0,3	1	10,2	0:07 
Čtvrttek 17.08.2023		24:00	7	4	4	1							
Pátek 18.08.2023		24:00	14	3	3								
Sobota 19.08.2023		24:00	26	3	3	1							
Neděle 20.08.2023		21:00	15	3	3	1			1	0,3	1	9,3	0:06 
Shrnutí	0,1/den	13d 15h 25m	16,2/den	3,2/den	100,0%	33,3%	0%	4	4	0,3J /naplnění	4	9,5J /naplnění	1h 03m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 21.08.2023	1	24:00	20	3	3								
Úterý 22.08.2023		24:00	17	3	3								
Středa 23.08.2023		24:00	12	3	3								
Čtvrtek 24.08.2023		24:00	10	3	3	2		1	1	0,3	1	8,7	0:46
Pátek 25.08.2023		24:00	15	3	3	1							
Sobota 26.08.2023		24:00	14	3	3								
Neděle 27.08.2023		22:35	21	2	2			1			1	8,9	1:36
Pondělí 28.08.2023		21:55	11	4	4				1	0,3			0:01
Úterý 29.08.2023		24:00	8	3	3	1							
Středa 30.08.2023		24:00	14	3	3	1							0:01
Čtvrtek 31.08.2023		24:00	10	3	3	1		1	1	0,3	1	8,9	0:45
Pátek 01.09.2023		24:00	4	3	3	2							
Sobota 02.09.2023	1	24:00	11	3	3	2							
Neděle 03.09.2023		21:10	16	3	3	2		1	1	0,3	1	9,0	0:50
Shrnutí	0,1/den	13d 17h 40m	13,1/den	3,0/den	100,0%	28,6%	0%	4	4	0,3J /naplnění	4	8,9J /naplnění	3h 59m

	Měření glykémie		Události bolusu					Události plnění					Trvání zastavení (h:mm)
	Naměř. hodnoty GL	Doba použití senzoru (h:mm)	Ruční bolusy	Události funkce Bolus Wizard	Bolus k jídlu	Bolus s korekcí	Bol. zast.	Přetočení	Plnění kanyly	Množství v kanyle (J)	Plnění hadičky	Množství v hadičce (J)	
Pondělí 04.09.2023		24:00	4	3	3	3							0:26 
Úterý 05.09.2023	1	8:30	13										
Shrnutí	0,5/den	1d 08h 30m	8,5/den	1,5/den	100,0%	100,0%	0%	0	0	--	0	-	26m

Bazál

<b>Maximální bazální dávka</b>	2,00 J/hod		<b>Aktual.</b>
--------------------------------	------------	--	----------------

## Bazál 1 (aktivní)

**24 hod celkem** 19,000 J 

## Bazál 2

24 hod celkem --

Bazál 3

24 hod celkem --

## Bolus

<b>Bolus Wizard</b>	Zap.
<b>Jednotky</b>	g, mmol/l
<b>Doba aktivního inzulinu (h:mm)</b>	4:00
<b>Maximální bolus</b>	10,0 J

<b>Snadný bolus</b>	Vyp
<b>Přírůstek bolusu</b>	0,1 J
<b>Rychlosť bolusu</b>	Standardná
<b>Komb./Rozl.</b>	Vyp/Vyp

## Sacharidový por (g/J)

Citl. na inzulin  
(mmol/l na J)

Čas	Citlivost	
0:00	3,2	
23:00	2,7	
23:30	1,4	

## Cílová glykémie (mmol/l)

## Přednastav. bolus

Název	Normální	Rozložený		Aktuální
Bolus 1				
Snídaně				
Večeře				
Oběd				
Svačina				
Bolus 2				
Bolus 3				
Bolus 4				

Přednast. doč. b.

Název	Rychl.	Trvání		Název	Rychl.	Trvání	
Vys. zátěž				Doč. baz. 1			
Střed. zátěž				Doč. baz. 2			
Nízká zátěž				Doč. baz. 3			
Nemoc				Doč. baz. 4			

**SmartGuard**

<b>SmartGuard</b>	Zap
<b>Cílová hodnota</b>	5,5 mmol/l
<b>Automat. korekce</b>	Zap

Výstrahy vys. GS

o (Odložení 1:00)

Výstrahy níz. GS

o (Odložení 0:20)

Senzor

Senzor Zap

Pripominka kalibrace Vyp

## Čas připomínky kalibrace

Poznámky

## Bazál (pokračování)

Připomínky

<b>Varov. při nízk. stavu zás.</b>	Jednotky inzul.
<b>Množství</b>	20 J
<b>Kontrola GL po bolusu</b>	Vyp
<b>Výměna setu</b>	Vyp

### Zmeškaný bolus k jídlu

Název	Počátek	Konec
Jídlo 1	Vyp	Vyp
Jídlo 2	Vyp	Vyp
Jídlo 3	Vyp	Vyp
Jídlo 4	Vyp	Vyp
Jídlo 5	Vyp	Vyp
Jídlo 6	Vyp	Vyp
Jídlo 7	Vyp	Vyp
Jídlo 8	Vyp	Vyp

## **Osobní připomínky**

Název	Čas
Připomínka 1	Vyp
Připomínka 2	Vyp
Připomínka 3	Vyp
Připomínka 4	Vyp
Připomínka 5	Vyp
Připomínka 6	Vyp
Změrte GL	Vyp
Léky	Vyp

Příslušenství

<b>Režim blokování</b>	Vyp
<b>Formát času</b>	24 hod
<b>Jas</b>	Autom.
<b>Doba podsvícení</b>	15 s
<b>Možnosti zvuku</b>	Zvuk
<b>Hlasitost alarmu</b>	3
<b>Automat. zastavení</b>	Vyp

Úterý 22.08

Celk. denní dávka 36,5 J


Celkový bazál 35 % | 12,8 J

Celkový bolus 65 % | 23,7 J

{ Bolus 90% | 21,3 J

+ Automat. korekce 10% | 2,4 J }

Čas v cíl. rozs.

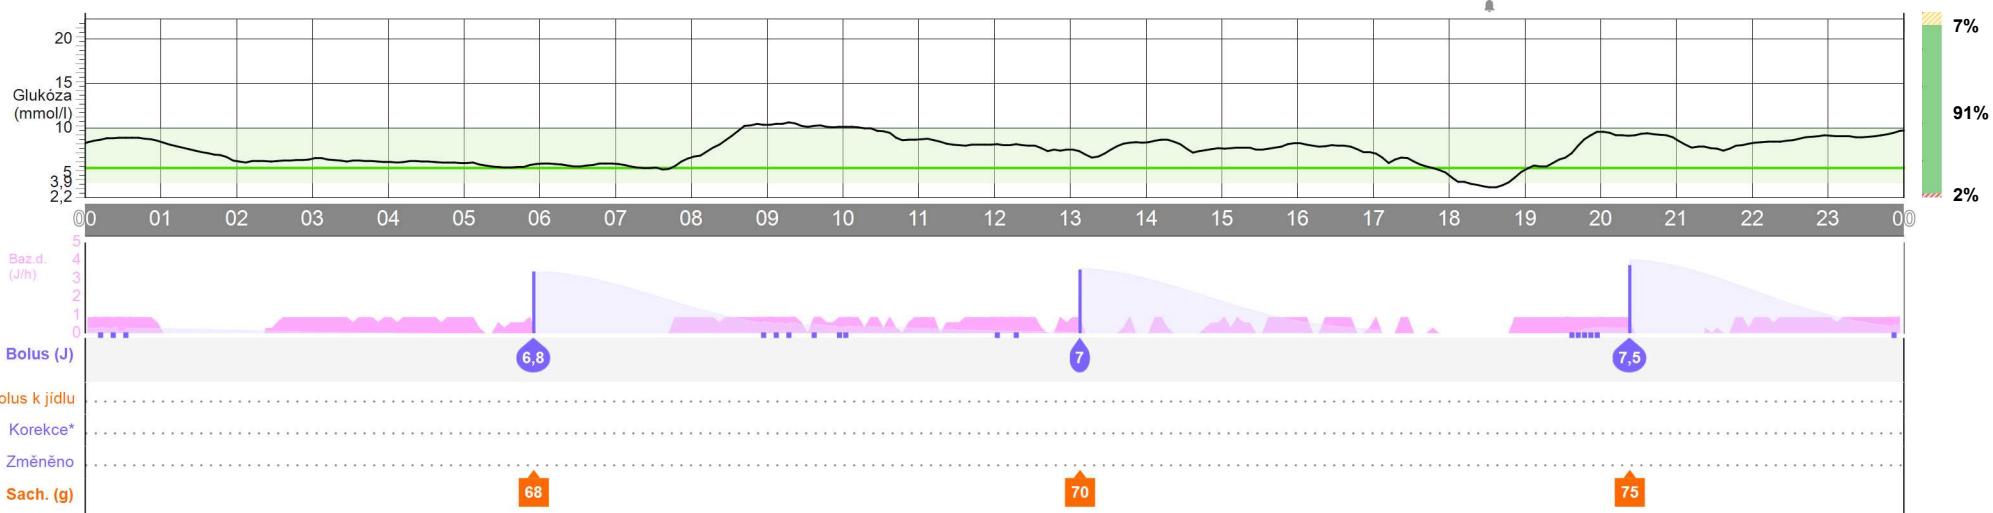

Středa 23.08

Celk. denní dávka 33,5 J


Celkový bazál 33 % | 11,0 J

Celkový bolus 67 % | 22,5 J

{ Bolus 92% | 20,8 J

+ Automat. korekce 8% | 1,7 J }

Čas v cíl. rozs.

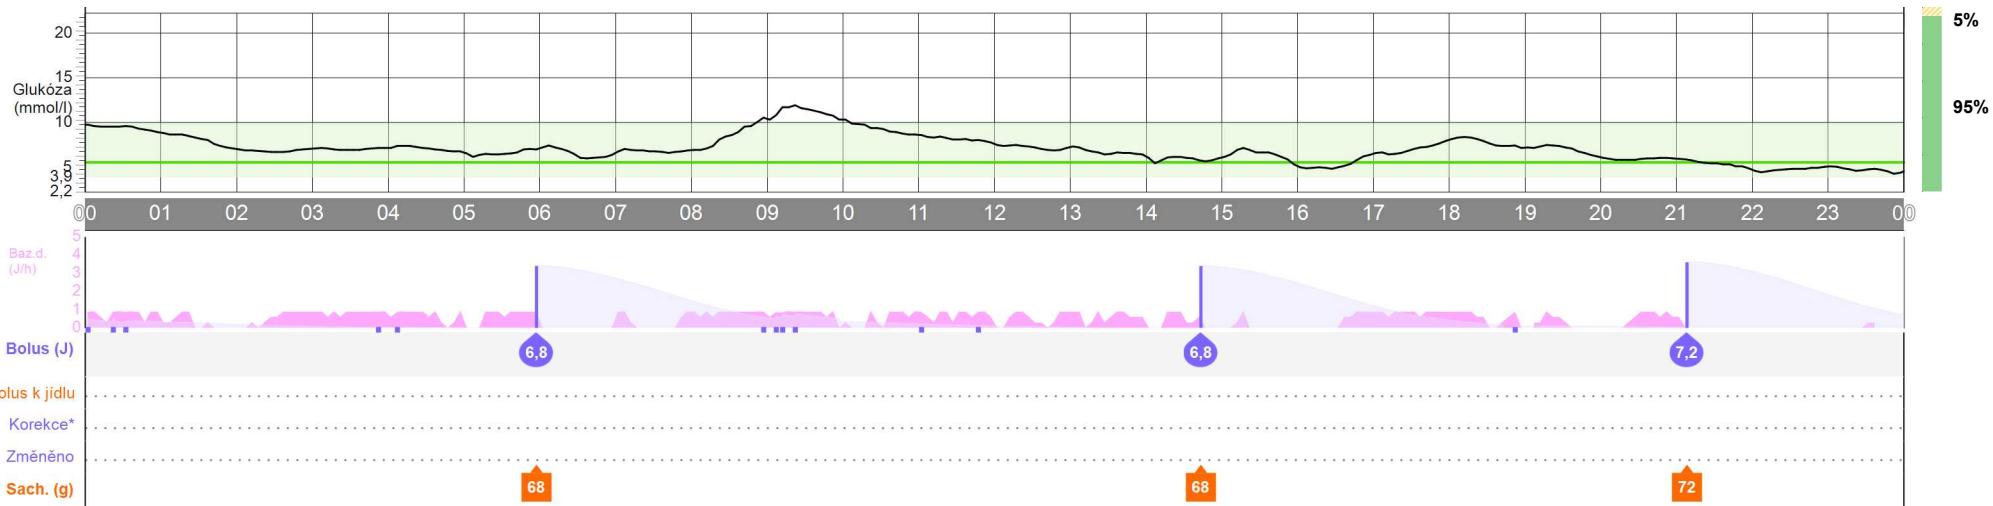

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času  
Mimo grafRuční režim  
Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

## Čtvrtek 24.08

Celk. denní dávka 33,2 J

Celkový bazál 33 % | 10,8 J

Celkový bolus 67 % | 22,4 J

{ Bolus 92% | 20,7 J

+ Automat. korekce 8% | 1,7 J

}

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.



## Pátek 25.08

Celk. denní dávka 31,7 J

Celkový bazál 28 % | 8,9 J


Celkový bolus 72 % | 22,8 J

{ Bolus 93% | 21,3 J

+ Automat. korekce 7% | 1,5 J

}

Čas v cíl. rozs.

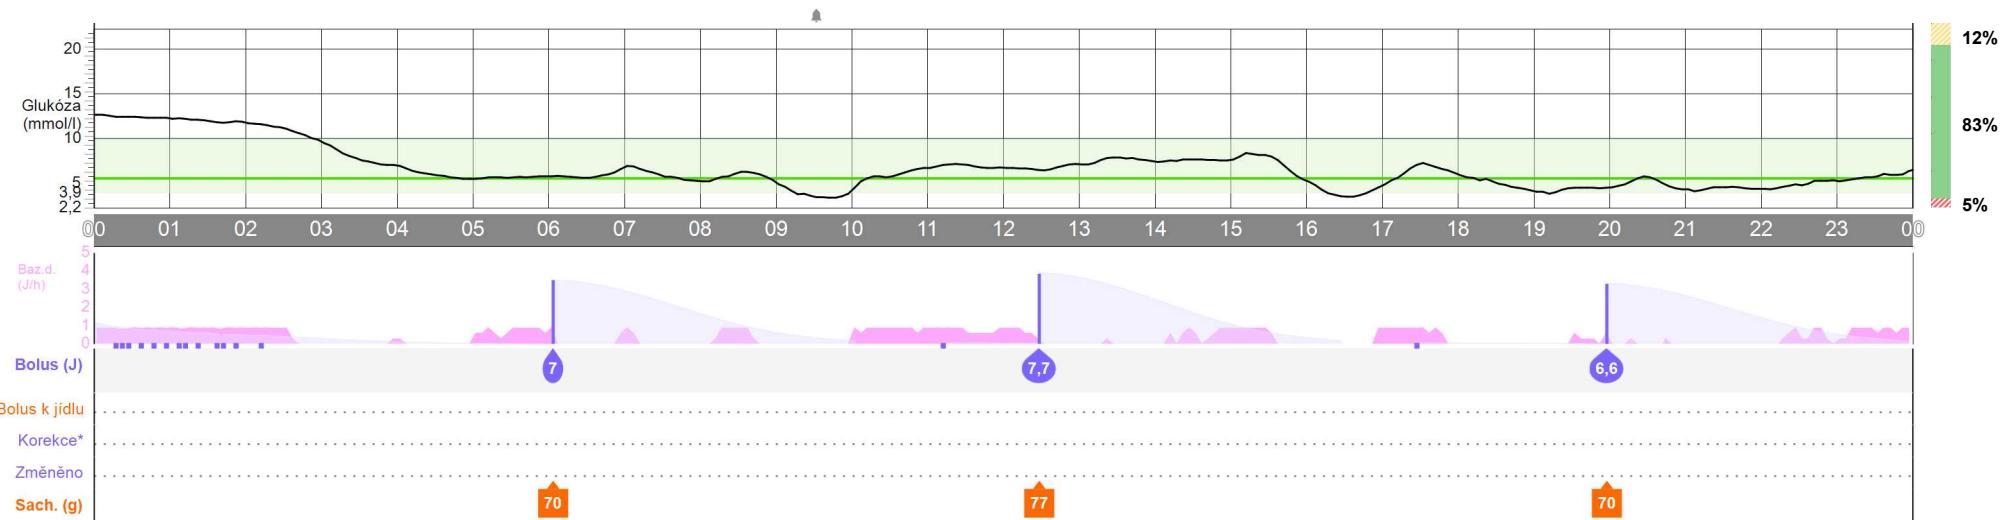

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Sobota 26.08

Celk. denní dávka 35,0 J

Celkový bazál 32 % | 11,3 J

Celkový bolus 68 % | 23,7 J

{ Bolus 97% | 23,0 J

+ Automat. korekce 3% | 0,7 J

}

Čas v cíl. rozs.



Neděle 27.08

Celk. denní dávka 30,6 J

Celkový bazál 45 % | 13,9 J


Celkový bolus 55 % | 16,7 J

{ Bolus 84% | 14,1 J

+ Automat. korekce 16% | 2,6 J

}

Čas v cíl. rozs.

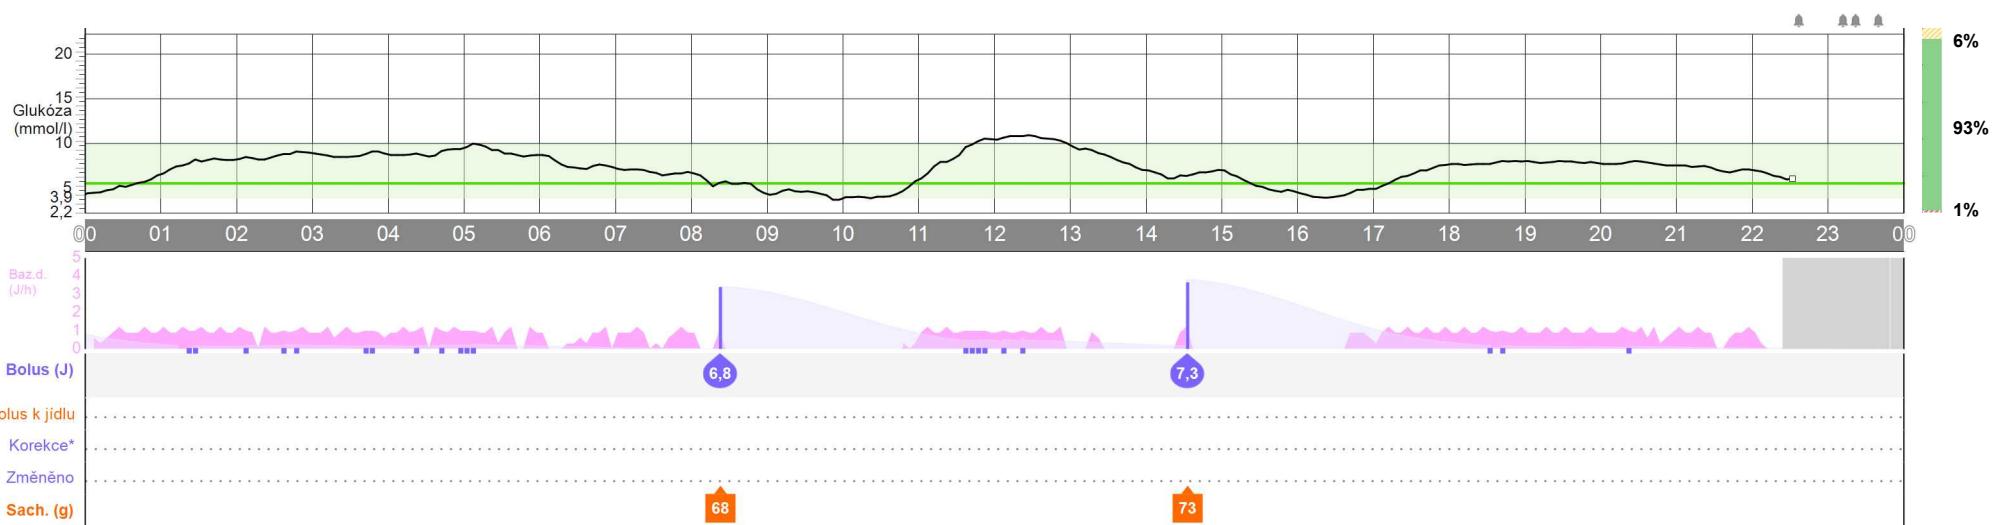

\*S ohledem na aktivnín inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivnín inzulin

Bolus + Aktivnín inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Úterý 29.08

Celk. denní dávka 36,2 J

Celkový bazál 41 % | 14,8 J

Celkový bolus 59 % | 21,4 J

{ Bolus 95% | 20,3 J

+ Automat. korekce 5% | 1,1 J }

Čas v cíl. rozs.



Středa 30.08

Celk. denní dávka 35,3 J

Celkový bazál 35 % | 12,3 J

Celkový bolus 65 % | 23,0 J

{ Bolus 92% | 21,2 J

+ Automat. korekce 8% | 1,8 J }

Čas v cíl. rozs.




\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS



## Čtvrtek 31.08

Celk. denní dávka 34,9 J

Celkový bazál 37 % | 12,8 J


Celkový bolus 63 % | 22,1 J

Bolus 94% | 20,7 J

Automat. korekce 6% | 1,4 J

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.

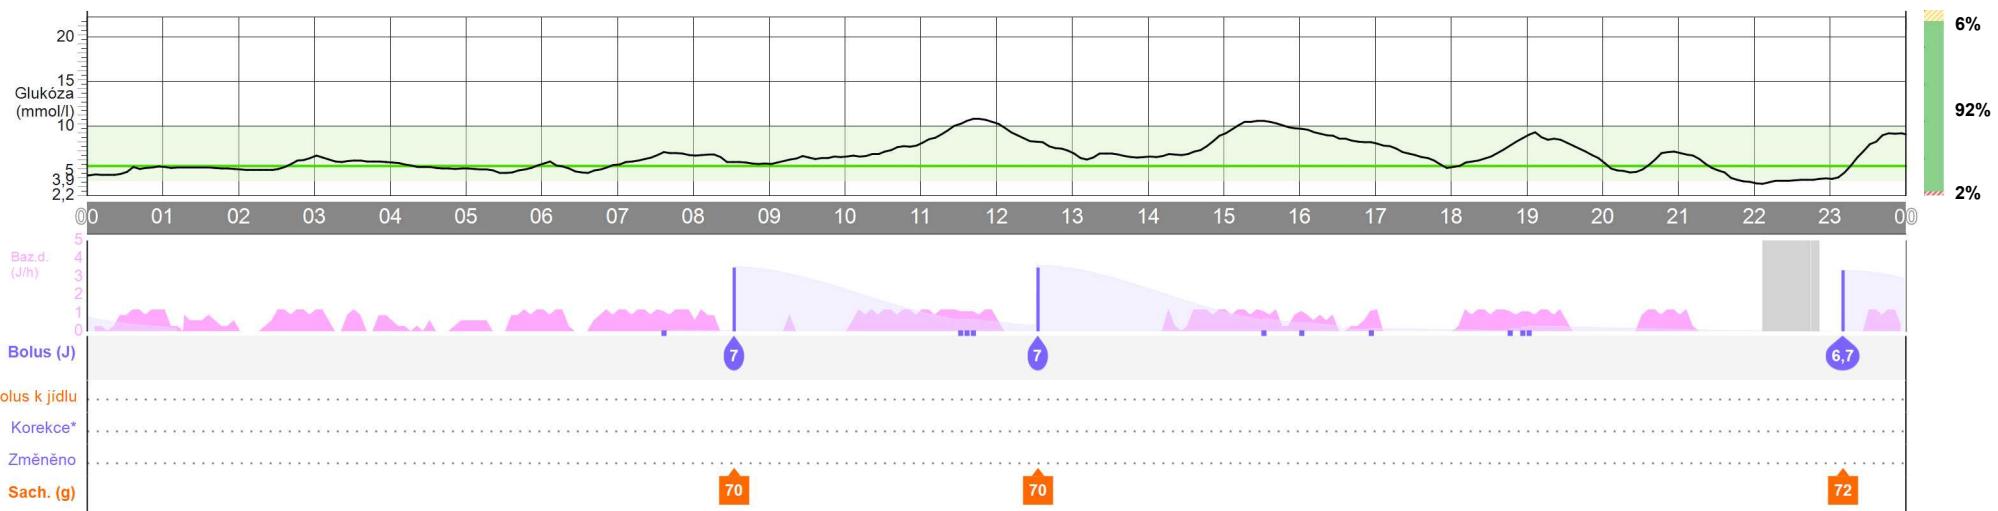

## Pátek 01.09

Celk. denní dávka 29,0 J

Celkový bazál 28 % | 8,1 J

Celkový bolus 72 % | 20,9 J

Bolus 98% | 20,5 J

Automat. korekce 2% | 0,4 J

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.



\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim

Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Sobota 02.09

Celk. denní dávka 33,8 J


Celkový bazál 36 % | 12,3 J

Celkový bolus 64 % | 21,5 J

{ Bolus 92% | 19,8 J

+ Automat. korekce 8% | 1,7 J }

Čas v cíl. rozs.

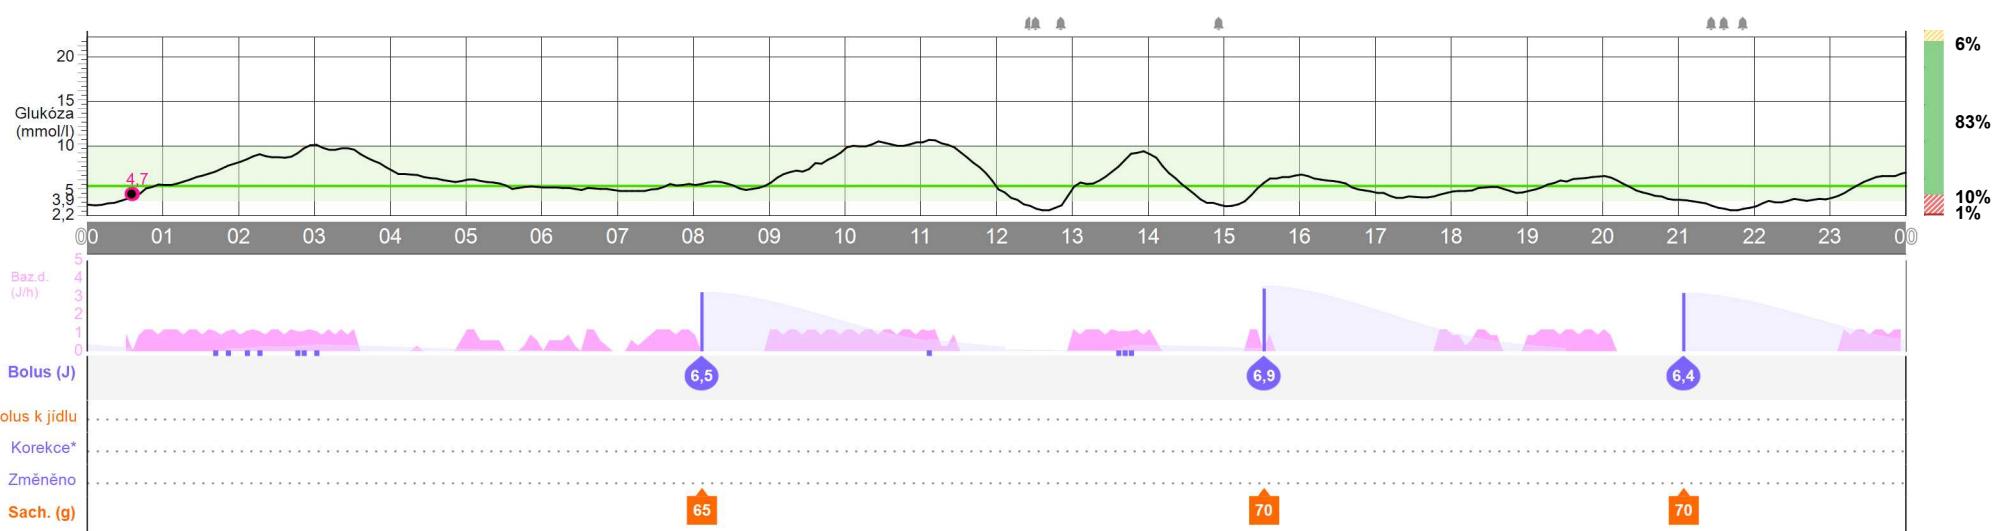

Neděle 03.09

Celk. denní dávka 36,9 J

Celkový bazál 38 % | 13,9 J

Celkový bolus 62 % | 23,0 J

{ Bolus 88% | 20,3 J

+ Automat. korekce 12% | 2,7 J }

Výměna setu

Čas v cíl. rozs.



\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + Aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Mimo graf

Ruční režim  
Ruční zastavení

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2

Pondělí 04.09

Celk. denní dávka 31,3 J


Celkový bazál 34 % | 10,5 J

Celkový bolus 66 % | 20,8 J

{ Bolus 94% | 19,6 J

+ Automat. korekce 6% | 1,2 J }

Čas v cíl. rozs.

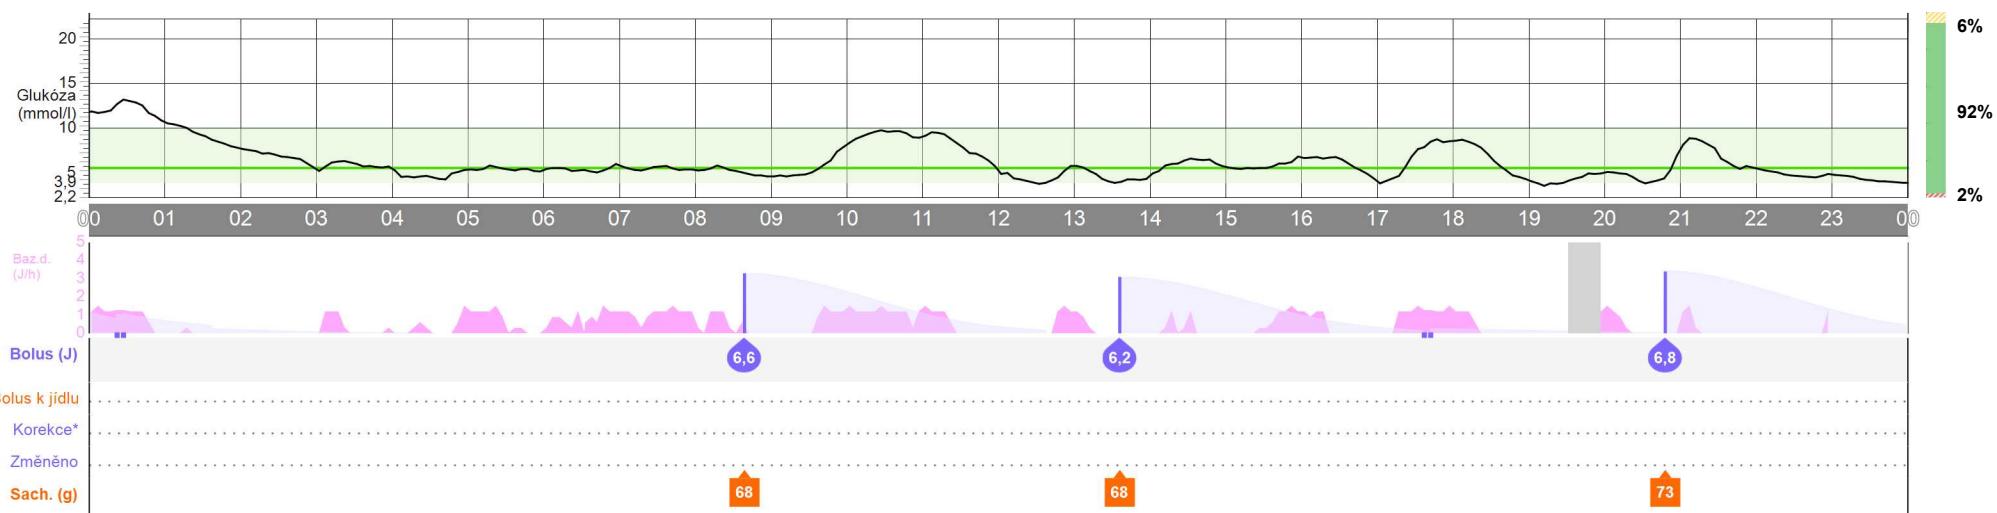

\*S ohledem na aktivní inzulin

Glykémie

Autom. bazál

Kalibrace

Zastavit při níz. GS

Bazál

Zastavit před níz. GS

Dočasný bazál

Výstrahy

Automat. korekce + Aktivní inzulin

Bolus + aktivní inzulin

Cíl + dočasný cíl

Změna času

Ruční režim

Čas v cíl. rozs. (mmol/l)

2,2 3 3,9 10 13,9 22,2