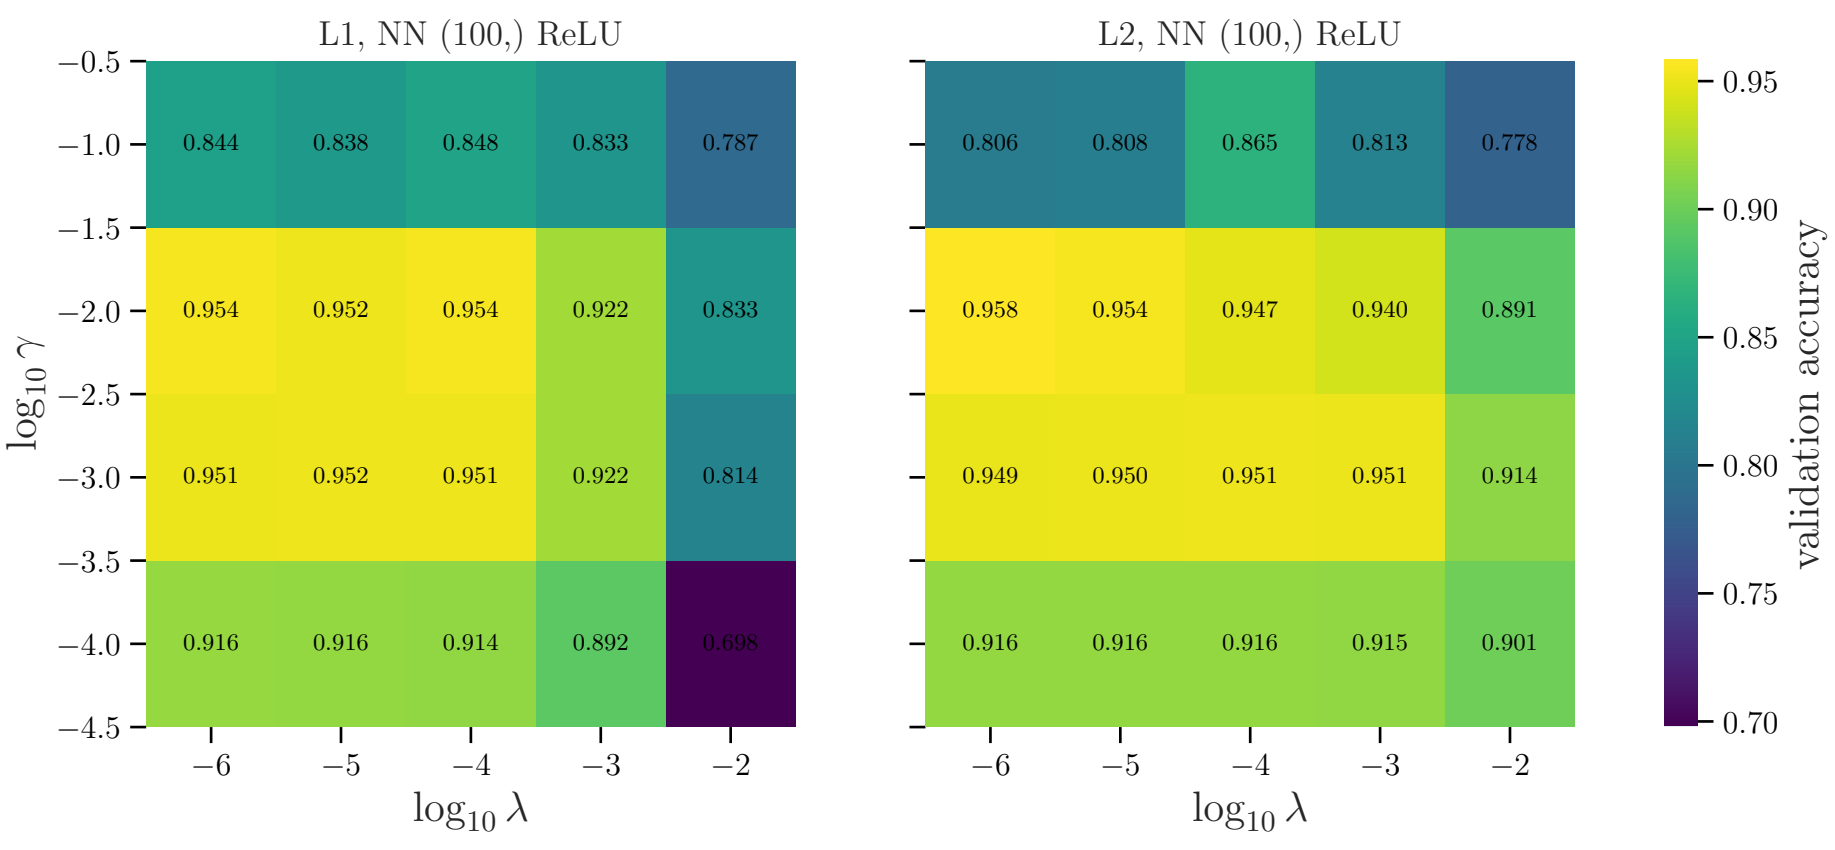

L1, NN (100,) ReLU
L2, NN (100,) ReLU
$\log_{10}\gamma$
$\log_{10}\lambda$
validation accuracy
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
−4.5
−6
−5
−4
−3
−2
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.844 0.838 0.848 0.833 0.787
0.954 0.952 0.954 0.922 0.833
0.951 0.952 0.951 0.922 0.814
0.916 0.916 0.914 0.892 0.698
0.806 0.808 0.865 0.813 0.778
0.958 0.954 0.947 0.940 0.891
0.949 0.950 0.951 0.951 0.914
0.916 0.916 0.916 0.915 0.901