


약어 기능은 옛한글 혹은 불완전 조합을 이용한 한글 출력 치환을 통해 작동되고 있습니다. 따라서 약어 기능을 끄시고 싶으시다면, 한글 출력 치환 부분을 없애시면 됩니다.

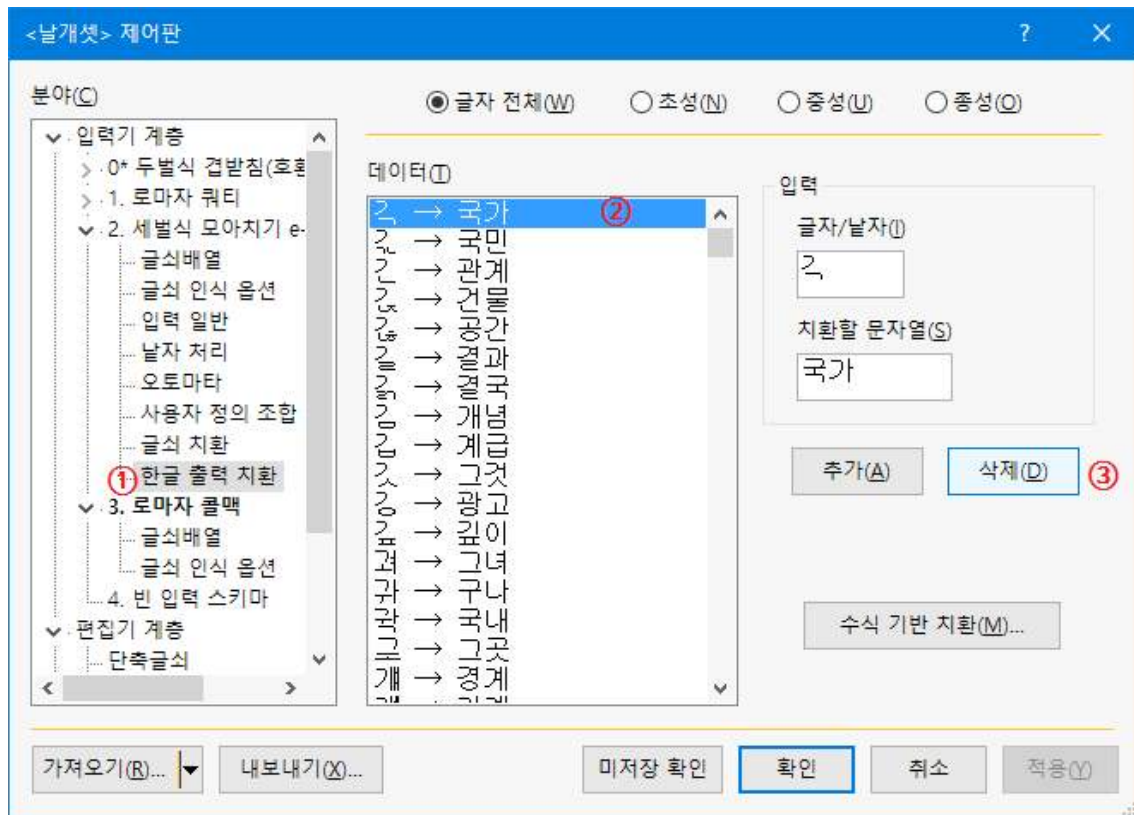

약어 기능을 끄시려면, 날개셋 제어판 - 분야 - 입력기 계층 - 세벌식 모아치기 e-2016 아래에 있는 한글 출력 치환을 선택하신 후, 데이터에서 맨 위의 국가를 선택하시고, Alt + D 버튼을 계속 눌러 주세요. 그러면 약어 데이터가 전부 삭제됩니다.

약어 데이터가 전부 삭제되면 한글 출력 치환에 기반을 둔 약어 사용 기능이 꺼지게 됩니다. 이 상태에서 확인을 누르셔서 날개셋 제어판 설정을 완료하시면 됩니다.