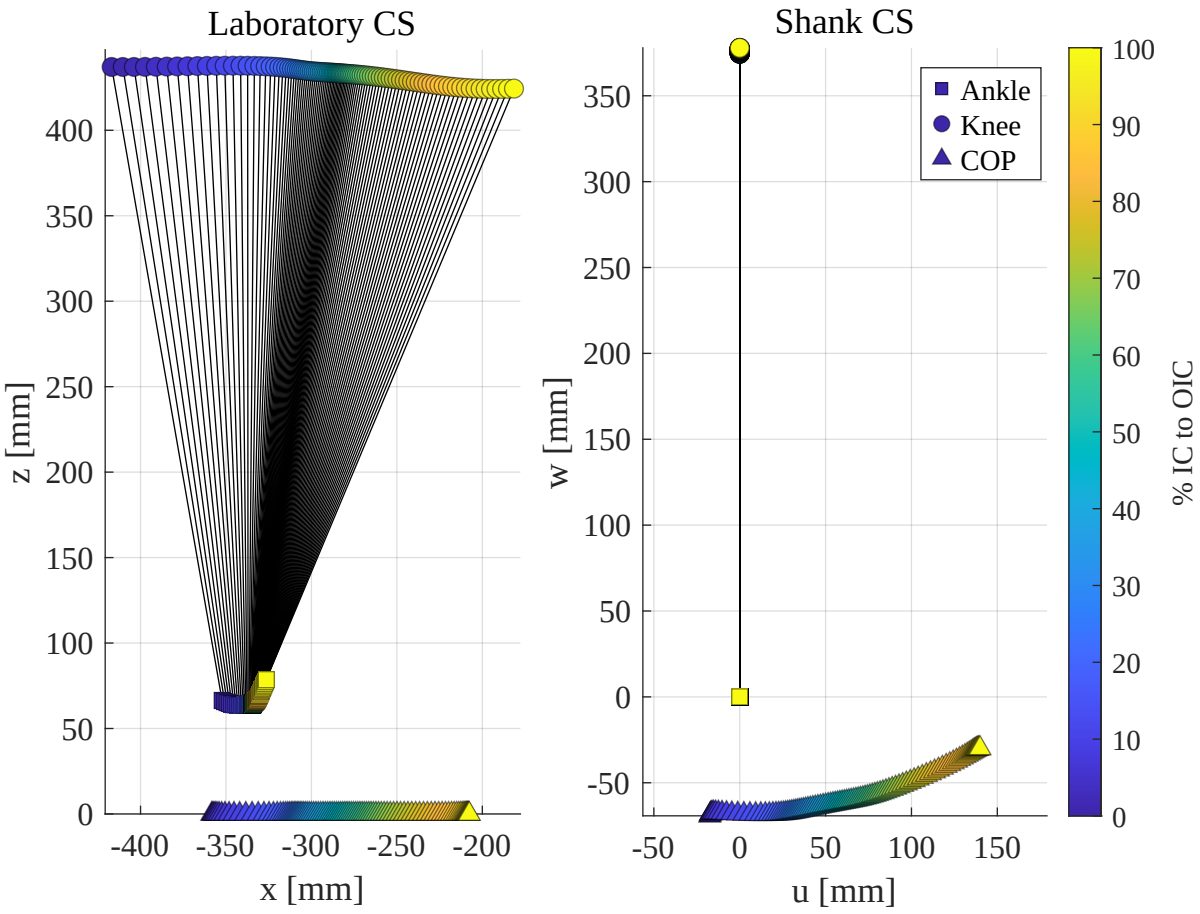

Laboratory CS
z [mm]
x [mm]
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-400
-350
-300
-250
-200
Shank CS
w [mm]
u [mm]
Ankle
Knee
COP
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-50
0
50
100
150
% IC to OIC
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0