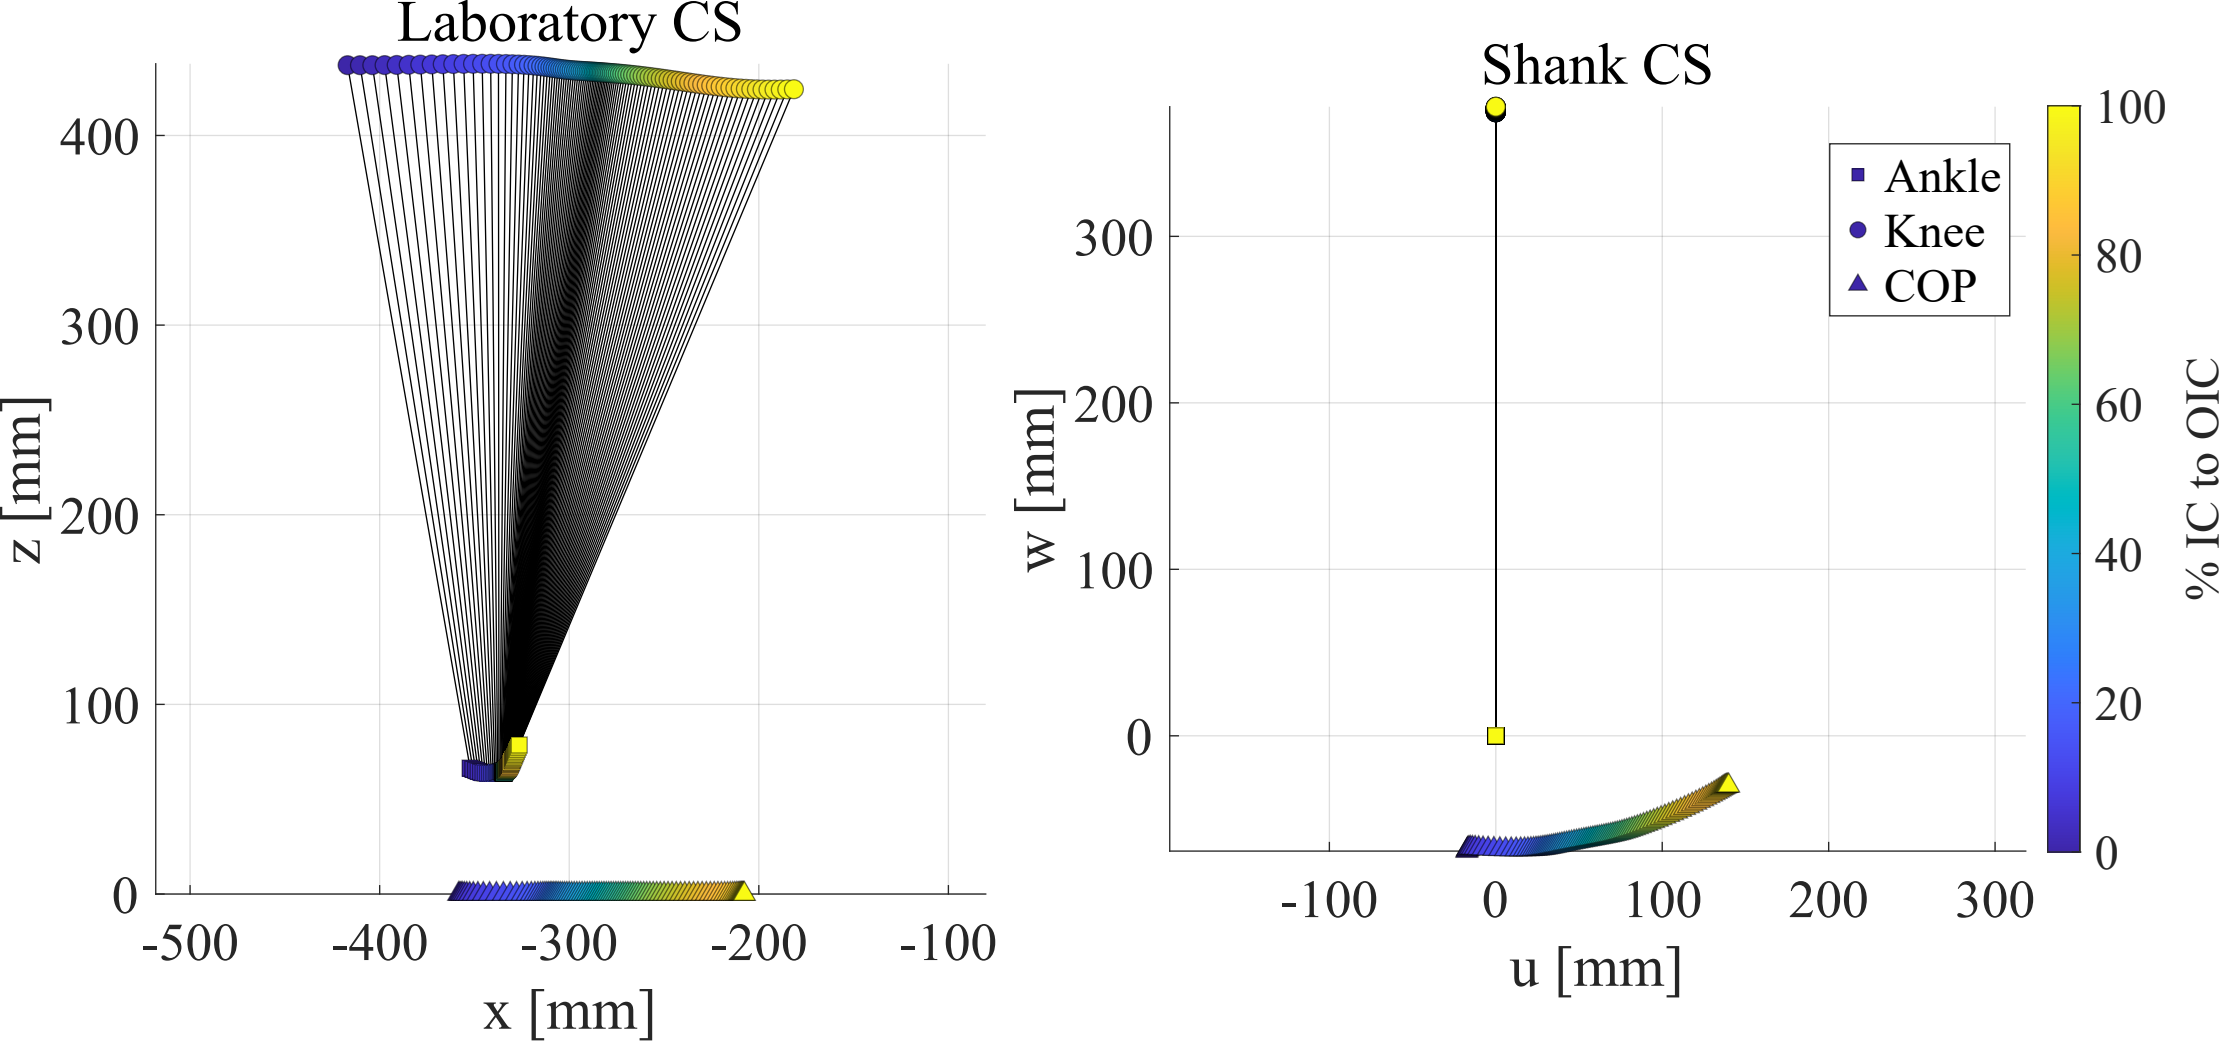

Laboratory CS
z [mm]
x [mm]
400
300
200
100
0
-500
-400
-300
-200
-100
Shank CS
w [mm]
u [mm]
Ankle
Knee
COP
% IC to OIC
300
200
100
0
-100
0
100
200
300
100
80
60
40
20
0