


De acuerdo con los datos obtenidos que presentó el equipo, se realiza tabla para verificar la intensidad de salida de la luz de la lámpara

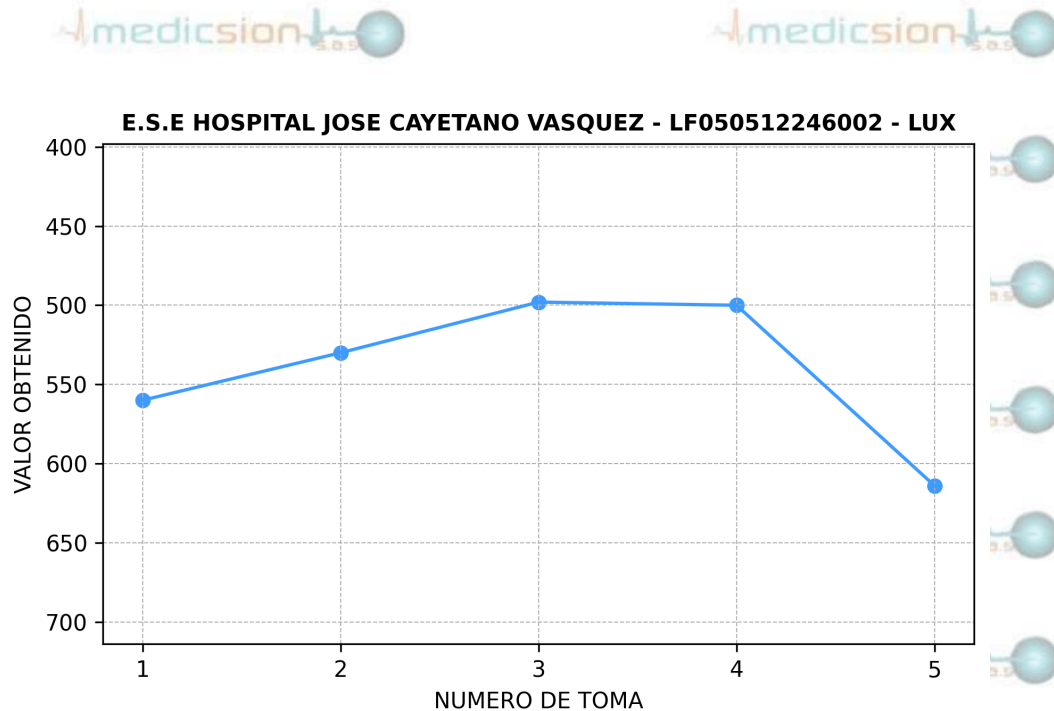

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que la lámpara de fototerapia, mantenga su precisión a lo largo del tiempo.

OBSERVACIONES

Interruptor de encendido presenta, se requiere revisar